



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
03.07.2013 Patentblatt 2013/27

(51) Int Cl.:
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/026 (2006.01)
A61B 5/024 (2006.01)
A61B 5/1455 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **12199633.4**

(22) Anmeldetag: **28.12.2012**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME

(71) Anmelder: **Blazek, Claudia R.**
52074 Aachen (DE)

(72) Erfinder: **Die Erfindernennung liegt noch nicht vor**

(30) Priorität: **31.12.2011 DE 102011122700**

(54) **Bewegungskorreliertes Verfahren und opto-elektronische Vorrichtung zur nichtinvasiven Bestimmung der dermalvenösen Sauerstoffversorgung peripherer Beinegebiete**

(57) Offenbart wird ein Verfahren zur nichtinvasiven Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung, umfassend die folgenden Schritte: Beaufschlagen eines Messareals einer Extremität, in welcher zumindest zweitweise durch passives und/oder aktives Bewegen der Extremität eine bewegungskorrelierte Blutvolumenänderung hervorgerufen wird, mit Strahlung mit mindestens zwei Messwellenlängen, Empfangen der reflektierten und/oder zurückgestreuten und/oder transmittierten Strahlung

mit mindestens einem Detektor und Analysieren mindestens eines Detektorsignals, sodass ein DC- und ein AC-Anteil der venösen, bewegungskorrelierten Blutvolumenänderung in der Extremität bei jeder der verwendeten Messwellenlängen selektiv ermittelbar ist, was wiederum die Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung ermöglicht. Ferner offenbart werden eine entsprechende Vorrichtung, ein entsprechendes System, ein entsprechendes Computerprogramm und eine entsprechende Verwendung einer Vorrichtung.

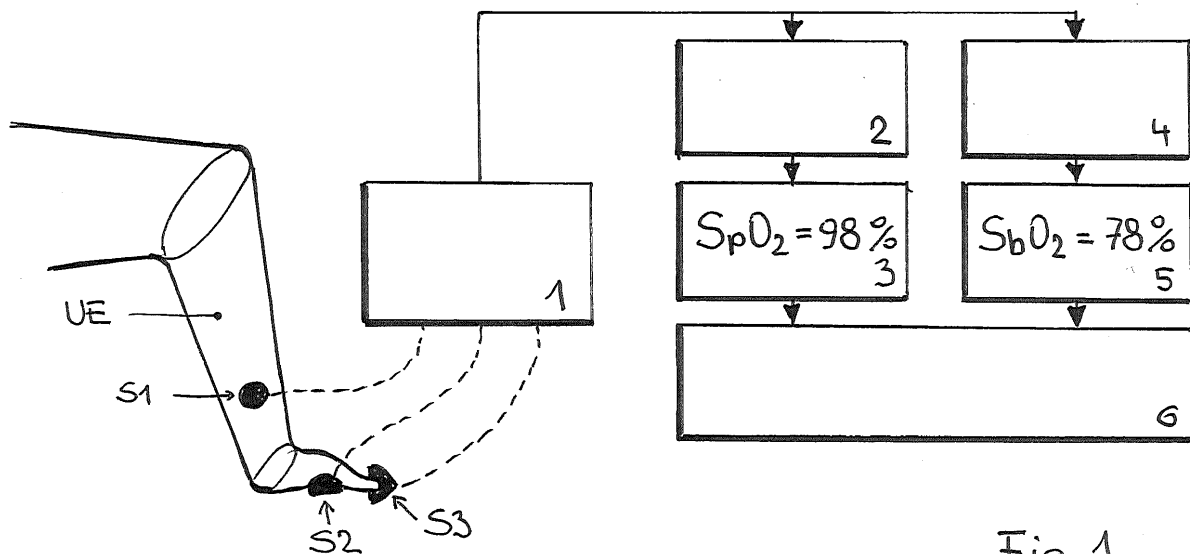


Fig. 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf die nichtinvasive Erfassung der arteriellen und venösen Hämodynamik (Blutveränderung als Funktion der Zeit) in bewegten und ruhenden menschlichen Extremitäten.

[0002] Eine gattungsgemäße Vorrichtung ist beispielsweise aus der DE 3100610 bekannt. Diese Vorrichtung weist einen Sensor auf, der wenigstens eine Lichtquelle und einen Lichtdetektor beinhaltet. Auf diese Druckschrift wird im Übrigen zur Erläuterung aller hier nicht näher beschriebenen Begriffe ausdrücklich verwiesen. Außerdem wird Bezug genommen auf bekannte photoplethysmographische Messsysteme, welche durch Auswertung peripherer arterieller Blutvolumenpulsationen nach dem pulsoximetrischen Verfahren die arterielle Sauerstoffsättigung ermitteln.

[0003] Bei der funktionellen Beurteilung der peripheren venösen Hämodynamik unter Muskelarbeit hat neben der Ultraschall-Doppler-Sonographie vor allem auch die Photoplethysmographie (kurz PPG) in den letzten drei Dekaden eine große Ausbreitung gefunden. Auf Grund ihrer einfachen und schnellen Handhabung lässt sich mit der PPG neben der Früherkennung von Beinvenenerkrankungen auch die hämodynamische Auswirkung besonderer Belastungssituationen, wie z.B. Schwangerschaft und Wochenbett, quantifizieren und die Erhebung epidemiologischer Venenparameter durchführen. Die PPG stellt somit eine Methode dar, die sowohl in der täglichen Routine als auch in der klinischen Forschung breite Anwendung bietet.

[0004] Der methodischen Basisgrundlage der PPG liegt die Tatsache zu Grunde, dass selektives Licht im sichtbaren oder nahen Infrarotbereich von Hämoglobin bzw. von Blut wesentlich stärker als von Gewebe absorbiert wird. Da z.B. eine Gefäßweiterung mit einer Zunahme des Blutvolumens verbunden ist, vergrößert sich zwangsläufig auch das Absorptionsvolumen. Sendet man das energiearme selektive Licht in das Gewebe hinein, so registriert ein Detektor im PPG-Sensor (auch Optrode genannt) mit Zunahme des Blutvolumens im Messvolumen unter dem Sensor weniger Licht. Das PPG-Signal spiegelt somit Blutvolumenschwankungen in kutanen und subkutanen Gefäßnetzen wieder und setzt sich in erster Näherung aus einem sehr großen durchblutungsunabhängigen gleich bleibenden Anteil (Streuung im Gewebe), einem quasistatischen Venensignal und einem sehr geringen, periodischen Arteriensignal zusammen.

[0005] Unter physiologischen Bedingungen strömt das Venenblut von "körperfern zu körpfernah" und von der Hautoberfläche in Körpertiefe. Der postkapillare Restdruck einerseits und die Ansaugung durch respiratorische Druckschwankungen im Brust- und Bauchraum bzw. durch die Herzaktion andererseits gewährleisten eine derartige Strömung im Liegen.

[0006] Beim Sitzen, Stehen und Gehen muss das Blut in den Beinvenen aber "bergauf" fließen. Dieses logistische Transportproblem wird bei den Venengesunden dadurch spielend bewältigt, dass zu den vorgenannten Fördermechanismen der normalen Blutströmung "herzwärts" zusätzlich die sogenannte Muskel-Gelenk-Pumpe aktiviert wird. Die Funktion der einzelnen Muskelgruppen des Beines und die Wirkung der Gelenke sind untereinander so fein abgestimmt, dass die notwendige Rückflussenergie gewonnen werden kann. Die in den Venen vorhandenen Ventile - die Venenklappen - verhindern dabei im Normalfall in der Orthostase die Rückströmung des Blutes.

[0007] Das Hauptanwendungsgebiet der venösen Photoplethysmographie liegt deshalb in der funktionellen Überprüfung der globalen Bluttransporteigenschaften des Beinvenensystems unter Muskelarbeit. Bei dem standardisierten Muskelpumpen-Test führt der Patient im Sitzen mehrere Dorsalextensionen im Sprunggelenk bei am Boden abgestützter Ferse ("Fußwippübungen") durch. Bei der hier beschriebenen Messanordnung werden bevorzugt 15 aktive Beinübungen in 30 Sekunden vom Patienten durchgeführt. Aber auch "passive" Beinübungen, wie etwa eine periodische externe Kontraktion des Unterschenkels oder periodischer Lagewechsel der Extremität ist möglich, vor allem beim Patienten ohne Beweglichkeit im Sprunggelenk.

[0008] Der PPG-Sensor wird vorzugsweise flach ausgeführt und etwa 10 cm oberhalb des Innenknöchels befestigt. Ebenso kann der flexible Sensor z.B. auch im Bereich der Fußsohle oder an den Zehen fixiert werden. Wegen seiner flachen Bauweise kann die Untersuchung auch mit angelegten Kompressionsstrümpfen vorgenommen werden. Bei Venengesunden kann das abgepumpte Blut infolge der Venenklappen nicht einfach wieder zurückfallen. Es kommt deshalb zu einer deutlichen Venenentleerung in den Füßen und Unterschenkeln, die über eine Verkleinerung des Gefäßdurchmessers zu erhöhter Reflektivität der Haut und damit zum Anstieg des gesamten PPG-Signals führt. In der Ruhephase nach Ende der Übung füllen sich die Beinvenen im Normalfall durch den arteriellen Einstrom wieder auf, so dass die PPG-Kurve relativ langsam in die Nähe der Basislinie absinkt. Bei Venenkranken führt der pathologische Reflux des Blutes in den Beinvenen (Venenklappen undicht, defekt oder nicht vorhanden) zu einer deutlich schnelleren Auffüllung und damit zu einer Verkürzung der Wiederauffüllphase.

[0009] Für die Diagnosestellung können u. a. folgende funktionelle Bewertungsparameter der PPG-Kurve entnommen werden:

- venöse Auffüllzeit T_0 in Sekunden und
- venöse Pumpleistung V_0 in Prozent des optischen Signals (Reflexionsänderung der Haut, bezogen auf die Ruhesignalamplitude (DC-Wert) vor Beginn der Übung).

[0010] In Anlehnung an bisherige Verfahren gilt die venöse Auffüllzeit (Zeitintervall vom Kurvenmaximum nach Ende der Bewegung bis zum Wiedererreichen einer konstanten Hautdurchblutung) als zurzeit wichtigster venöser Bewertungsparameter der PPG-Kurve. Je nach Verkürzung der Auffüllzeit, z.B. in Folge pathologischer Blutreflexe in insuffizienten Beinvenen, wurde für die sitzende Beinübung folgende hämodynamische Schweregradeinteilung eingeführt:

Normale Hämodynamik (venengesund):	$T_o \geq 25$ Sekunden
Grad I (leichte hämodynamische Störung):	$20 \leq T_o < 25$ Sekunden
Grad II (mittelschwere hämodynamische Störung):	$10 \leq T_o < 20$ Sekunden
Grad III (schwere hämodynamische Störung):	$T_o < 10$ Sekunden

[0011] Da es bei den peripheren Gefäßerkrankungen oft um Erkrankungen gemischter Genese handelt, also venös und arteriell, erscheint es sowohl medizinisch-diagnostisch als auch bio-physikalisch sehr sinnvoll, neben dem o.e. Zeitparameter T_o auch die arteriellen und venösen Sauerstoffsättigungswerte in einem Untersuchungsgang zu bestimmen.

[0012] Wie allgemein bekannt, gibt die photoplethysmographisch/pulsoximetrisch ermittelte arterielle Sauerstoffsättigung (S_pO_2) an, wie viel Prozent des gesamten Hämoglobins im Blut mit Sauerstoff beladen ist. Dieser Sättigungswert ist ein wichtiger diagnostischer Parameter zur kombinierten Beurteilung der Atemfunktion und des peripheren dermalen Durchblutungsstatus bei Neonaten, Kindern und Erwachsenen gleichermaßen. Das Prinzip der Pulsoximetrie (s. z.B. <http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsoximetrie>) wird hier als bekannt vorausgesetzt. Neben der Bestimmung der S_pO_2 wird in der klinischen Praxis auch die Sauerstoffsättigung im venösen Blut verschiedener Stromgebiete untersucht, allerdings bis dato nur invasiv. Aus der Differenz der arteriellen und venösen Sättigung lässt sich unter Berücksichtigung der Durchblutung die Sauerstoffaufnahme des Gewebes abschätzen. Setzt man hingegen eine konstante Sauerstoffaufnahme voraus, weist eine Zunahme der Differenz auf eine Abnahme der Durchblutung hin (<http://de.wikipedia.org/wiki/Sauerstoffsättigung>).

[0013] Es ist u.a. eine Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 derart weiterzubilden, dass diese bisher nicht messbaren Parameter aus der dermalen bewegungs- und herzsynchronen Blutperforationsänderung in menschlichen Extremitäten unter aktiver oder passiver Muskelarbeit erfasst, analysiert und diese dem Arzt angezeigt werden können.

[0014] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird eine Vorrichtung zur nichtinvasiven Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung, offenbart, mit mindestens einer, vorzugsweise zwei Strahlungsquellen zur Erzeugung von Strahlung mit mindestens zwei Messwellenlängen, wobei die Strahlung ein Messareal einer Extremität beaufschlagt, mit mindestens einem Detektor, der die reflektierte und/oder zurückgestreute und/oder transmittierte Strahlung empfängt, und mit einer mit dem Detektor verbundenen Auswerteelektronik zur Analyse mindestens eines Detektorausgangssignals (also einem Ausgangssignal des Detektors), dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteelektronik eingerichtet ist, das mindestens eine Detektorausgangssignal derart zu analysieren, dass ein DC- und ein AC-Anteil der venösen, bewegungskorrelierten Blutvolumenänderung in der Extremität bei jeder der verwendeten Messwellenlängen selektiv ermittelbar ist, was wiederum die Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung ermöglicht, wobei die bewegungskorrelierte Blutvolumenänderung durch passive und/oder aktive Bewegung der Extremität verursacht ist.

[0015] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung wird ein System zur nichtinvasiven Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung, offenbart, mit mindestens einer, vorzugsweise zwei Strahlungsquellen zur Erzeugung von Strahlung mit mindestens zwei Messwellenlängen, wobei die Strahlung ein Messareal einer Extremität beaufschlagt, mit mindestens einem Detektor, der die reflektierte und/oder zurückgestreute und/oder transmittierte Strahlung empfängt, und mit einer mit dem Detektor verbundenen Auswerteelektronik zur Analyse mindestens eines Detektorausgangssignals (also einem Ausgangssignal des Detektors), dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteelektronik eingerichtet ist, das mindestens eine Detektorausgangssignal derart zu analysieren, dass ein DC- und ein AC-Anteil der venösen, bewegungskorrelierten Blutvolumenänderung in der Extremität bei jeder der verwendeten Messwellenlängen selektiv ermittelbar ist, was wiederum die Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung ermöglicht, wobei die bewegungskorrelierte Blutvolumenänderung durch passive und/oder aktive Bewegung der Extremität verursacht ist. Das System kann beispielsweise eine oder mehrere Vorrichtungen umfassen,

[0016] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren zur nichtinvasiven Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung offenbart, umfassend die folgenden Schritte:

- Beaufschlagen eines Messareals einer Extremität, in welcher durch passives und/oder aktives Bewegen eine bewegungskorrelierte Blutvolumenänderung hervorgerufen wird, mit Strahlung mit mindestens zwei Messwellenlängen,
- Empfangen der reflektierten und/oder zurückgestreuten und/oder transmittierten Strahlung mit mindestens einem Detektor und
- Analysieren mindestens eines Detektorsignals (also einem Ausgangssignal des Detektors), sodass ein DC- und

ein AC-Anteil der venösen, bewegungskorrelierten Blutvolumenänderung in der Extremität bei jeder der verwendeten Messwellenlängen selektiv ermittelbar ist, was wiederum die Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung ermöglicht.

5 **[0017]** Das passive und/oder aktive Bewegen der Extremität kann beispielsweise ebenfalls ein Schritt des Verfahrens sein.

[0018] Gemäß einem vierten Aspekt der Erfindung wird ein Computerprogramm offenbart, das Programmanweisungen umfasst, die einen Prozessor zur Ausführung und/oder Steuerung des Verfahrens gemäß dem dritten Aspekt der Erfindung veranlassen, wenn das Computerprogramm auf dem Prozessor läuft. Unter einem Prozessor sollen in dieser Spezifikation unter anderem Kontrolleinheiten, Mikroprozessoren, Mikrokontrolleinheiten wie Mikrocontroller, digitale Signalprozessoren (DSP), Anwendungsspezifische Integrierte Schaltungen (ASICs) oder Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) verstanden werden. Dabei können entweder alle Schritte des Verfahrens gesteuert werden, oder alle Schritte des Verfahrens ausgeführt werden, oder ein oder mehrere Schritte gesteuert und ein oder mehrere Schritte ausgeführt werden. Das Computerprogramm kann beispielsweise über ein Netzwerk wie das Internet, ein Telefon- oder Mobilfunknetz und/oder ein lokales Netzwerk verteilbar sein. Das Computerprogramm kann zumindest teilweise Software und/oder Firmware eines Prozessors sein. Es kann gleichermaßen zumindest teilweise als Hardware implementiert sein. Das Computerprogramm kann beispielsweise auf einem computerlesbaren Speichermedium gespeichert sein, z.B. einem magnetischen, elektrischen, elektro-magnetischen, optischen und/oder andersartigen Speichermedium. Das Speichermedium kann beispielsweise Teil des Prozessors sein, beispielsweise ein (nicht-flüchtiger oder flüchtiger) Programmspeicher des Prozessors oder ein Teil davon.

[0019] Gemäß einem fünften Aspekt wird die Verwendung einer Vorrichtung oder eines Systems zur nichtinvasiven Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung einer Extremität, in der durch passive und/oder aktive Bewegung eine bewegungskorrelierte Blutvolumenänderung verursacht wird, offenbart, wobei die Vorrichtung oder das System folgendes umfasst:

- mindestens eine, vorzugsweise zwei Strahlungsquellen zur Erzeugung von Strahlung mit mindestens zwei Messwellenlängen, wobei die Strahlung ein Messareal der Extremität beaufschlagt,
- mindestens ein Detektor, der die reflektierte und/oder zurückgestreute und/oder transmittierte Strahlung empfängt, und
- eine mit dem Detektor verbundene Auswerteelektronik zur Analyse mindestens eines Detektorausgangssignals (also einem Ausgangssignal des Detektors), wobei die Auswerteelektronik eingerichtet ist, das mindestens eine Detektorausgangssignal derart zu analysieren, dass ein DC- und ein AC-Anteil der venösen, bewegungskorrelierten Blutvolumenänderung in der Extremität bei jeder der verwendeten Messwellenlängen selektiv ermittelbar ist, was wiederum die Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung ermöglicht.

[0020] Im Folgenden werden beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung beschrieben, die gleichermaßen als für den ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Aspekt der Erfindung offenbart verstanden werden sollen.

[0021] In einer beispielhaften Ausführungsform wird das Bewegen der Extremität nicht durch die Vorrichtung gemäß dem ersten und fünften Aspekt der Erfindung bzw. durch das System gemäß dem zweiten und fünften Aspekt der Erfindung durchgeführt, gesteuert oder veranlasst. Beispielsweise erfolgt das Bewegen der Extremität vollkommen unabhängig von der Vorrichtung gemäß dem ersten und fünften Aspekt der Erfindung bzw. von dem System gemäß dem zweiten und fünften Aspekt der Erfindung. Beispielsweise werden insbesondere keine Hilfsmittel zum Erzeugen der Bewegung verwendet. Beispielsweise arbeiten die Vorrichtung gemäß dem ersten und fünften Aspekt der Erfindung und das System gemäß dem zweiten und fünften Aspekt der Erfindung nicht mit Hilfsmitteln zur künstlichen Erzeugung einer Blutbewegung (beispielsweise Staumanschetten od. ähnlichem).

[0022] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung wird das Bewegen der Extremität durch einen Menschen vorgenommen, insbesondere unmittelbar durch einen Menschen. Bei dem Mensch kann es sich beispielsweise um den Besitzer der Extremität handeln, der diese selbst bewegt, oder um einen Menschen, der die Extremität eines anderen Menschen bewegt. Bei dem Bewegen der Extremität kann es sich beispielsweise um eine standardisierte Bewegung handeln.

[0023] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung beruht die Bestimmung der Sauerstoffsättigung auf reflektierter und/oder zurückgestreuter Strahlung. Beispielsweise sind die ein oder mehreren Strahlungsquellen und der Detektor im Wesentlichen auf einer Seite des Messareals angebracht, und beispielsweise nicht auf gegenüberliegenden Seiten des Messareals. Es erfolgt dann beispielsweise im Wesentlichen eine Reflexionsmessung und beispielsweise keine Transmissionsmessung. Eine Reflexionsmessung kann beispielsweise lediglich dann sinnvolle Ergebnisse liefern, wenn sie an einer bewegten Extremität vorgenommen wird.

[0024] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung beruht die Bestimmung der Sauerstoffsättigung nicht auf transmittierter Strahlung.

[0025] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung sind die Strahlungsquelle(n) und der Detektor in einem Sensor enthalten.

[0026] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung beträgt eine erste der beiden Messwellenlängen 940 nm und eine zweite der beiden Messwellenlängen beträgt 660 nm.

[0027] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Auswerteeinheit eine Steuer- und Auswerteeinheit.

[0028] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Extremität ein Bein oder ein Teil davon. Im Gegensatz zu einer Messung an einem Finger ergibt sich hier der Vorteil, dass bei einer Beinübung die Muskelpumpe im wesentlichen nur das venöse Blut im Bein (Fuss- und Unterschenkelbereich) nach oben bewegt und das venöse Blutvolumen dort vielfach höher ist als das arterielle. Die Messergebnisse erlauben damit eine genauere Messung des venösen Sättigungswerts als bei einer Messung an einem Finger, wo das arterielle Blutvolumen und das venöse Blutvolumen annähernd gleich sind und daher das Messergebnis des venösen Sättigungswerts viel stärker durch den arteriellen Sättigungswert verfälscht ist.

[0029] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung sind zumindest die Strahlungsquelle(n) und der Detektor in einem Kleidungsstück, insbesondere einem Fußkleidungsstück, beispielsweise einem Strumpf, integriert.

[0030] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung umfasst das Analysieren des mindestens einen Detektorausgangssignals Digitalisieren und Filtern.

[0031] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Auswerteelektronik eingerichtet, die venöse Sauerstoffsättigung im transilluminieren Gewebevolumen unter dem Sensor zu bestimmen.

[0032] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Vorrichtung eine opto-elektronische Vorrichtung.

[0033] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Vorrichtung eine Vorrichtung zur Bestimmung der dermalvenösen Sauerstoffsättigung, die zur Bestimmung der Sauerstoffsättigung von oberen und/oder unteren Extremitäten, insbesondere peripherer Beingebiete, geeignet und/oder eingerichtet ist.

[0034] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung umfasst das Messareal darunterliegende Schichten.

[0035] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist der Sensor in flacher und/oder biegsamer Bauweise ausgeführt, so dass insbesondere seine Anpassung an das gewählte Gewebearealprofil gewährleistet ist und somit die Detektion der Strahlung sowohl im Reflexions- als auch Transmissionsmodus stattfinden kann

[0036] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Auswerteeinheit detektornah (also sensornah, wenn der Detektor von einem Sensor umfasst ist) angeordnet und es finden keine spektralen Manipulationen an dem mindestens einen gemessenen (elektrischen) Detektorausgangssignal, insbesondere dem Perfusionssignal, statt, so dass insbesondere hämodynamische Informationsverluste reduziert, insbesondere ausgeschlossen, werden.

[0037] In einer beispielhaften Ausführungsform beruht die Ermittlung des DC- und AC-Anteils der venösen, bewegungskorrelierten Blutvolumenänderung zumindest teilweise (oder vollständig) auf der Analyse eines (beispielsweise ausschließlich) während dem passiven und/oder aktiven Bewegens der Extremität erfassten Detektorsignals (bzw. der von dem Detektor während dem passiven und/oder aktiven Bewegens der Extremität empfangenen Strahlung).

[0038] In einer beispielhaften Ausführungsform wird das mindestens eine Detektorausgangssignal zwei unterschiedlichen digitalen Filtereinheiten zugeführt (die aber auch in einer Einheit zusammengefasst sein können), wo zumindest durch frequenzselektive Bewertung die DC- und AC-Anteile der arteriellen und venösen (Perfusions-)Signale (beispielsweise der arteriellen und venösen Perfusionssignale, die beispielsweise repräsentativ für die arterielle und venöse Blutvolumenänderung sind) errechnet werden, vorzugsweise für alle verwendeten Messwellenlängen getrennt. Beispielsweise kann eine erste der beiden digitalen Filtereinheiten an eine Frequenz des venösen Signals (z.B. 0,5 Hz, beispielsweise synchron mit der Beinbewegung oder gesteuert/getriggert durch die Beinbewegung) und eine zweite der beiden digitalen Filtereinheiten an eine Frequenz (z.B. 1 Hz, beispielsweise synchron mit dem Herzschlag oder gesteuert/getriggert durch den Herzschlag) des arteriellen Signals angepasst sein. Beispielsweise können die digitalen Filtereinheiten auch eine zeitselektive Zuordnung vornehmen. Beispielsweise kann während mindestens einer Ruhephase, die beispielsweise einer Phase, in der die passive und/oder aktive Bewegung der Extremität stattfindet, vorgeht oder folgt, das Detektorsignal analysiert werden, um einen DC-Anteil und einen AC-Anteil der arteriellen Blutvolumenänderung (bzw. des arteriellen Perfusionssignals) zu bestimmen und während der Phase, in der die passive und/oder aktive Bewegung der Extremität erfolgt, das Detektorsignal analysiert werden, um den DC-Anteil und den AC-Anteil der venösen bewegungskorrelierten Blutvolumenänderung (bzw. des venösen Perfusionssignals) zu bestimmen.

[0039] In einer beispielhaften Ausführungsform wird das mindestens eine Detektorausgangssignal einer digitalen Filtereinheit zugeführt, wo zumindest durch frequenzselektive Bewertung die DC- und AC-Anteile des venösen (Perfusions-)Signals errechnet werden, vorzugsweise für alle verwendeten Messwellenlängen getrennt. Beispielsweise kann die digitale Filtereinheit (nachfolgend als erste digitale Filtereinheit bezeichnet) an eine Frequenz des venösen Signals (z.B. 0,5 Hz) angepasst sein. Eine weitere digitale Filtereinheit (nachfolgend als zweite digitale Filtereinheit bezeichnet, die aber mit der ersten digitalen Filtereinheit auch eine Einheit bilden kann) kann beispielsweise der Bestimmung eines DC-Anteils und eines AC-Anteils des arteriellen (Perfusions-)Signals dienen und beispielsweise an eine Frequenz des arteriellen (Perfusions-)Signals angepasst sein. Beispielsweise kann während mindestens einer Ruhephase, die beispielsweise einer Phase, in der die passive und/oder aktive Bewegung der Extremität stattfindet, vorgeht oder folgt,

das Detektorsignal mit der zweiten digitalen Filtereinheit analysiert werden, um einen DC-Anteil und einen AC-Anteil der arteriellen Blutvolumenänderung (bzw. des arteriellen Perfusionssignals) zu bestimmen und während der Phase, in der die passive und/oder aktive Bewegung der Extremität erfolgt, das Detektorsignal mit der ersten digitalen Filtereinheit analysiert werden, um den DC-Anteil und den AC-Anteil der venösen bewegungskorrelierten Blutvolumenänderung (bzw. des venösen Perfusionssignals) zu bestimmen. DC- und AC-Anteil der arteriellen Blutvolumenänderung können beispielsweise aber auch in der Ruhephase und in der Bewegungsphase bestimmt werden.

[0040] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung sind eine oder mehrere weitere Auswerteeinheiten vorgesehen, um aus den venösen und arteriellen DC- und AC-Wertepaaren sowohl die arterielle als auch die venöse Sauerstoffsättigung zu bestimmen.

[0041] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung wird aus den Werten der arteriellen und venösen Sauerstoffsättigung transkutan die Sauerstoffsättigungsdifferenz zwischen dem arteriellen und dem venösen Gefäßbett bestimmt.

[0042] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Bewegung der Extremität eine aktive Beinübung durch den Patienten und/oder eine externe Beinübung durch den Untersucher (manuelle Blutvolumendrainage). Die Bewegung der Extremität kann beispielsweise unter aktiver oder passiver Muskelarbeit erfolgen. Die Bewegung der Extremität kann beispielsweise die Bewegung eines Teils der Extremität relativ zu einem weiteren Teil der Extremität beinhalten, wobei die beiden Teile der Extremitäten beispielsweise durch ein Gelenk verbunden sind. Es kann sich also beispielsweise um eine Bewegung eines Fußes relativ zu einem Unterschenkel oder einer Hand relativ zu einem Unterarm oder eines Fingers relativ zu einer Hand oder eines Fingergliedes relativ zu einem anderen Fingerglied handeln. Die Bewegung der Extremität kann beispielsweise Dorsalextensionen im Sprunggelenk abgestützter Ferse ("Fußwippübungen") umfassen.

[0043] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Bewegung der Extremität eine passive Beinübung durch wiederholte Hoch- und Tieflagerung der Extremität.

[0044] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Bewegung der Extremität eine Bewegung der oberen Extremität, vorzugsweise einer Fingerspitze oder eines Daumenballens.

[0045] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Innenseite der Sensoroberfläche (zum Gewebe hin) aus weichem und/oder rutschfestem Material ausgebildet.

[0046] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Außenseite der Sensoroberfläche (weg vom Gewebe) aus lichtundurchlässigem Material ausgebildet und zwischen den beiden äußeren flexiblen Sensorschichten sind ebenfalls flexible leitende und geerdete Abschirmungsfolien eingearbeitet.

[0047] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung ist die Frequenz der Bewegung der Extremität geringer als 1 Hz, vorzugsweise etwa 0,5 Hz.

[0048] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung wird die Frequenz der Bewegung der Extremität durch die Vorrichtung oder das System aus dem mindestens einen Detektorausgangssignal ermittelt. Dazu wird beispielsweise das Detektorausgangssignal während der Bewegungsphase auf Minima und Maxima analysiert und aus deren Abstand die Bewegungsfrequenz bestimmt.

[0049] In einer beispielhaften Ausführungsform der Erfindung wird neben der Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung (und beispielsweise auch der arteriellen Sauerstoffsättigung) auch (beispielsweise gleichzeitig) die venöse Auffüllzeit bestimmt (beispielsweise basierend auf den gleichen Messwerten oder Detektorsignalen, die beispielsweise zumindest teilweise während einer standardisierten Beinübung, beispielsweise dem sog. Muskelpumpen-Test, erfasst werden).

[0050] Die vorgenannten beispielhaften Ausführungsformen und deren einzelne Merkmale sollen auch in allen möglichen Kombinationen miteinander offenbart verstanden werden.

[0051] Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen exemplarisch beschrieben, auf die im Übrigen bezüglich der Offenbarung aller im Text nicht näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzelheiten ausdrücklich verwiesen wird.

[0052] Es zeigen:

Fig. 1 die bevorzugte Position der optisch-elektronischen Sensoreinheit auf dem Unterschenkel respektive Fuß des sitzenden Probanden und das Blockschaltbild eines Ausführungsbeispiels der Vorrichtung mit den wichtigsten Systemkomponenten,

Fig. 2 typische Signalbeispiele (arterielle Photoplethysmogramme bei ruhendem Bein) der erfindungsgemäßen Vorrichtung, gleichzeitig bei zwei verschiedenen Messwellenlängen gemessen,

Fig. 3 spektrale Darstellung des molaren Extinktionsverhaltens vom oxigenierten und reduziertem Hämoglobin im Wellenlängenbereich vom 600 bis 1000 nm,

Fig. 2 typische ungefilterte Perfusionssignalbeispiele (mit arteriellen und venösen Signalanteilen) der erfindungsgemäßen Vorrichtung, gleichzeitig bei zwei verschiedenen Messwellenlängen gemessen in der initialen Ruhephase, gefolgt von einer 30 Sekunden langen Beinbewegungsphase und anschließender Ruhephase,

5 Fig. 5 typische venöse Signalbeispiele der erfindungsgemäßen Vorrichtung, gemessen bei einer der beiden Messwellenlängen. Neben dem photoplethysmographischen Gesamtsignal (a) sind der durch digitale Filterung daraus ermittelte venöse DC-Anteil (b) und der venöse AC-Anteil (c) dargestellt,

10 Fig. 6 die bevorzugte Sensorform und Applikationspositionen am Patientenbein.

[0053] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung betreffen ein bewegungskorreliertes Verfahren und eine opto-elektronische Vorrichtung zur nichtinvasiven (transkutanen) Bestimmung der dermalen venösen Sauerstoffsättigung im Bereich der menschlichen Extremitäten, bevorzugt im Bereich der Beine. Die Vorrichtung umfasst (beispielsweise in ihrer Minimalausstattung) folgendes (und das Verfahren umfasst entsprechende Schritte):

- einen flachen, biegsamen Sensor, welcher je nach gewähltem Gewebeareal im Reflexions- oder Transmissionsmodus arbeiten kann, mit mindestens einem Photodetektor und zwei selektiven Lichtquellen, deren Licht aufeinander abgestimmt ist, das Hautareal transilluminiert,
- einen sensornahen Steuer- und Auswerteeinheit, an der die elektrischen Ausgangssignale des Sensors anliegen und hier hochaufgelöst digitalisiert werden, so dass die überlagerten arteriellen und venösen Perfusionssignale am Ausgang ohne hämodynamische Informationsverluste am Ausgang der Einheit zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung stehen,
- eine digitale Filtereinheit, welche während der Beinbewegung die venösen (und optional auch die arteriellen) DC- und AC-Signalanteile für beide verwendeten Messwellenlängen getrennt ermittelt, und
- weitere rechnerunterstützte Auswerteeinheiten, welche aus den venösen und arteriellen DC- und AC-Signalanteilen neben der bekannten arteriellen Sauerstoffsättigung (S_pO_2) auch die venöse Sauerstoffsättigung (S_bO_2) im Hautareal unter dem Sensor errechnet.

[0054] Zusätzlich kann auch noch eine weitere digitale Filtereinheit vorhanden sein, welche bei ruhendem Patienten die arteriellen DC- und AC-Signalanteile für beide verwendeten Messwellenlängen getrennt ermittelt.

[0055] Durch die abgestimmte, erfindungsgemäße Zusammenwirkung ihrer einzelnen Merkmale zeichnet sich die beschriebene Vorrichtung im Vergleich mit den photoplethysmographischen Vorrichtungen nach dem Stande der Technik beispielsweise dadurch aus, dass neben dem gefäßdiagnostisch relevanten hämodynamischen Bewertungsparameter "venöse Auffüllzeit T_o " nach standardisierter Beinübung (sogenannter Muskelpumpen-Test) gleichzeitig auch die venösen und arteriellen Sauerstoffsättigungswerte ermittelt werden können.

[0056] Figur 1 zeigt schematisch drei Ausführungsbeispiele der bevorzugten Sensorbefestigung (S1: reines Reflexionsmessprinzip; S2: kombiniertes Reflexions-Transmissionsmessprinzip; S3: reines Transmissionsmessprinzip) an der unteren Extremität (UE) des sitzenden Patienten und das Blockschaltbild der erfindungsgemäßen Messvorrichtung. Der Patient führt dabei eine standardisierte Beinübung (beispielsweise mit vorgegebener Frequenz, beispielsweise durch ein Metronom) im Sitzen vor. Im Elektronikblock (1) findet eine sensornaher Signalvorverarbeitung und Digitalisierung ohne jegliche Signalfilterung statt. Am Ausgang von (1) stehen zwei gleichzeitig bei λ_1 (bevorzugt 940 nm) und λ_2 (bevorzugt 660 nm) aufgenommene Perfusionssignale zur Verfügung, die kombinierte arterielle und venöse Blutvolumenschwankungen in der Extremität widerspiegeln. Sie werden weitergeleitet an zwei digitale Filtergruppen (2) und (4) mit unterschiedlichen spektralen Signaleigenschaften. Eine der Filtergruppen filtert und errechnet DC- und AC-Anteile des arteriellen Signalanteils, die andere DC- und AC-Signalanteile des venösen Signalanteils. Die Signalkomponenten am Ausgang der Filtergruppen (2) und (4) werden weiteren Elektronik- und Rechnergruppen (3) und (4) zugeführt und dort verschiedenen Algorithmen zur Berechnung der Sättigungswerte zugefügt. Die Einheit (3) ermittelt selektiv den arteriellen, herzsclagsynchronen Sättigungswert (S_pO_2 , dieser liegt typischerweise bei 98 %), die Einheit (5) dann den venösen, bewegungskorrelierten Sättigungswert (S_bO_2 , dieser liegt typischerweise bei 78%). In der Einheit wird abschließend die arterio-venöse Sättigungsdifferenz errechnet und angezeigt; sie beträgt in diesem Falle 20 %.

[0057] Typische arterielle Photoplethysmogramme, gleichzeitig bei zwei verschiedenen Messwellenlängen λ_1 und λ_2 bei ruhendem Bein gemessen, zeigt die Figur 2. Eingetragen dort sind ebenfalls die zugehörigen DC- und AC-Signalgrößen.

[0058] Die Sättigungswerte können in dem Fachmann bekannter Weise durch Bildung von Verhältnissen von AC- und DC-Anteilen bei den unterschiedlichen Wellenlängen bestimmt werden. Zunächst gilt für den sog. R-Wert:

$$R = f(SO_2) = \frac{(AC/DC)\lambda_2}{(AC/DC)\lambda_1}$$

5

wobei der Nenner das Verhältnis von AC- zu DC-Anteil bei der Messwellenlänge λ_1 und der Zähler das entsprechende Verhältnis bei der Messwellenlänge λ_2 angibt. Anhand der arteriellen AC/DC-Anteile kann ein arterieller R-Wert und anhand der venösen AC/DC-Anteile entsprechend ein venöser R-Wert bestimmt werden.

10

[0059] Mit Hilfe von in der Literatur beschriebenen analytischen Approximationen lässt sich aus dem R-Wert die Sauerstoffsättigung im Blut (venös oder arteriell) z. B. wie folgt errechnen:

15

$$SO_2 = (A - B \cdot R)\% \quad \text{mit } A = 110 \text{ und } B = 25 .$$

(Berechnungsvorschrift nach Rusch et al, Comput. Biol. Med. 26 (1996).

20

[0060] Figur 3 demonstriert das unterschiedliche molare Extinktionsverhalten vom oxigenierten und reduzierten Hämoglobin im Wellenlängenbereich vom 600 bis 1000 nm. Man erkennt daraus, dass sich die beiden Kurven bei $\lambda = 800$ nm, dem sogenannten isosbestischem Punkt) kreuzen, hier ist die Lichtabsorption der beiden Blutderivate identisch.

25

[0061] Typische ungefilterte Perfusionssignale (mit arteriellen und venösen Signalanteilen), gemessen an zwei verschiedenen Wellenlängen, können in schematischer Darstellung der Figur 4 entnommen werden. Gemessen wurde hier in drei aufeinander folgenden Phasen; einer initialen Ruhephase folgt eine 30 Sekunden lange Beinbewegungsphase und anschließend wieder eine Ruhephase. Die venöse Auffüllzeit beträgt in diesem Fall 30 Sekunden. Die Frequenz der beinübungskorrelierten Blutvolumenänderung beträgt 0,5 Hz, die Herzfrequenz 1 Hz. Diese liegen genügend weit auseinander, um elektronisch durch Filterung (vgl. die Filter (2) und (4) der Fig. 1) sicher getrennt zu können.

30

[0062] Figur 5 zeigt gemessene venöse Signalkomponenten. Neben dem photoplethysmographischen Gesamtsignal (a) sind der durch digitale Filterung daraus ermittelte venöse DC-Anteil (b) und der venöse AC-Anteil (c) dargestellt.

35

[0063] In der Figur 6 werden schließlich zwei bevorzugte Sensorapplikationspositionen am Bein / Fuß eines Probanden gezeigt. Durch die flexible Ausführung des Sensors ist eine Anpassung der Sensoroberfläche an die Beinform garantiert.

40

[0064] Auch die folgenden beispielhaften Ausführungsbeispiele werden vorliegend offenbart:

35

Ausführungsbeispiel 1: Verfahren und opto-elektronische Vorrichtung zur nichtinvasiven Bestimmung der dermal-venösen Sauerstoffversorgung peripherer Beingebiete mit einem Sensor, welcher mindestens zwei selektive Lichtquellen, deren Licht das Messareal beaufschlagt und von dem Messareal und den darunterliegenden Schichten reflektiert respektive zurückgestreut wird, weiterhin mit mindestens einem Lichtdetektor, der das reflektierte Licht empfängt, ausgestattet ist und mit einer Steuer- und Auswerteelektronik zur Analyse der Detektorausgangssignals verbunden wird,

40

dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor in flacher und biegsamer Bauweise ausgeführt ist, so dass seine Anpassung an das gewählte Gewebearealprofil gewährleistet ist und somit die Perfusionssignaldetektion sowohl im Reflexions- als auch Transmissionsmodus stattfinden kann und die Ausgangssignale des Sensors derart digitalisiert und gefiltert werden, dass ein DC- und ein AC-Anteil der venösen, bewegungskorrelierten Blutvolumenänderung bei jeder der verwendeten Messwellenlängen selektiv ermittelt werden kann, was wiederum die Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung im transilluminieren Gewebevolumen unter dem Sensor ermöglicht.

45

Ausführungsbeispiel 2: Messeinrichtung nach Ausführungsbeispiel 1,

50

dadurch gekennzeichnet, dass in der sensornahen Steuer- und Auswerteeinheit, an der die elektrischen Ausgangssignale des Sensors anliegen, keine spektralen Manipulationen am gemessenen Perfusionssignal stattfinden und somit hämodynamische Informationsverluste ausgeschlossen werden.

55

Ausführungsbeispiel 3: Messeinrichtung nach einem der Ausführungsbeispiele 1 bis 2,

dadurch gekennzeichnet, dass das Ausgangssignal der sensornahen Steuer- und Auswerteelektronik zwei unterschiedlichen digitalen Filtereinheiten zugefügt wird, wo durch frequenzselektive Bewertung und zeitselektive Zuordnung die DC- und AC-Anteile der arteriellen und venösen Perfusionssignale errechnet werden, und zwar für alle verwendeten Messwellenlängen getrennt.

Ausführungsbeispiel 4: Messeinrichtung nach einem der Ausführungsbeispiele 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass in weiteren Auswerteeinheiten aus den venösen und arteriellen DC- und AC-Wertepaaren sowohl die arterielle als auch die venöse Sauerstoffsättigung bestimmt werden kann.

5 Ausführungsbeispiel 5: Messeinrichtung nach einem der Ausführungsbeispiele 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass aus den Werten der arteriellen und venösen Sauerstoffsättigung transkutan die Sauerstoffsättigungsdifferenz zwischen dem arteriellen und dem venösen Gefäßbett bestimmt werden kann.

10 Ausführungsbeispiel 6: Messeinrichtung nach einem der Ausführungsbeispiele 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass statt einer aktiven Beinübung durch den Patienten eine externe Beinübung durch den Untersucher (manuelle Blutvolumendrainage) angewendet werden kann.

15 Ausführungsbeispiel 7: Messeinrichtung nach einem der Ausführungsbeispiele 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass statt einer aktiven Beinübung durch den Patienten eine passive Beinübung durch wiederholte Hoch- und Tieflagerung der Extremität angewendet werden kann.

20 Ausführungsbeispiel 8: Messeinrichtung nach einem der Ausführungsbeispiele 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das beschriebene Untersuchungsprotokoll auch auf die obere Extremität angewandt werden kann, wobei hier bevorzugt an den Fingerspitzen oder Daumenballen gemessen wird.

25 Ausführungsbeispiel 9: Messeinrichtung nach einem der Ausführungsbeispiele 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Innenseite der Sensoroberfläche (zum Gewebe hin) aus weichem und rutschfestem Material derart ausgebildet ist, damit eine stabile Sensorbefestigung an der Haut auch während der Bewegungsphase der Extremität ohne großen Anpressdruck gewährleistet wird.

30 Ausführungsbeispiel 10: Messeinrichtung nach einem der Ausführungsbeispiele 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenseite der Sensoroberfläche (weg vom Gewebe) aus lichtundurchlässigem Material ausgebildet ist und zwischen den beiden äußeren flexiblen Sensorschichten ebenfalls flexible leitende und geerdete Abschirmungsfolien eingearbeitet sind, damit eine Messsignalstörung durch Umgebungslicht und externe elektromagnetische Einstrahlung unterbunden werden kann.

Patentansprüche

35 1. Verfahren zur nichtinvasiven Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung, umfassend die folgenden Schritte:

- Beaufschlagen eines Messareals einer Extremität, in welcher zumindest zeitweise durch passives und/oder aktives Bewegen der Extremität eine bewegungskorrelierte Blutvolumenänderung hervorgerufen wird, mit Strahlung mit mindestens zwei Messwellenlängen,
- 40 - Empfangen der reflektierten und/oder zurückgestreuten und/oder transmittierten Strahlung mit mindestens einem Detektor und
- Analysieren mindestens eines Detektorsignals, sodass ein DC- und ein AC-Anteil der venösen, bewegungskorrelierten Blutvolumenänderung in der Extremität bei jeder der verwendeten Messwellenlängen selektiv ermittelbar ist, was wiederum die Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung ermöglicht.

45 2. Verfahren nach Anspruch 1, ferner umfassend das zumindest zeitweise passive und/oder aktive Bewegen der Extremität.

50 3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die dermalvenöse Sauerstoffsättigung bestimmt wird, insbesondere die Sauerstoffsättigung von oberen und/oder unteren Extremitäten, insbesondere peripherer Beinegebiete.

55 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Analysieren von einer Auswerteeinheit durchgeführt wird, die detektornah angeordnet ist und keine spektralen Manipulationen an dem mindestens einen gemessenen (elektrischen) Detektorausgangssignal, insbesondere dem Perfusionssignal, stattfinden, sodass insbesondere hämodynamische Informationsverluste reduziert, insbesondere ausgeschlossen, werden.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Detektorausgangssignal einer digitalen Filtereinheit zugeführt wird, wo zumindest durch frequenzselektive Bewertung die DC- und AC-Anteile der venösen (Perfusions-)Signale errechnet werden, vorzugsweise für alle verwendeten Messwellenlängen getrennt.
- 5
6. Verfahren nach Anspruch 5,
wobei in einer weiteren digitalen Filtereinheit die DC- und AC-Anteile der arteriellen (Perfusions-)Signale errechnet werden, vorzugsweise für alle verwendeten Messwellenlängen getrennt, vorzugsweise beruhend auf einem Ausgangssignal des Detektors in einer Phase vor oder nach einer Phase, in der die passive und/oder aktive Bewegung der Extremität stattfindet.
- 10
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass aus venösen und arteriellen DC- und AC-Wertepaaren sowohl die arterielle als auch die venöse Sauerstoffsättigung bestimmt wird.
- 15
8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass aus den Werten der arteriellen und venösen Sauerstoffsättigung transkutan die Sauerstoffsättigungsdifferenz zwischen dem arteriellen und dem venösen Gefäßbett bestimmt wird.
- 20
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegung der Extremität eine aktive Beinübung durch den Patienten und/oder eine externe Beinübung durch den Untersucher (manuelle Blutvolumendrainage) und/oder eine passive Beinübung durch wiederholte Hoch- und Tieflagerung der Extremität ist.
- 25
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Außenseite der Sensoroberfläche (weg vom Gewebe) eines Sensors, der den Detektor umfasst, aus lichtundurchlässigem Material ausgebildet ist und zwischen den beiden äußeren flexiblen Sensorschichten ebenfalls flexible leitende und geerdete Abschirmungsfolien eingearbeitet sind.
- 30
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Frequenz der Bewegung der Extremität geringer als 1 Hz ist, vorzugsweise etwa 0,5 Hz.
- 35
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass neben der Bestimmung der venösen Sauerstoffversorgung auch die venöse Auffüllzeit bestimmt wird.
13. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass**
- 40
- die Strahlungsquelle(n) und der Detektor von einem Sensor umfasst sind,
 - als Strahlungsquellen zwei selektive Lichtquellen verwendet werden und der Detektor ein Lichtdetektor ist,
 - das Analysieren von einer Steuer- und Auswerteelektronik durchgeführt wird,
 - das Analysieren des mindestens einen Detektorausgangssignals Digitalisieren und Filtern umfasst,
 - die venöse Sauerstoffsättigung eine dermalvenöse Sauerstoffsättigung peripherer Beingebiete ist,
 - das Licht von dem Messareal und den darunterliegenden Schichten reflektiert respektive zurückgestreut wird,
 - ein Sensor in flacher und/oder biegsamer Bauweise ausgeführt ist, so dass seine Anpassung an das gewählte Gewebearealprofil gewährleistet ist und somit die Detektion der Strahlung sowohl im Reflexions- als auch Transmissionsmodus stattfinden kann, und
 - die Detektorausgangssignale derart digitalisiert und gefiltert werden, dass der DC- und AC-Anteil bei jeder der verwendeten Messwellenlängen selektiv ermittelt werden kann, was die Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung im transilluminierten Gewebavolumen unter dem Sensor ermöglicht.
- 50
14. Vorrichtung oder System zur nichtinvasiven Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung,
- 55
- mit mindestens einer, vorzugsweise zwei Strahlungsquellen zur Erzeugung von Strahlung mit mindestens zwei Messwellenlängen, wobei die Strahlung ein Messareal einer Extremität beaufschlagt,
 - mit mindestens einem Detektor, der die reflektierte und/oder zurückgestreute und/oder transmittierte Strahlung empfängt, und

- mit einer mit dem Detektor verbundenen Auswerteelektronik zur Analyse mindestens eines Detektorausgangssignals,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Auswerteelektronik eingerichtet ist, das mindestens eine Detektorausgangssignal derart zu analysieren, dass ein DC- und ein AC-Anteil der venösen, bewegungskorrelierten Blutvolumenänderung in der Extremität bei jeder der verwendeten Messwellenlängen selektiv ermittelbar ist, was wiederum die Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung ermöglicht, wobei die bewegungskorrelierte Blutvolumenänderung durch passive und/oder aktive Bewegung der Extremität verursacht ist.

15. Verwendung einer Vorrichtung oder eines Systems zur nichtinvasiven Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung einer Extremität, in der zumindest zeitweise durch passive und/oder aktive Bewegung eine bewegungskorrelierte Blutvolumenänderung verursacht wird, wobei die Vorrichtung oder das System folgendes umfasst:

- mindestens eine, vorzugsweise zwei Strahlungsquellen zur Erzeugung von Strahlung mit mindestens zwei Messwellenlängen, wobei die Strahlung ein Messareal der Extremität beaufschlagt,

- mindestens einen Detektor, der die reflektierte und/oder zurückgestreute und/oder transmittierte Strahlung empfängt, und

- eine mit dem Detektor verbundene Auswerteelektronik zur Analyse mindestens eines Detektorausgangssignals, wobei die Auswerteelektronik eingerichtet ist, das mindestens eine Detektorausgangssignal derart zu analysieren, dass ein DC- und ein AC-Anteil der venösen, bewegungskorrelierten Blutvolumenänderung in der Extremität bei jeder der verwendeten Messwellenlängen selektiv ermittelbar ist, was wiederum die Bestimmung der venösen Sauerstoffsättigung ermöglicht.

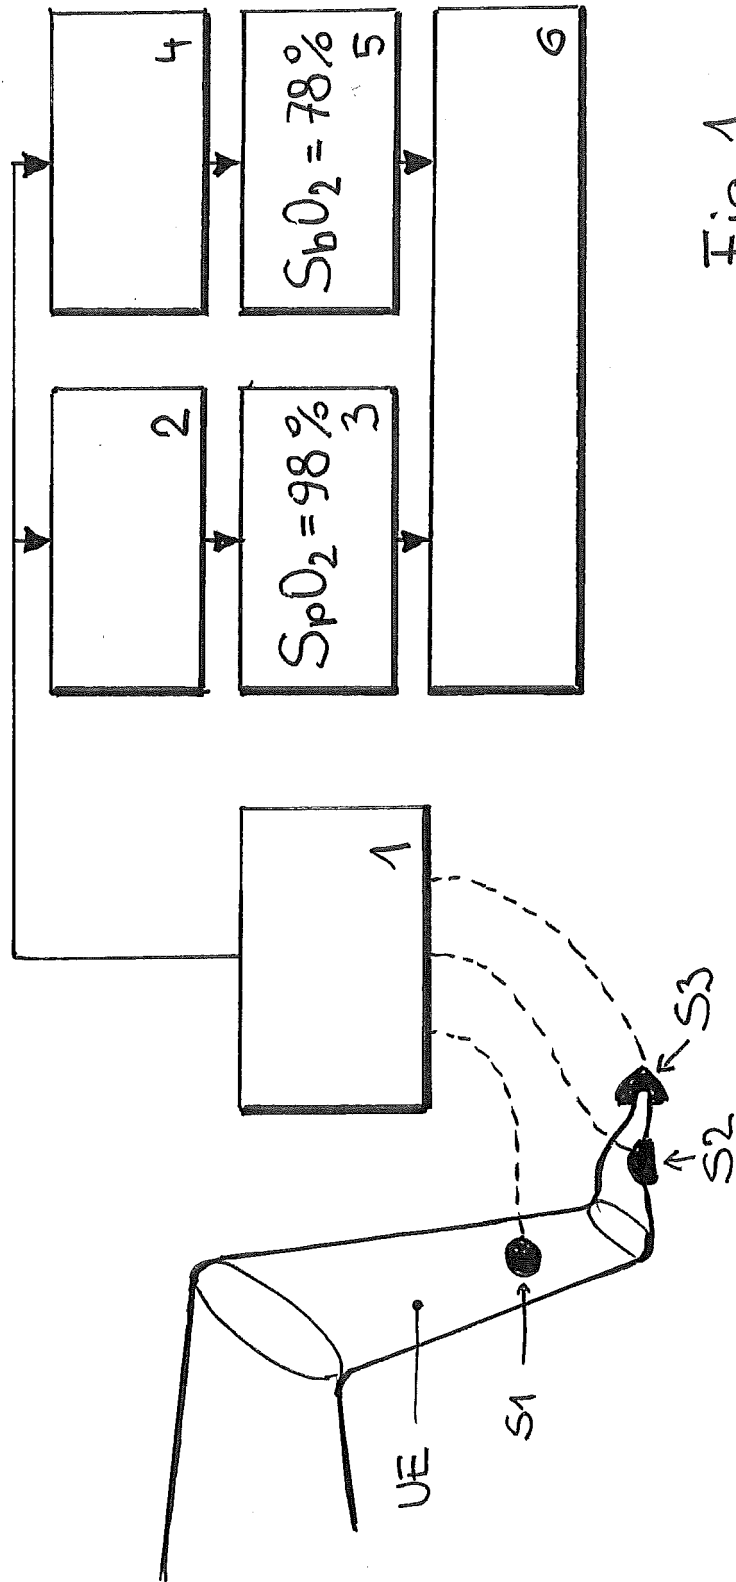
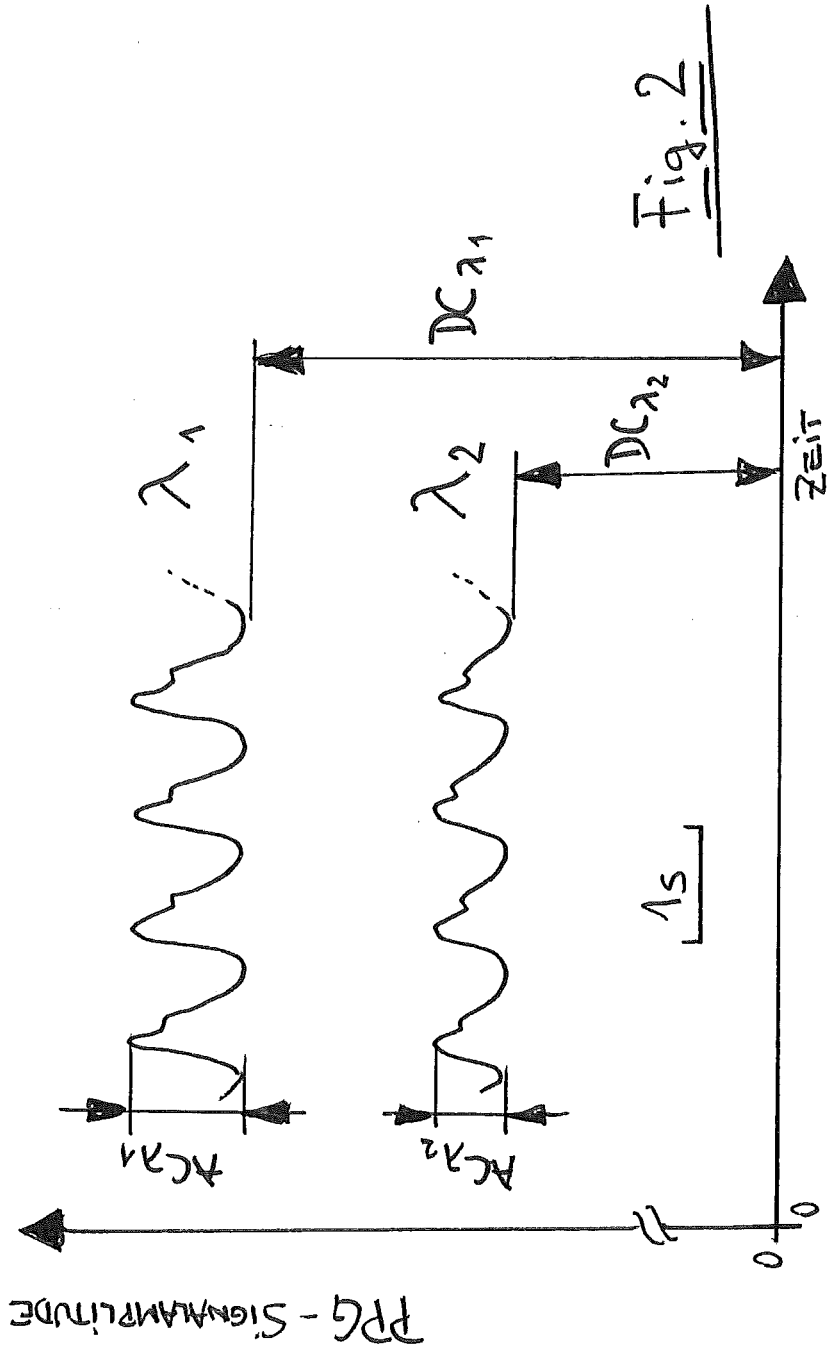


Fig. 1



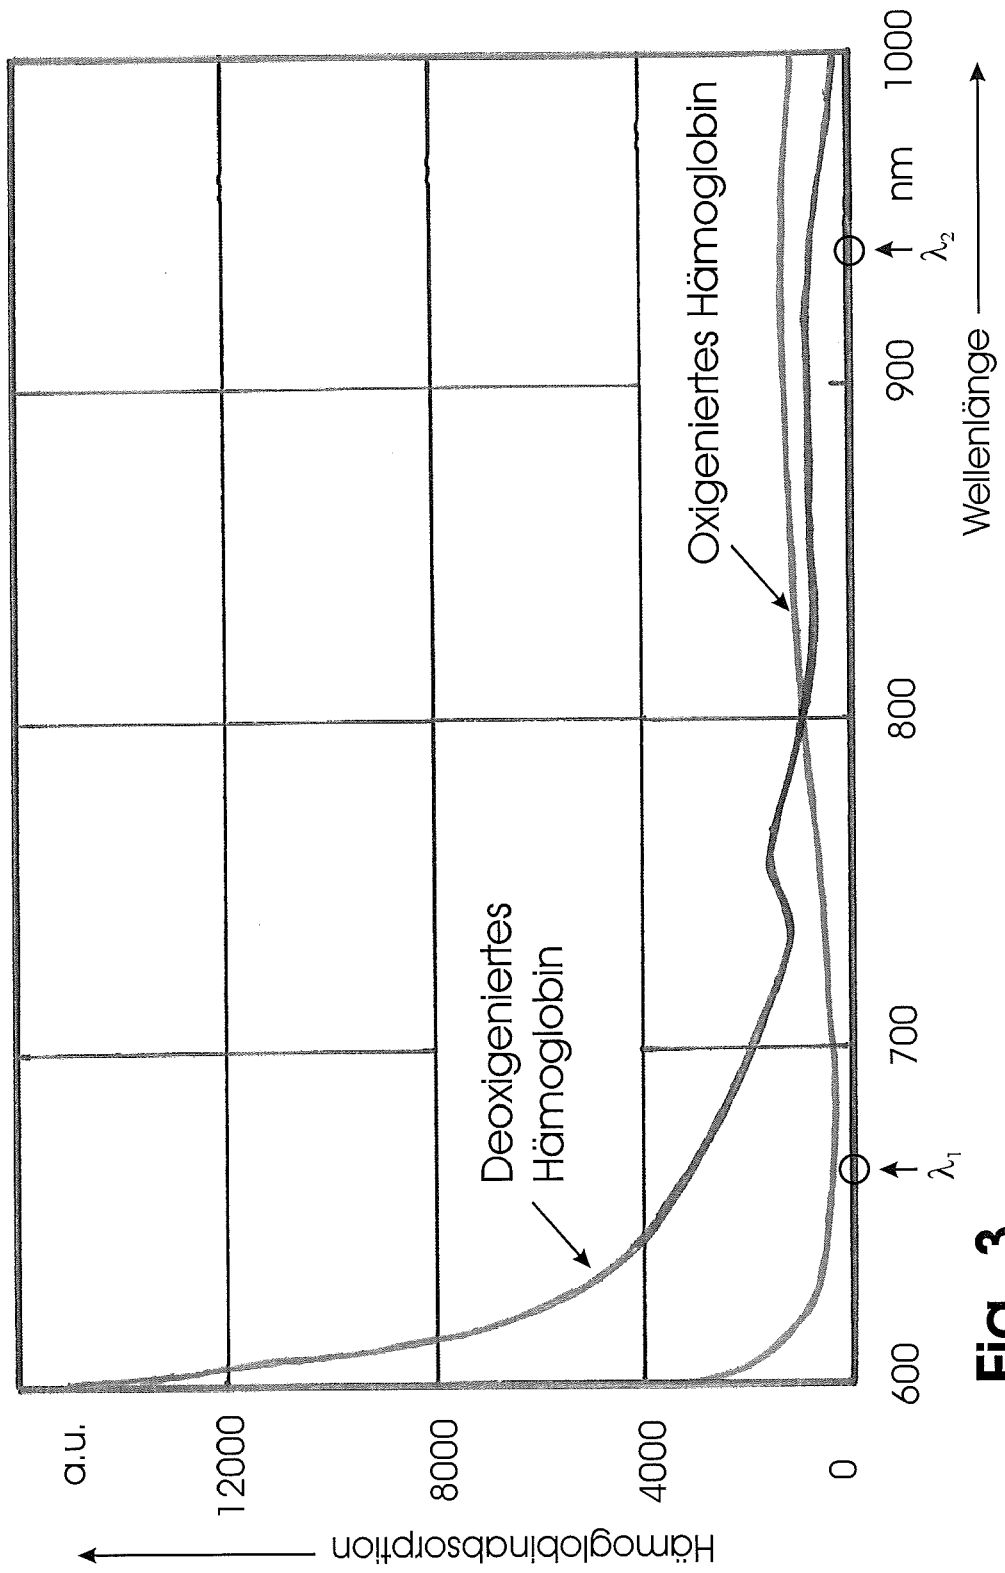


Fig. 3

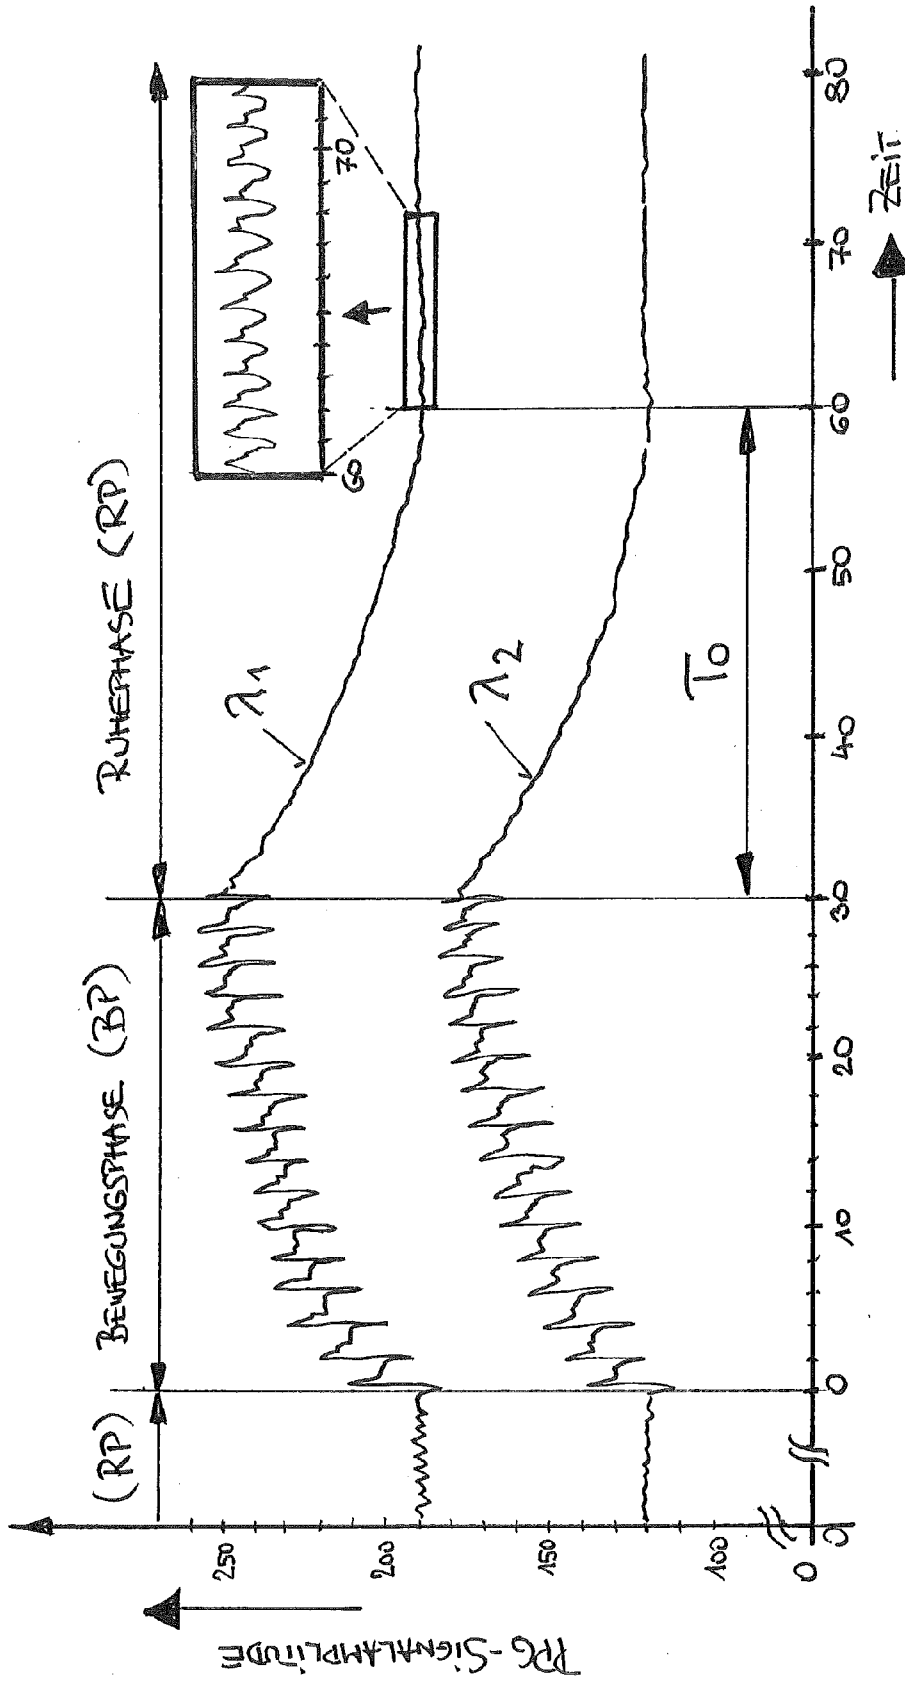
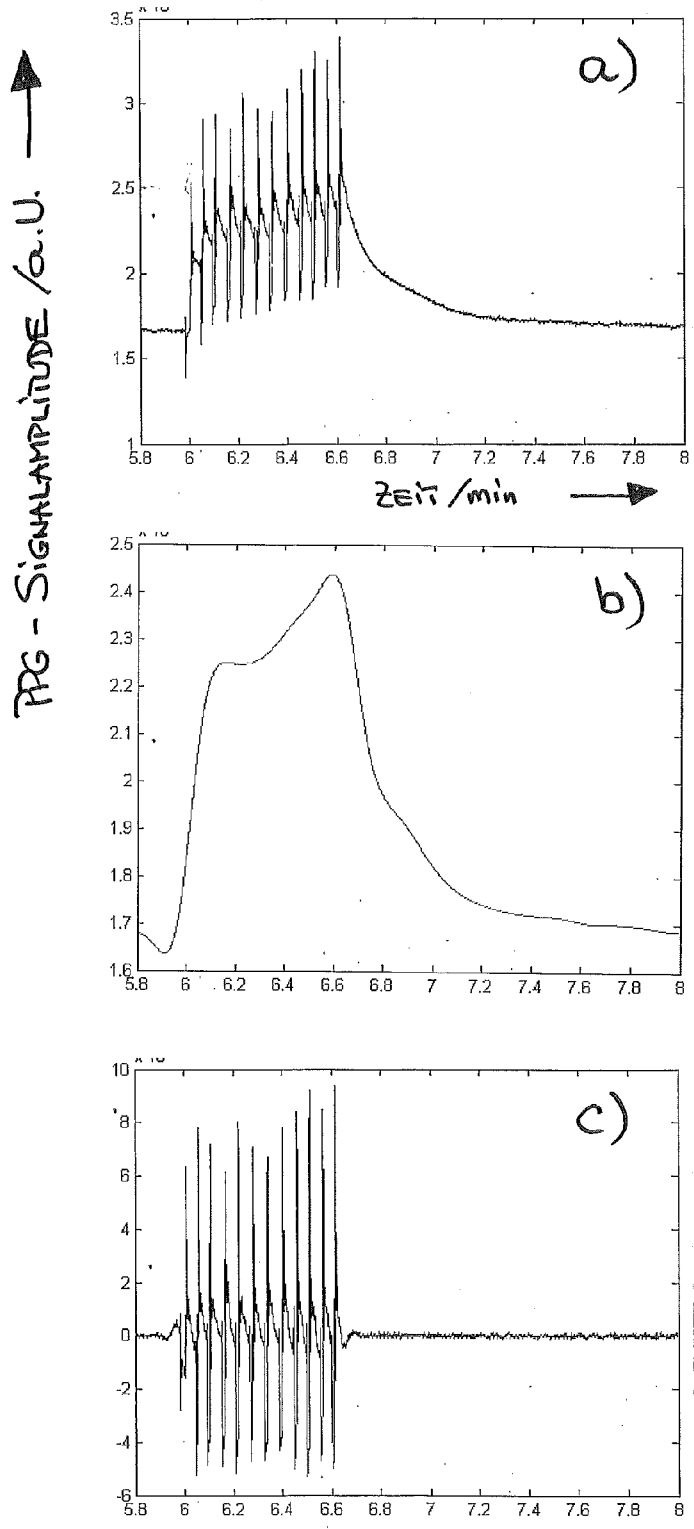


Fig. 4



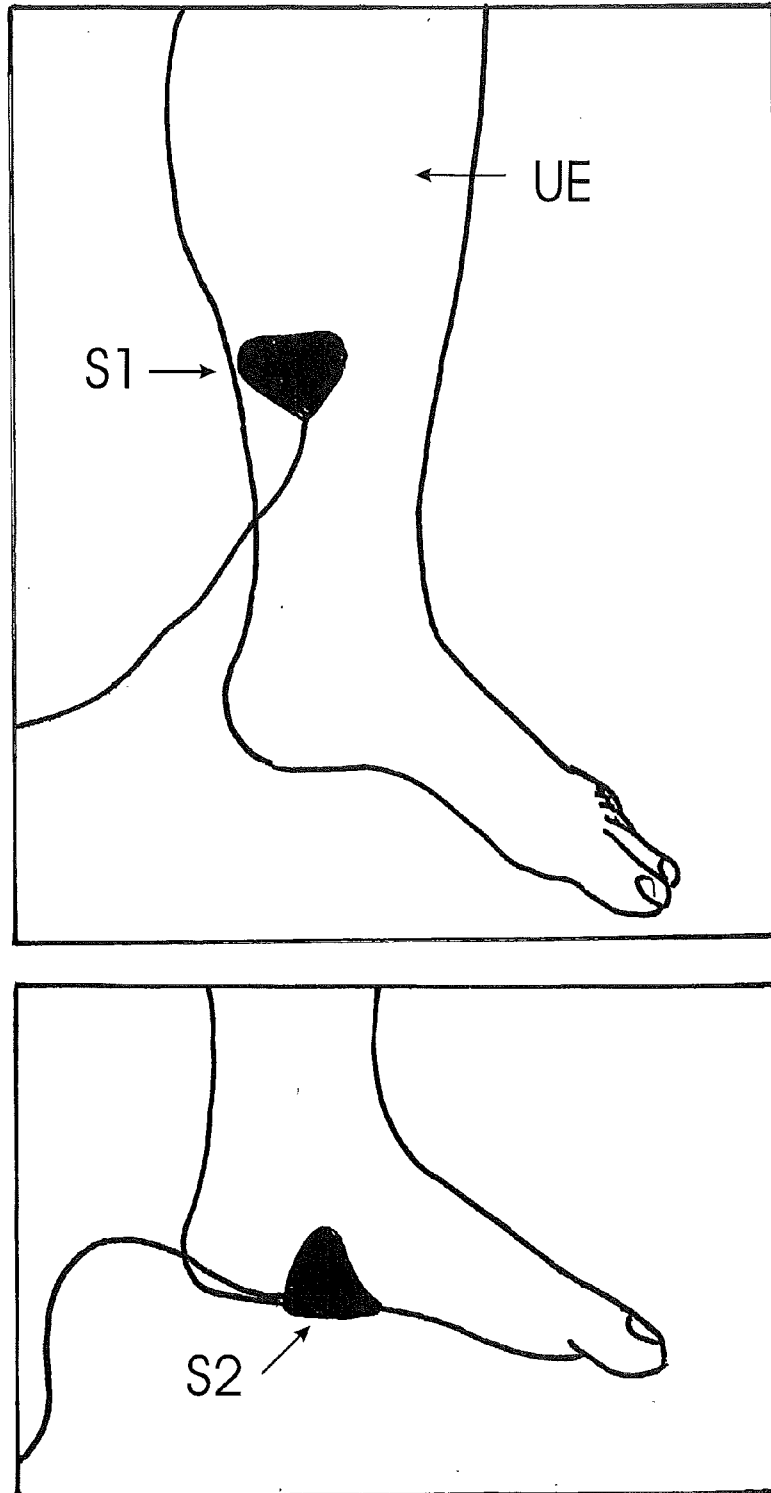


Fig. 6



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 12 19 9633

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	US 6 334 065 B1 (AL-ALI AMMAR [US] ET AL) 25. Dezember 2001 (2001-12-25)	1,3,5-8, 14,15	INV. A61B5/00
Y	* Spalte 5, Zeile 15 - Spalte 12, Zeile 17 * * Spalte 13, Zeile 37 - Spalte 14, Zeile 19 * * Spalte 18, Zeile 7 - Spalte 20, Zeile 30 *	4,10,13	A61B5/024 A61B5/026 A61B5/1455
Y	----- ASADA H H ET AL: "Mobile monitoring with wearable photoplethysmographic biosensors", IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY MAGAZINE, IEEE SERVICE CENTER, PISACATAWAY, NJ, US, Bd. 22, Nr. 3, 1. Mai 2003 (2003-05-01), Seiten 28-40, XP011098587, ISSN: 0739-5175, DOI: 10.1109/MEMB.2003.1213624 * das ganze Dokument *	4,10,13	
X	----- DE 42 38 641 A1 (KRAUS MANFRED [DE]; WALDMANN JUERGEN PROF DR [DE]; BILZ DIETRICH DR [D]) 19. Mai 1994 (1994-05-19)	1,2,5,6, 9,11,12, 14,15	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) A61B
Y	* Seite 5, Zeile 67 - Seite 10, Zeile 46 *	4,10,13	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 24. April 2013	Prüfer Strubel, Christine
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

1
EPO FORM 1503 03.02 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 12 19 9633

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patendokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

24-04-2013

Im Recherchenbericht angeführtes Patendokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6334065	B1	25-12-2001	AT 521277 T 15-09-2011
			AU 4214199 A 20-12-1999
			CA 2333062 A1 09-12-1999
			EP 1082050 A1 14-03-2001
			EP 2319398 A1 11-05-2011
			JP 2002516689 A 11-06-2002
			US 6334065 B1 25-12-2001
			US 2002082488 A1 27-06-2002
			US 2004059209 A1 25-03-2004
			US 2005197551 A1 08-09-2005
			US 2006258923 A1 16-11-2006
			US 2006258924 A1 16-11-2006
			US 2006258925 A1 16-11-2006
			US 2006270920 A1 30-11-2006
			US 2006281983 A1 14-12-2006
			WO 9962399 A1 09-12-1999

DE 4238641	A1	19-05-1994	KEINE

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- DE 3100610 [0002]

专利名称(译)	运动相关方法和光电器件用于非侵入性地确定腿部周围区域的真皮静脉氧供应		
公开(公告)号	EP2609854A1	公开(公告)日	2013-07-03
申请号	EP2012199633	申请日	2012-12-28
[标]申请(专利权)人(译)	BLAZEK CLAUDIA R		
[标]发明人	DIE ERFINDERNENNUNG LIEGT NOCH NICHT VOR		
发明人	DIE ERFINDERNENNUNG LIEGT NOCH NICHT VOR		
IPC分类号	A61B5/00 A61B5/024 A61B5/026 A61B5/1455		
CPC分类号	A61B5/0295 A61B5/14551 A61B5/4884 A61B5/6826 A61B5/6829		
审查员(译)	STRUBEL , CHRISTINE		
优先权	102011122700 2011-12-31 DE		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

该装置具有光检测器，该光检测器与用于分析检测器输出信号的控制和评估电子系统相连。传感器被设计成更平坦和灵活的设计，使得传感器的适应性保证选定的组织区域轮廓，并且灌注信号检测在反射和传输模式中执行。用测量波长确定静脉直流 (DC) - 和交流 (AC) 比例的运动相关的血容量变化，以允许确定透射照射的静脉血管组织中的氧饱和度。光检测器接收反射光，并且传感器包括两个选择性光源。还包括一项独立权利要求，用于无创测定周围腿部区域的皮肤 - 静脉氧供应的方法。

