



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
**14.06.2017 Patentblatt 2017/24**

(51) Int Cl.:  
**A61B 5/00 (2006.01) A61B 5/0408 (2006.01)**

(21) Anmeldenummer: **15199683.2**

(22) Anmeldetag: **11.12.2015**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR**  
 Benannte Erstreckungsstaaten:  
**BA ME**  
 Benannte Validierungsstaaten:  
**MA MD**

(72) Erfinder:  
 • **Klepp, Nikolaus**  
**4810 Gmunden (AT)**  
 • **Eichenauer, Heinz**  
**8524 Bad Gans (AT)**

(74) Vertreter: **Jell, Friedrich**  
**Bismarckstrasse 9**  
**4020 Linz (AT)**


(71) Anmelder: **Tracer Systems GmbH**  
**8510 Stainz (AT)**

(54) **VORRICHTUNG ZUR MESSUNG DER ELEKTRISCHEN HERZAKTION EINES TIERES**

(57) Es wird eine Vorrichtung (1) zur Messung der elektrischen Herzaktion eines Tieres gezeigt, mit einem Gurt (2) und mit zumindest zwei am Gurt (2) vorgesehenen Elektroden (3), die je eine in Querrichtung (4) des Gurts (2) konvex gekrümmte Kontaktfläche (5) aufweisen. Um eine Vorrichtung zur Messung der elektrischen Herzaktion eines Tieres standfester zu gestalten und deren Tragekomfort zu erhöhen, wird vorgeschlagen, dass

die konvex gekrümmten Kontaktflächen (5) mehrere Krümmungsabschnitte (6, 7) aufweisen, von denen die Krümmung des ersten Krümmungsabschnitts (7), der den Scheitelbereich der Kontaktfläche (5) ausbildet, geringer als die Krümmung eines an diesen ersten Krümmungsabschnitt (7) anschließenden zweiten Krümmungsabschnitts (6) ist.

*Fig. 1*

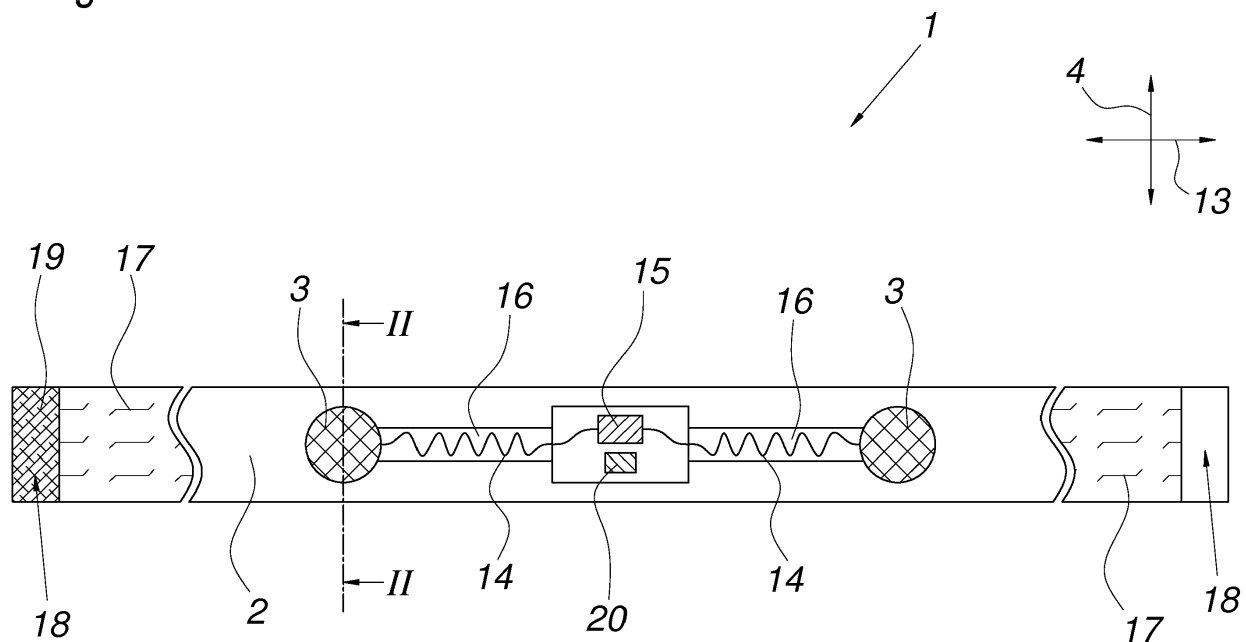

## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Messung der elektrischen Herzaktion eines Tieres mit einem Gurt und mit zumindest zwei am Gurt vorgesehenen Elektroden, die je eine in Querrichtung des Gurts konvex gekrümmte Kontaktfläche aufweisen.

**[0002]** Um die Herzfrequenz bzw. der Herzratenvariabilität eines behaarten Tiers messen zu können, ist aus dem Stand der Technik eine als Gurt ausgebildete Vorrichtung bekannt (DE202012100735U1), deren durch Unterlegematerial aufgebrachte Elektroden in Querrichtung des Gurts konvex gekrümmte Kontaktflächen ausbilden. Nachteilig führen derart geformte Kontaktflächen mit steigender Tragedauer zur Bildung von Druckstellen und/oder zu Verletzungen am Tier, wodurch sowohl dessen Leistungsfähigkeit als auch die Verwendungsdauer des Gurts eingeschränkt werden. Zudem können derartige Gurte aufgrund eines schmerzbedingten Tragestresses für das Tier die Messergebnisse verfälschen und in weiterer Folge deren Messgenauigkeit beeinträchtigt.

**[0003]** Die Erfindung hat sich daher die Aufgabe gestellt, eine aus dem Stand der Technik bekannte Vorrichtung zur Messung der elektrischen Herzaktion eines Tieres dahingehend konstruktiv zu verbessern, dass mit dieser trotz einfacher Handhabung standfest genaue Messergebnisse aufgenommen werden können. Außerdem soll die Vorrichtung einen hohen Tragekomfort aufweisen.

**[0004]** Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe dadurch, dass die konvex gekrümmten Kontaktflächen mehrere Krümmungsabschnitte aufweisen, von denen die Krümmung des ersten Krümmungsabschnitts, der den Scheitelpunkt der Kontaktfläche ausbildet, geringer als die Krümmung eines an diesen ersten Krümmungsabschnitt anschließenden zweiten Krümmungsabschnitts ist.

**[0005]** Weisen die konvex gekrümmten Kontaktflächen mehrere Krümmungsabschnitte auf, von denen die Krümmung des ersten Krümmungsabschnitts, der den Scheitelpunkt der Kontaktfläche ausbildet, geringer als die Krümmung eines an diesen ersten Krümmungsabschnitt anschließenden zweiten Krümmungsabschnitts ist, kann damit sowohl die Handhabung als auch die Messgenauigkeit der Vorrichtung deutlich verbessert werden. So kann zunächst der zweite Krümmungsabschnitt mit der größeren Krümmung dafür sorgen, dass selbst ein eventuell vorhandenes, dichtes Fell leichter durchdrungen wird, um die Elektroden standfest in Kontakt mit der Haut des Tiers zu bringen bzw. zu halten. Daher bedarf es auch keiner Verwendung eines leitfähigen Gels bzw. eines Abrasierens des Fells an den entsprechenden Stellen, was die Handhabung der Vorrichtung erheblich erleichtern kann.

Durch den ersten daran anschließenden Krümmungsabschnitt mit der im Vergleich zum zweiten Krümmungsabschnitt kleineren Krümmung kann in weiterer Folge sichergestellt werden, dass der vordere Bereich der Elek-

trode gegenüber dem zweiten Krümmungsabschnitt abgeflachter verläuft, sodass die ansonsten bei großer Krümmung bekannten Druckstellen und/oder Verletzungen am Tier ausbleiben können. Der Tragekomfort der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann daher gegenüber dem Stand der Technik deutlich verbessert werden.

Zudem kann ein schmerzbedingter Tragestress vermieden werden, was das Auftreten verfälschter Messergebnisse reduziert. Die Standfestigkeit der Messdatenerfassung der Vorrichtung kann somit wesentlich erhöht werden. Erfindungsgemäß wird so eine einfach handzuhabende und zuverlässig genaue Ergebnisse liefernde Vorrichtung zur Messung der elektrischen Herzaktion eines Tieres zur Verfügung gestellt.

**[0006]** Im Allgemeinen wird festgehalten, dass unter elektrischer Herzaktion sowohl die Herzrate bzw. Herzfrequenz des Tieres als auch die Herzratenvariabilität (HRV) und weitere Parameter verstanden werden können, die aus der Herzkurve abgeleitet werden.

**[0007]** Im Allgemeinen wird weiter festgehalten, dass unter der Krümmung eines Krümmungsabschnitts dessen durchschnittliche Krümmung verstanden werden kann. So ist es vorstellbar, dass sich die Krümmung der Kontaktfläche beispielsweise kontinuierlich bis zum Scheitelpunkt verringert. Eine derartige Elektrode könnte etwa einen elliptischen Querschnitt aufweisen.

**[0008]** Die Elektroden können konstruktiv einfach gestaltet werden, wenn die Krümmungsabschnitte je eine im Wesentlichen konstante Krümmung aufweisen. Dabei ist es vorstellbar, dass die unterschiedlichen Krümmungsabschnitte beispielsweise durch einzelne unterschiedliche Krümmungsradien beschrieben werden, wodurch sich eine einfach herzustellende Elektrode ergeben kann. Vorzugsweise lässt sich der Querschnitt der Elektrode, in Querrichtung des Gurts, in Kreise mit den entsprechenden Krümmungsradien einhüllen.

**[0009]** Weist die Kontaktfläche einen dritten Krümmungsabschnitt auf, in dem die Krümmungen der beiden aneinander anschließenden ersten und zweiten Krümmungsabschnitte fließend ineinander übergehen, kann eine eventuell scharfkantige Unstetigkeit im Übergang zwischen den beiden Krümmungsabschnitten vermieden werden. Der Tragekomfort der Vorrichtung kann sich damit weiter verbessern.

**[0010]** Der Kontaktsicherheit der Elektroden mit dem Tier kann weiter gesteigert werden, wenn die Elektroden in Längsrichtung des Gurtes eine konvexe Krümmung aufweisen. Damit ist nämlich erreichbar, dass die Elektroden in ihrem Durchdringungsvermögen durch das Fell weiter verbessert werden. Eine zuverlässig funktionierende Vorrichtung zur Messung der Herzaktion kann dadurch geschaffen werden.

**[0011]** Weisen die Elektroden eine radialsymmetrische Form auf, so kann der konstruktive Aufwand an der Vorrichtung reduziert werden. Insbesondere ist die Form der Elektroden als abgeflachter Kugelabschnitt darstellbar, wobei die Kugelradien der unterschiedlichen Krümmungsabschnitte ineinander übergehen. Außerdem

kann diese Form einen besonders hohen Tragkomfort bieten und also eine zuverlässige und genaue Messung der Herzaktion eines Tieres ermöglichen.

**[0012]** Unter anderem kann die Signaldämpfung zwischen Elektroden und Messelektronik reduziert werden, wenn die Vorrichtung eine Messelektronik aufweist, die mit den Elektroden über elektrische Leitungen verbunden ist. Dies kann die Messgenauigkeit der Vorrichtung weiter erhöhen.

**[0013]** Die oben genannten Vorteile können weiter verbessert werden, wenn die elektrischen Leitungen im Gurt eingebettet sind. So lässt sich die Vorrichtung robuster gegenüber äußeren Einflüssen gestalten und kann Fehlfunktionen durch einwirkende mechanische oder chemische Einflüsse vorbeugen.

**[0014]** Verlaufen die elektrischen Leitungen mäandrierend längs des Gurts, kann dies auch bei Zugbelastungen auf den Gurt eine sichere elektrische Verbindung gewährleisten. Die Standfestigkeit des Gurts kann dadurch erhöht werden.

**[0015]** Besteht der Gurt zumindest bereichsweise aus einem elastischen Material, so kann der Tragekomfort der Vorrichtung zusätzlich verbessert werden. Zudem können aufgrund der Elastizität Druckstellen vermieden und eine konstante Vorspannung auf die Elektroden ausgeübt werden, um den Kontakt der Elektroden zur Haut ebenfalls zuverlässiger auszubilden.

**[0016]** Ein einfaches Vorsehen der Vorrichtung an einem Tier kann ermöglicht werden, wenn der Gurt verschließbar und wieder öffnbar ausgebildet ist. So kann die Vorrichtung etwa um den Bauch des Tieres gelegt werden, und am Rücken verschlossen werden. Im Allgemeinen sind als Verschluss etwa Klettverschlüsse, Hakenverschlüsse, Schnallen oder Knöpfe vorstellbar.

**[0017]** Weist die Vorrichtung zudem eine Telematik-einrichtung zur Übertragung der Messdaten an einen Empfänger auf, so kann eine kabellose Verbindung zwischen Anzeige- bzw. Aufnahmegerät und Messelektronik der Vorrichtung geschaffen werden. Damit kann die Handhabung der Vorrichtung weiter verbessert und vereinfacht werden. Zudem sind Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöhbar, da keine Kabelverbindungen über den Körper des Tieres gelegt werden müssen.

**[0018]** In den Figuren ist beispielsweise der Erfindungsgegenstand anhand eines Ausführungsbeispiels näher dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 eine Querschnittsansicht durch die Vorrichtung in Längsrichtung,

Fig. 2 eine abgerissene Schnittansicht entlang II gemäß Fig. 1.

**[0019]** Gemäß Fig. 1 wird eine Vorrichtung 1 zur Messung der elektrischen Herzaktion eines nicht näher dargestellten Tieres gezeigt. Hierzu weist die Vorrichtung 1 einen Gurt 2 auf, an dem zwei elektrisch leitende Elektroden 3 vorgesehen sind. Diese Elektroden 3 bestehen aus einem gegen Körperschweiß resistenten Material,

beispielsweise Edelstahl oder beschichtetes Metall etc., da diese mit der Haut eines Tieres in Kontakt gebracht werden müssen, um die Herzaktion bzw. die Herzkurve des Tieres messen zu können. Zur Herstellung des Kontakts weisen die Elektroden 3 in Querrichtung 4 des Gurtes 2 eine konvex gekrümmte Kontaktfläche 5 auf, wodurch die Elektrode 3 besonders leicht das Fell des Tieres zur Haut hin durchdringen kann. Die konvex gekrümmte Kontaktfläche 5 ist in der Fig. 2 insbesondere dargestellt.

**[0020]** Trotz der Funktion des erleichterten Durchdringens des Fells durch die Elektrode 3 kann das Tier vor einem aversiven Sinneserlebnis (Schmerzempfinden) geschützt bleiben, indem die erfindungsgemäße Kontaktfläche 5 mehrere Krümmungsabschnitte 6, 7 aufweist. Dabei ist die Krümmung des ersten Krümmungsabschnitts 7, der den Scheitelbereich der Kontaktfläche 5 ausbildet, geringer als die Krümmung eines an diesen ersten Krümmungsabschnitt 7 anschließenden zweiten Krümmungsabschnitts 6. Dadurch kann eine Abflachung 21 im Scheitelbereich an der Kontaktfläche 5 der Elektrode 3 ausgebildet werden, womit Druckstellen und/oder Verletzungen am Tier vermieden werden. Ein schmerzbedingter Tragestress tritt daher nicht ein, wodurch die Erfindung stets äußerst genaue Messergebnisse sicherstellen kann.

**[0021]** Wie im Ausführungsbeispiel dargestellt, können die einzelnen Krümmungsabschnitte 6, 7 dabei eine im Wesentlichen konstante Krümmung aufweisen. In diesem Fall können die Krümmungsabschnitte 6, 7 als Bereiche mit konstanten Krümmungsradien 8, 9 angesehen werden, wobei Krümmungsabschnitte 6, 7 der Kontaktfläche 5 jeweils in die zugehörigen Kreiskonturen 10, 11 der Krümmungsradien 8, 9 eingeschrieben werden können.

**[0022]** Um einen stufen- und kantenlosen Übergang zwischen den Krümmungsabschnitten 6, 7 zu erreichen, ist jeweils zwischen den aneinander anschließenden Krümmungsabschnitten 6, 7 mit konstanter Krümmung ein dritter Krümmungsabschnitt 12 angeordnet, in denen die Krümmungen der Krümmungsabschnitte 6, 7 fließend, also ohne Ausbildung von Kanten oder dergleichen, ineinander übergehen.

**[0023]** Wie in Fig. 1 zu erkennen, weisen die Elektroden 3 in Längsrichtung 13 des Gurtes 2 ebenso eine konvexe Krümmung auf. Insbesondere sind die Elektroden 3 radialsymmetrisch ausgeführt. Der Querschnitt der Elektroden 3 in Querrichtung 4 des Gurtes 2 - wie in Fig. 2 gezeigt - entspricht demgemäß exakt dem Querschnitt der Elektroden 3 in Längsrichtung 13 des Gurtes 2. Die in Fig. 2 gezeigten Kreiskonturen 10, 11 der Krümmungsabschnitte 6, 7 entsprechen also dreidimensionalen Kreisoberflächen. Eine derart geformte Elektrode 3 weist eine besonders vorteilhafte Durchdringungsfähigkeit des Tierfells auf und ermöglicht eine zuverlässige und genaue Messung der Herzaktion des Tieres. Es wird erwähnt, dass sich die erfindungsgemäße Vorrichtung insbesondere aber nicht ausschließlich zur Anwendung bei Pferden bewähren kann.

**[0024]** In Fig. 1 ist weiter zu erkennen, dass die Elektroden 3 über elektrische Leitungen 14 mit einer Messelektronik 15 verbunden sind. Die Leitungen 14 verlaufen in Längsrichtung des Gurts mäanderförmig, wodurch die Leitung 14 standfest Längsdehnungen des Gurts aufnehmen kann.

**[0025]** Die Messelektronik 15 ist vorteilhafterweise auf dem Gurt 2 vorgesehen, um lange Leitungen 14 zu vermeiden und damit etwa eine hohe Messgenauigkeit zu ermöglichen. Besonders vorteilhaft kann zudem sein, wenn die Leitungen 14 in dem Gurt 2, in einer Verkapselung 16 eingebettet sind (beispielsweise in einer Vergussmasse). Dadurch können die Leitungen 14 vor äußeren Einflüssen geschützt und die Messgenauigkeit weiter erhöht werden.

**[0026]** In Fig. 1 ist weiter angedeutet, dass der Gurt 2 abschnittsweise ein elastisches Material 17 aufweisen kann. Dadurch ist eine einfache Anpassung an den Tierkörper erreichbar. Zudem kann eine Überspannung des Gurts 2 und damit eine Druckstellenbildung beim Tier vermieden werden. An den Enden des Gurts 2 sind Verschlüsse 18 angebracht. Diese sind schematisch als Klettverschluss 19 dargestellt. Es kann sich bei den Verschlüssen 18 jedoch auch um Schnallen, Knöpfe oder Hakenverschlüsse handeln.

**[0027]** Zudem weist die Vorrichtung 1 auf dem Gurt 2 eine Telematikeinrichtung 20 auf, welche die von der Elektronik 15 aufgezeichneten Messdaten an einen nicht näher dargestellten Empfänger kabellos übertragen kann.

#### Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Messung der elektrischen Herzaktion eines Tieres, mit einem Gurt (2) und mit zumindest zwei am Gurt (2) vorgesehenen Elektroden (3), die je eine in Querrichtung (4) des Gurts (2) konvex gekrümmte Kontaktfläche (5) aufweisen, **dadurch gekennzeichnet, dass** die konvex gekrümmten Kontaktflächen (5) mehrere Krümmungsabschnitte (6, 7) aufweisen, von denen die Krümmung des ersten Krümmungsabschnitts (7), der den Scheitelbereich der Kontaktfläche (5) ausbildet, geringer als die Krümmung eines an diesen ersten Krümmungsabschnitt (7) anschließenden zweiten Krümmungsabschnitts (6) ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Krümmungsabschnitte (6, 7) jeweils eine im Wesentlichen konstante Krümmung aufweisen.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Kontaktfläche (5) einen dritten Krümmungsabschnitt (12) aufweist, in dem die Krümmungen der beiden aneinander anschließenden ersten und zweiten Krümmungsabschnitte (6,

7) fließend ineinander übergehen.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Elektroden (3) in Längsrichtung (13) des Gurtes (2) eine konvexe Krümmung aufweisen.
5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Elektroden (3) eine radialsymmetrische Form aufweisen.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Vorrichtung eine Messelektronik (15) aufweist, die mit den Elektroden (3) über elektrische Leitungen (14) verbunden ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die elektrischen Leitungen (14) im Gurt (2) eingebettet sind.
8. Vorrichtung nach Anspruch 6 oder 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** die elektrischen Leitungen (14) mäanderförmig längs des Gurts (2) verlaufen.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Gurt (2) zumindest bereichsweise aus einem elastischen Material (17) besteht.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Gurt (2) verschließbar und wieder öffnbar ausgebildet ist.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Vorrichtung (1) eine Telematikeinrichtung (20) zur Übertragung der Messdaten an einen Empfänger aufweist.

Fig. 1


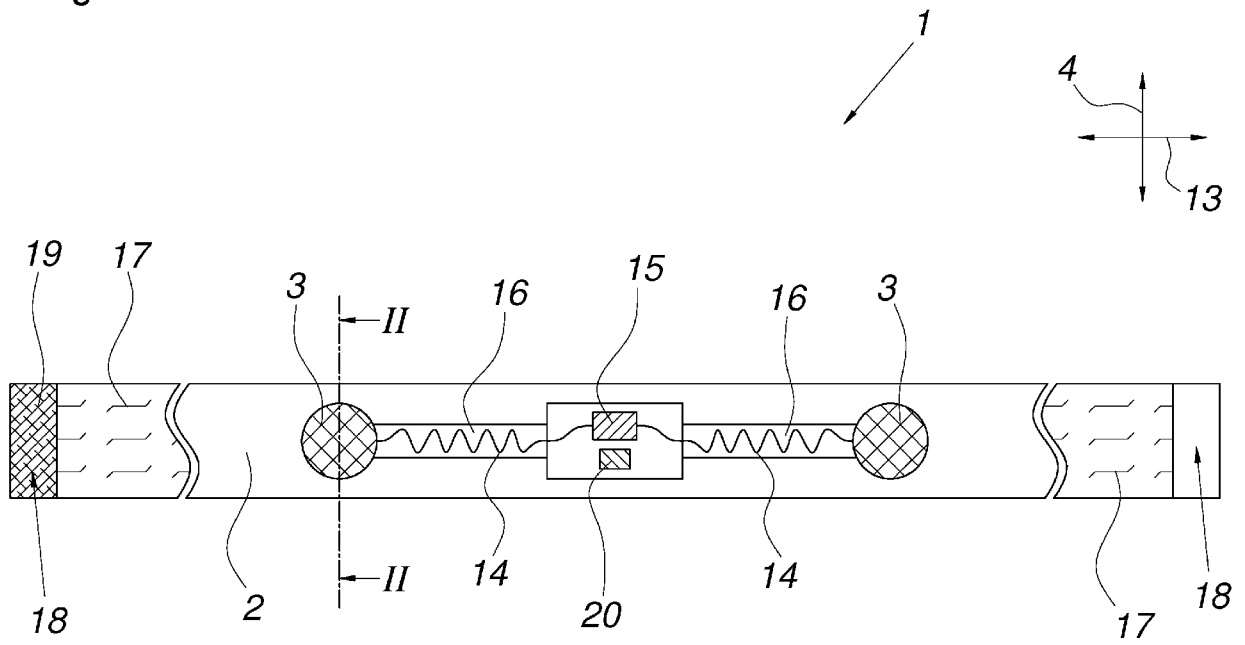


Fig. 2



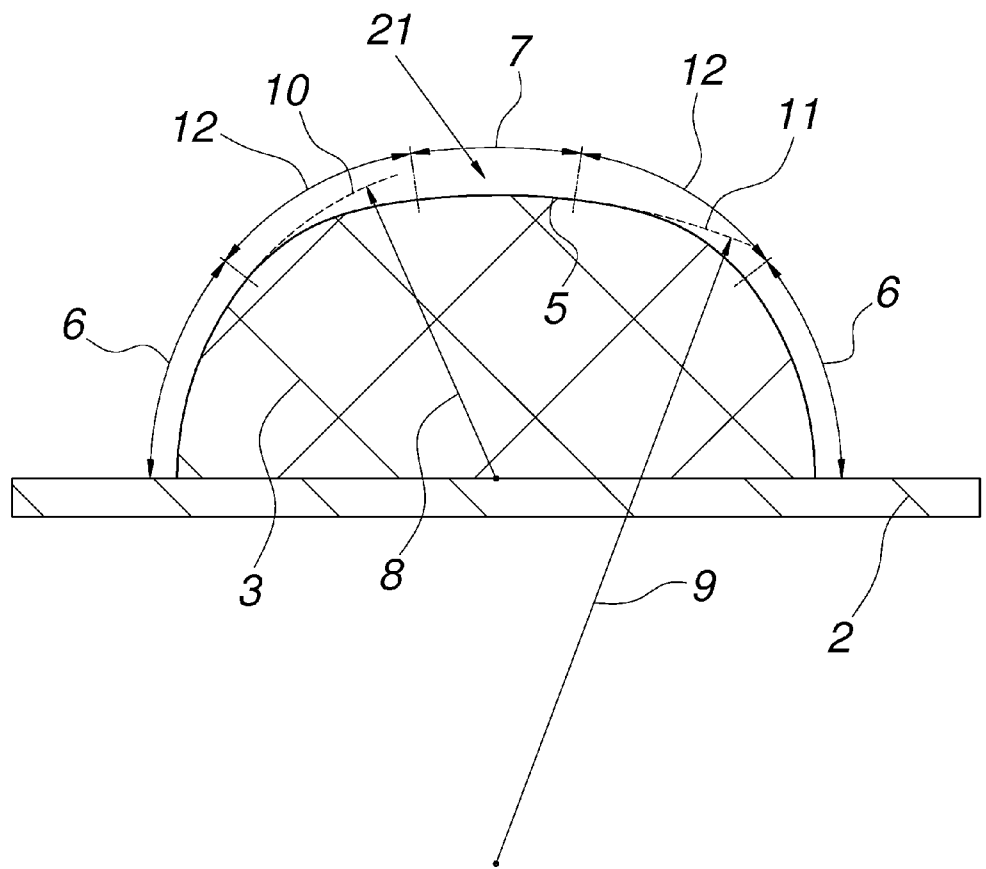

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 15 19 9683

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
Y,D	DE 20 2012 100735 U1 (FBN LEIBNIZ INST FUER NUTZTIERBIOLOGIE [DE]) 4. Juni 2013 (2013-06-04) * Absätze [0042], [0047]; Abbildungen 1,4A,4B, 6A *	1-11	INV. A61B5/00 A61B5/0408
Y	EP 1 649 805 A1 (DRAEGER MEDICAL AG [DE]) 26. April 2006 (2006-04-26) * Absätze [0027], [0037]; Abbildung 2 *	1-11	
A	DE 298 23 970 U1 (GRANZOTTO ARTEMIO [CH]) 7. September 2000 (2000-09-07) * Seite 3, Zeilen 19-29 * * Seite 4, Zeile 18 - Seite 5, Zeile 17; Abbildungen 1-5 *	1-11	
A	US 8 201 330 B1 (ROOD AARON [US] ET AL) 19. Juni 2012 (2012-06-19) * Spalte 3, Zeilen 45-63 * * Spalte 19, Zeilen 33-67; Abbildungen 9-11 *	1-11	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			A61B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Berlin		Abschlußdatum der Recherche 17. Mai 2016	Prüfer Trachterna, Morten
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 15 19 9683

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

17-05-2016

10	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
	DE 202012100735 U1	04-06-2013	DE 202012100735 U1 EP 2633807 A1	04-06-2013 04-09-2013
15	EP 1649805 A1	26-04-2006	EP 1649805 A1 US 2006084855 A1 US 2010049027 A1	26-04-2006 20-04-2006 25-02-2010
20	DE 29823970 U1	07-09-2000	DE 29823970 U1 WO 9833432 A1	07-09-2000 06-08-1998
25	US 8201330 B1	19-06-2012	KEINE	
30				
35				
40				
45				
50				
55				

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE**

*Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.*

**In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente**

- DE 202012100735 U1 [0002]

专利名称(译)	用于测量动物的电心脏活动的装置		
公开(公告)号	<a href="#">EP3178378A1</a>	公开(公告)日	2017-06-14
申请号	EP2015199683	申请日	2015-12-11
[标]发明人	KLEPP NIKOLAUS EICHENAUER HEINZ		
发明人	KLEPP, NIKOLAUS EICHENAUER, HEINZ		
IPC分类号	A61B5/00 A61B5/0408		
CPC分类号	A61B5/6831 A61B5/0006 A61B5/04085		
审查员(译)	TRACHTERNA, MORTEN		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

示出了用于测量动物的心脏动作的装置 (1)，其具有皮带 (2) 并且在皮带 (2) 上设置有至少两个电极 (3)，每个电极在皮带 (2) 的横向方向 (4) 上。具有凸出弯曲的接触表面 (5)。为了使用于测量动物的心脏动作的装置更稳定并增加其佩戴舒适性，建议凸出弯曲的接触表面 (5) 具有多个弯曲部分 (6,7)，其中第一弯曲部分 (7) 的曲率，形成接触表面 (5) 的顶点区域的小于邻接该第一弯曲部分 (7) 的第二弯曲部分 (6) 的曲率。

