

(19)



(11)

EP 2 243 423 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
27.10.2010 Patentblatt 2010/43

(51) Int Cl.:
A61B 5/00^(2006.01) A61M 5/172^(2006.01)

(21) Anmeldenummer: **09450088.1**

(22) Anmeldetag: **23.04.2009**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA RS

(72) Erfinder:
• **Krainz, Michael**
8043 Graz (AT)
• **Leiner, Marco Jean-Pierre**
8045 Graz (AT)

(71) Anmelder:
• **Roche Diagnostics GmbH**
68305 Mannheim (DE)
Benannte Vertragsstaaten:
DE
• **F. Hoffmann-La Roche AG**
4070 Basel (CH)
Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

(74) Vertreter: **Margotti, Herwig Franz**
Schwarz & Partner
Patentanwälte
Wipplingerstrasse 30
1010 Wien (AT)

(54) **Verfahren und Gerät zur Ermittlung von Empfehlungen für Wirkstoffdosierungen anhand von Messserien zumindest eines physiologischen Parameters eines Patienten**

(57) Das vorliegende Verfahren umfasst das Durchführen einer Serie von Messungen zumindest eines physiologischen Parameters, insbesondere Blutwertes, wie z.B. Blutzucker, an einem Patienten, wobei dem Patienten zu diskreten Messzeitpunkten (n) Proben (S) entnommen werden, an denen die Messungen durchgeführt werden. Aus den Messungen wird eine Empfehlung (DS) für eine Dosierung eines dem Patienten bis zum nächsten Messzeitpunkt zu verabreichenden Wirkstoffs ermittelt,

wozu ein den zumindest einen gemessenen physiologischen Parameter einbeziehender Dosierungsvorschlagsalgorithmus angewandt wird. Dadurch ist es möglich, zumindest einen physiologischen Parameter des Patienten auf einen Zielbereich einzustellen bzw. in dem Zielbereich zu halten. Der Dosierungsvorschlagsalgorithmus ist so ausgelegt, dass der nächste Messzeitpunkt (n+1, (n+1)', (n+1)'') unter Berücksichtigung von Messausschlusszeitfenstern (EX) ermittelt und gegebenenfalls der verantwortlichen Person mitgeteilt wird.

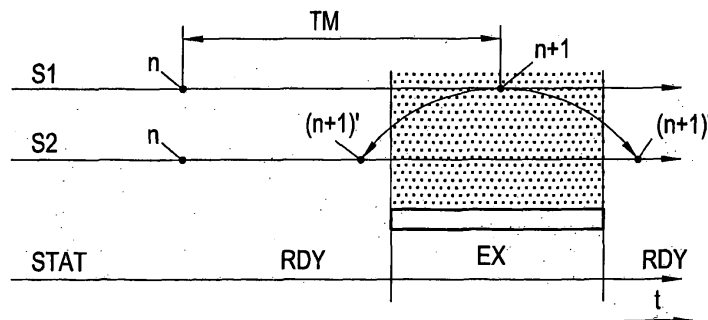


Fig. 2

EP 2 243 423 A1

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Durchführung einer Serie von Messungen zumindest eines physiologischen Parameters, insbesondere Blutwertes, wie z.B. Blutzucker, an Proben, die einem Patienten zu diskreten Messzeitpunkten entnommen werden, und zur Errechnung einer Empfehlung für eine Dosierung zumindest eines dem Patienten bis zum nächsten Messzeitpunkt zu verabreichenden Wirkstoffs anhand eines den zumindest einen gemessenen physiologischen Parameter einbeziehenden Dosierungsvorschlagsalgorithmus, wodurch zumindest ein physiologischer Parameter des Patienten auf einen Zielbereich eingestellt bzw. in diesem Zielbereich gehalten wird.

[0002] Die Erfindung betrifft weiters ein medizinisch-diagnostisches Analysegerät zur Durchführung des obigen Verfahrens.

[0003] Bei vielen medizinischen Behandlungen von Patienten ist es erforderlich, gewisse physiologische Parameter des Patienten regelmäßig zu überwachen und mittels Wirkstoffgabe in einen-definierten-Wertebereich zu bringen bzw in diesem Wertebereich zu halten. Beispielsweise kann Hyperglykämie (d.h. zu hohe Blutzuckerwerte (über 110 mg/dl)) an Patienten postoperativ in der Intensivstation auch bei Nichtdiabetikern auftreten. Eine Normalisierung des Blutzuckerspiegels durch ständige Glukosemessung in Verbindung mit gezielter Insulingabe (Tight Glycemic Control) in dieser Phase führt zu einem signifikanten Abnehmen der Sterblichkeitsrate. Dieser Zusammenhang wurde 2001 erstmals in einer Studie erwähnt und seither mehrfach bestätigt. Es wurden bereits computer-implementierte Algorithmen entwickelt, die das Spitalspersonal bei der Dosierung der Insulingabe unterstützen. Ein solcher Algorithmus, der sich in der Praxis gut bewährt hat, wurde als "Glucommander"-Algorithmus von Forschern von Atlanta Diabetes Associates entwickelt und ist z.B. in dem Artikel "Intravenous Insulin Infusion Therapy: Indications, Methods, and Transition to Subcutaneous Insulin Therapy", Bode et al, ENDOCRINE PRACTICE, Vol 10 (Suppl 2) March/April 2004 sowie in einem Artikel von Davidson et al. in Diabetes Care, Vol. 20, Nr. 10, 2418-2423, 2005 beschrieben. Die Prinzipien des "Glucommander"-Algorithmus lassen sich in einem kartesischen Koordinatensystem mit dem Blutzuckerspiegel als Abszisse und einer Insulindosis [Einheiten pro Stunde] als Geradenbündel darstellen, wobei jede Gerade einen unterschiedlichen Multiplikator repräsentiert. Senkrechte Linien in diesem Diagramm definieren einen Blutzucker-Bereich, in den der Patient gebracht werden soll bzw. in dem er gehalten werden soll. Die Multiplikatorlinien weisen darauf hin, wie schnell die Veränderung des Blutzuckerspiegels erfolgen soll, in anderen Worten, wie hoch die Insulindosis bis zum nächsten Messzeitpunkt zu wählen ist. Nach jeder neuen Messung des Blutzuckerspiegels erfolgt eine Neubewertung der zu verabreichenden Wirkstoffdosis, wobei ein Wechsel des Multiplikators vorgenommen wer-

den kann. Die Messung des Blutzuckerspiegels kann mit einem handelsüblichen Blutglukosemessgerät, beispielsweise einem speziellem Blutglukosemessgerät oder auch einem Multiparametermessgerät wie beispielsweise einem Blutgasanalysator zur Bestimmung der Blutgase, Elektrolyte und Metabolite (Glukose, Laktat) vorgenommen werden.

[0004] Der "Glucommander"-Algorithmus hat sich zur Unterstützung des Pflegepersonals in der Intensivmedizin bewährt. Eine Voraussetzung für seine erfolgreiche Anwendung ist jedoch, dass die vorgeschriebenen Intervalle zwischen zwei Blutzuckerspiegel-Messungen exakt eingehalten werden. Dies kann aber aus verschiedenen Gründen nicht garantiert werden, sondern in der Praxis existieren Messausschlusszeitfenster, in denen keine Messungen möglich sind. Solche Messausschlusszeitfenster können messgerätebedingt auftreten, beispielsweise, wenn das Messgerät eine periodische Kalibrierung oder sonstige interne Wartungs- und Prüfvorgänge durchlaufen muss. Messausschlusszeitfenster können auch benutzerbedingt auftreten, beispielsweise, wenn ein Patient für gewisse Zeiten nicht für eine Blutzuckerspiegel-Messung zur Verfügung steht, weil er andere Untersuchungen oder Verrichtungen zu erledigen hat. Wenn Messausschlusszeitfenster mit vorgeschriebenen Zeitpunkten für Blutzuckerspiegel-Messungen zusammenfallen, wird die Empfehlung des "Glucommander"-Algorithmus suboptimal, eventuell sogar für den Patienten riskant. Blutzuckerwerte eines Patienten, insbesondere im postoperativen Bereich, nicht mehr kontrollieren zu können, erhöht stark das Risiko für das Auftreten von Hyper- oder Hypoglykämien.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung besteht nun darin, eine Lösung für das Problem zu finden, dass von einem zu überwachenden Patienten physiologische Parameter in einer Messserie erfasst werden müssen, um auf Basis dieser Messserie unter Anwendung eines Dosierungsvorschlagsalgorithmus eine Empfehlung für eine Dosierung eines dem Patienten bis zum nächsten Messzeitpunkt zu verabreichenden Wirkstoffs zu errechnen, wobei die empfohlene Dosierung auch dann nicht das gesundheitliche Risiko für den Patienten erhöhen darf, wenn die vorgesehenen Messzeitpunkte in Messausschlusszeitfenster fallen. Insbesondere besteht die Aufgabe der Erfindung darin, zu vermeiden, dass mit den wie oben beschrieben ermittelten Empfehlungswerten Blutzuckerwerte nicht mehr kontrolliert werden können und damit das Risiko für das Auftreten von Hyper- oder Hypoglykämien steigt, wenn die empfohlenen Messzeitpunkte nicht eingehalten werden können.

[0006] Die vorliegende Erfindung löst die gestellte Aufgabe durch das Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch Bereitstellen eines medizinisch-diagnostischen Analysegeräts mit den Merkmalen des Anspruchs 11. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Fortbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen dargestellt.

[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst das

Durchführen einer Serie von- Messungen zumindest eines physiologischen Parameters, insbesondere Blutwertes, wie z.B. Blutzucker, eines Patienten, wobei dem Patienten zu diskreten Messzeitpunkten Proben entnommen werden, an denen die Messungen durchgeführt werden. Aus den Messungen wird eine Empfehlung für eine Dosierung zumindest eines dem Patienten bis zum nächsten Messzeitpunkt zu verabreichenden Wirkstoffs ermittelt, wozu ein den zumindest einen gemessenen physiologischen Parameter einbeziehender Dosierungsvorschlagsalgorithmus angewandt wird. Dadurch ist es möglich, zumindest einen physiologischen Parameter des Patienten auf einen Zielbereich einzustellen bzw. in dem Zielbereich zu halten. Es sei erwähnt, dass der zumindest eine physiologische Parameter des Patienten, der auf einen Zielbereich eingestellt wird bzw. darin gehalten wird, nicht notwendigerweise jener physiologische Parameter ist, der in den Proben gemessen wird. Es liegt vielmehr auch im Rahmen der vorliegenden Erfindung, indirekte Messungen durchzuführen, d.h. einen physiologischen Parameter zu messen, der mit dem einzustellenden physiologischen Parameter in einem Zusammenhang steht und sich bei Wirkstoffverabreichung in einer mit dem einzustellenden physiologischen Parameter zusammenhängenden Weise verändert. Der Dosierungsvorschlagsalgorithmus ist so ausgelegt, dass der nächste Messzeitpunkt unter Berücksichtigung von vorbestimmten Messausschlusszeitfenstern ermittelt und der verantwortlichen Person mitgeteilt wird. In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung stellt der ermittelte nächste Messzeitpunkt eine Variable des Dosierungsvorschlagsalgorithmus dar, d.h. die Errechnung der vorgeschlagenen Wirkstoffdosis erfolgt unter Berücksichtigung veränderter Zeitintervalle zwischen den Messungen oder/und unter Neuberechnung des bei der nächsten Messung zu erwartenden Werts des zumindest einen physiologischen Parameters.

[0008] Der Begriff "Wirkstoff" ist so zu verstehen, dass er auch jegliche pharmazeutisch Präparation umfasst, die diesen Wirkstoff enthält.

[0009] Es liegt auch im Umfang der Erfindung, dass eine Vielzahl physiologischer Parameter gemessen werden, die der Dosierungsvorschlagsalgorithmus zur Berechnung der Dosierungsempfehlung für einen Wirkstoff heranzieht. Es ist an sich bekannt, mehrere physiologische Parameter zur Berechnung einer Dosierung bzw. Dosierungsempfehlung eines Wirkstoffs heranzuziehen, siehe z.B. US 2007/0168136 A.

[0010] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung bezieht der Dosierungsvorschlagsalgorithmus von einem Benutzer eingegebene Patientendaten, wie Gewicht, Ernährungsgewohnheiten, etc. bei der Errechnung der Empfehlung ein. Diese Maßnahme ist an sich bekannt, siehe z.B. WO 2008 057213, in der offenbart ist, dass mehrere physiologische Parameter (z.B. Gewicht, Körpertemperatur) zur Errechnung einer Dosierung eines Wirkstoffs (Insulin) herangezogen werden. Dabei ist zu unterscheiden zwischen bekannten, voreinstellbaren

Parametern, wie dem Gewicht des Patienten, und physiologischen Parametern, die laufend gemessen werden. Beide Gruppen von physiologischen Parametern können vom Dosierungsvorschlagsalgorithmus für die Berechnung einer Empfehlung einer Wirkstoffverabreichung herangezogen werden.

[0011] In einer Ausführungsform der Erfindung wird der nächste Messzeitpunkt ermittelt, indem zum letzten Messzeitpunkt ein Zeitintervall addiert und geprüft wird, ob der sich daraus ergebende vorläufige nächste Messzeitpunkt in einem Messausschlusszeitfenster liegt und, falls zutreffend, der nächste Messzeitpunkt außerhalb des Messausschlusszeitfensters verlegt wird. Bei dieser Ausführungsform braucht man nicht beachten, ob das Messausschlusszeitfenster analysegerätbedingt oder benutzerbedingt auftritt. Um eine mögliche Gesundheitsgefährdung des Patienten auszuschließen, ist vorgesehen, dass die Verlegung des nächsten Messzeitpunkts außerhalb des Messausschlusszeitfensters unter Vorausberechnung eines zu erwartenden Messwerts und einer Risikoabschätzung, ob der zu erwartende Messwert für den Zustand des Patienten akzeptabel ist, erfolgt. Alternativ dazu kann die Verlegung des nächsten Messzeitpunkts außerhalb des Messausschlusszeitfensters unter Risikoabschätzung einer für den Zustand des Patienten maximal zulässigen Zeitspanne zwischen zwei Messzeitpunkten erfolgen. Sollte sich bei den oben genannten Risikoabschätzungen ein unverträglich hohes Risiko ergeben, so wird an den Benutzer eine Warninformation ausgegeben, wobei optional der Messzeitpunkt vor das Messausschlusszeitfenster verlegt wird.

[0012] Falls das Messausschlusszeitfenster messgerätebedingt ist, so ist in einer Ausführungsform der Erfindung vorgesehen, dass, falls der berechnete vorläufige nächste Messzeitpunkt in dem Messausschlusszeitfenster liegt, das messgerätebedingte Messausschlusszeitfenster außerhalb des nächsten Messzeitpunkts verlegt wird. Diese Ausführungsform bietet den Vorteil, dass die Messungen und Dosierungsempfehlungen wie geplant weitergeführt werden können. Falls das Messausschlusszeitfenster benutzerbedingt ist, so ist in einer Ausführungsform der Erfindung vorgesehen, dass, falls der berechnete vorläufige nächste Messzeitpunkt in dem Messausschlusszeitfenster liegt, dem Benutzer vorgeschlagen wird, seine zum Messausschlusszeitfenster führenden Aktionen so zu verlegen, dass sie nicht mit den errechneten nächsten Messzeitpunkten kollidieren. Der Benutzer kann daraufhin das benutzerbedingte Messausschlusszeitfenster außerhalb des nächsten Messzeitpunkts verlegen, und gegebenenfalls auch nachfolgende benutzerbedingte Messausschlusszeitfenster verlegen. Diese Ausführungsform bietet den Vorteil, dass die Messungen und Dosierungsempfehlungen wie ursprünglich geplant weitergeführt werden können.

[0013] Ein medizinisch-diagnostisches Analysegerät zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens, das beispielsweise als Blutanalysegerät ausgebildet ist, umfasst zumindest einen Messsensor zur Messung zu-

mindest eines physiologischen Parameters an den Proben, die einem Patienten zu diskreten Messzeitpunkten entnommen werden. In einer Ausgestaltung des Analysegeräts ist zumindest eine Probenaufnahme zur Aufnahme der von einem Patienten zu diskreten Messzeitpunkten entnommenen Proben vorgesehen, wobei der zumindest eine Messsensor zur Messung des zumindest einen physiologischen Parameters an den Proben mit der zumindest einen Probenaufnahme kommuniziert. Die Messsignale des zumindest einen Messsensors werden von einer Recheneinheit erhalten und zu Messwerten des zumindest einen physiologischen Parameters aus den Messsignalen aufbereitet. Die Messwerte werden in einem den zumindest einen physiologischen Parameter einbeziehenden Dosierungsvorschlagsalgorithmus zur Errechnung einer Empfehlung für eine Dosierung zumindest eines dem Patienten bis zum nächsten Messzeitpunkt zu verabreichenden Wirkstoffs verwendet. Diese Empfehlung sowie Warnungen und andere Meldungen werden von der Recheneinheit über ein Ausgabeinterface an einen Benutzer ausgegeben. Bevorzugt ist die Recheneinheit dazu ausgebildet, das Verfahren parallel für eine Vielzahl von Patienten durchzuführen.

[0014] Zusammengefasst bietet die Erfindung die folgenden Vorteile:

- Der nächste Messzeitpunkt wird so festgelegt, dass das Messgerät sicher messbereit ist.
- Die Höhe der zu verabreichenden Wirkstoffdosis wird entsprechend dem Verschieben des Messzeitpunkts angepasst.
- Aufgrund der Berechnung des zu erwarteten Werts des physiologischen Parameters kann auf diverse Aktionen vorzeitig reagiert werden.
- Aufgrund der Kenntnis von Geräte- und/oder Benutzeraktionen kann der nächste Messzeitpunkt und die Empfehlung für die Wirkstoffdosierung optimiert werden.

[0015] Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 ein Schema eines erfindungsgemäßen medizinisch-diagnostischen Analysegeräts, mit dem das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt wird;

Figuren 2 und 3 schematische Zeitdiagramme zur Erläuterung von Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfahrens; und

Fig. 4 Blutzuckerspiegelverläufe eines Patienten über der Zeit in Abhängigkeit von Dosierungsempfehlungen.

[0016] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes medizinisch-diagnostisches Analysegerät 1 schematisch in einem Blockschaltbild dargestellt. Dieses medizinisch-diagnostische Analysegerät 1 umfasst eine Probenaufnahme 2 zur Aufnahme von einem Patienten zu diskreten Messzeitpunkten entnommenen Proben S, zumindest einen mit der Probenaufnahme kommunizierenden Messsensor 3 zur Messung zumindest eines physiologischen Parameters, insbesondere Blutwertes, wie z.B. Blutzucker, an den Proben S, weiters eine die Messsignale MS des zumindest einen Messsensors 3 erhaltende Recheneinheit 4 zur Aufbereitung von Messwerten der physiologischen Parameter aus den Messsignalen MS. Aus den Messwerten errechnet die Recheneinheit 4 eine Empfehlung für eine Dosierung zumindest eines dem Patienten bis zum nächsten Messzeitpunkt zu verabreichenden Wirkstoffs anhand eines den zumindest einen gemessenen physiologischen Parameter einbeziehenden Dosierungsvorschlagsalgorithmus. Die Recheneinheit 4 umfasst zumindest einen Prozessor 4a, einen Programmspeicher 4b und einen Arbeitsspeicher 4c, die untereinander durch ein Bussystem 4d verbunden sind. Soweit bisher beschrieben kann das Analysegerät 1 auf Basis eines handelsüblichen Blutgasanalysators zur Bestimmung der Blutgase, Elektrolyte und Metabolite (Glukose, Laktat) oder eines sonstigen Blutglukosemessgerätes aufgebaut sein, wie sie von der Anmelderin erzeugt und vertrieben werden.

[0017] Das erfindungsgemäße medizinisch-diagnostische Analysegerät unterscheidet sich von den bekannten Analysatoren durch einen darin implementierten Workflow zur Durchführung von Messserien und ein Verfahren (Algorithmus) zur Errechnung einer Empfehlung einer zu verabreichenden Wirkstoffdosis zwischen zwei Messzeitpunkten. Innerhalb der Messserie werden die relevanten physiologischen Parameter diskret über die Zeit durch manuelle Probenahme und Messung bestimmt. Alternativ sind auch automatisierte Probenahme- und/oder Messschritte möglich. Der Dosierungsvorschlagsalgorithmus ist als ausführbares Programm implementiert, das im Programmspeicher 4b abgelegt ist und von der Recheneinheit 4 abgearbeitet wird. Das Ergebnis der Berechnungen der Recheneinheit 4 ist eine Dosierungsempfehlung DS an einen Benutzer des Analysegeräts 1 für eine kontinuierliche oder periodische oder einem anderen Verabreichungsprofil folgende Abgabe zumindest eines Wirkstoffes an einen Patienten (z.B. mittels Infusionen), kann aber alternativ oder zusätzlich Warnungen AL und allgemeine Meldungen INF umfassen. Die Dosierungsempfehlung DS, Warnungen AL und Meldungen INF werden von der Recheneinheit 4 an ein Ausgabeinterface 5 übertragen, das z.B. als Display, Drucker, etc. realisiert ist. Das Analysegerät 1 ist so ausgelegt, dass die Recheneinheit 4 parallel für eine Vielzahl von Patienten Messserien durchführt und Wirkstoffdosierungsempfehlungen errechnet.

[0018] Zu beachten ist, dass es bei diesem Typ von medizinisch-diagnostischem Analysegerät 1 oft messge-

rätebedingte Messausschlusszeitfenster gibt, zu denen Geräteaktionen, wie zum Beispiel eine Systemkalibration, stattfinden müssen und zu denen infolge dessen keine Messungen durchgeführt werden können. Weiters können benutzerbedingte Messausschlusszeitfenster existieren, z.B. aufgrund arbeitsbedingter Umstände, die ebenfalls eine Messung verhindern.

[0019] Das erfindungsgemäße medizinisch-diagnostische Analysegerät 1 arbeitet solcherart, dass bei dem implementierten Dosierungsvorschlagsalgorithmus die Messausschlusszeitfenster berücksichtigt werden, wobei der ermittelte nächste Messzeitpunkt bevorzugt eine Variable des Dosierungsvorschlagsalgorithmus darstellt. Wie im Zeitdiagramm von Fig. 2 dargestellt, wird in einem ersten Schritt S1 der nächste Messzeitpunkt n+1 ermittelt, indem zum letzten Messzeitpunkt n ein Zeitintervall TM addiert und anschließend geprüft wird, ob der sich daraus ergebende vorläufige nächste Messzeitpunkt n+1 in einem Messausschlusszeitfenster EX liegt. Dies ist hier der Fall und daher wird in einem Schritt S2 der nächste Messzeitpunkt außerhalb des Messausschlusszeitfensters EX in einen Zeitraum RDY verlegt, zu dem das Analysegerät 1 betriebsbereit ist, wie in der Statuszeile STAT in Fig. 2 zu sehen ist. Die Verlegung des nächsten Messzeitpunkts kann dabei vor (n+1)' das Messausschlusszeitfenster EX erfolgen, oder dahinter (n+1)". Bei der Verlegung des nächsten Messzeitpunkts erfolgt gegebenenfalls auch eine entsprechende Anpassung der Wirkstoffdosis. Die Entscheidung, ob die Verlegung des nächsten Messzeitpunkts vor (n+1)' oder hinter (n+1)' das Messausschlusszeitfenster EX erfolgen soll, kann gemäß den folgenden Fallunterscheidungen getroffen werden:

- **Fall 1:** Der berechnete nächste Messzeitpunkt n+1 fällt in die erste Halbzeit des Messausschlusszeitfensters EX. Dann wird der Messzeitpunkt (n+1)' vor den Beginn des Messausschlusszeitfensters EX verlegt.

Ist der eingesetzte Dosierungsempfehlungsalgorithmus so ausgelegt, dass ein bestimmtes Zeitintervall TM_{min} (z.B. 15 min) zwischen aufeinanderfolgenden Messungen nicht unterschritten werden sollte, um zu verlässlichen Dosierungsempfehlungen für eine Wirkstoffgabe zu gelangen, können noch folgende speziellen Fallgestaltungen unterschieden werden:

- **Fall 1a:** Der berechnete nächste Messzeitpunkt n+1 fällt in die erste Halbzeit des Messausschlusszeitfensters EX und der zeitliche Abstand zwischen dem Zeitpunkt der aktuellen Messung n und einem gemäß obiger Annahme vor den Beginn des Messausschlusszeitfensters EX zu verlegenden Messzeitpunkts (n+1)' ist, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Dauer der Durchführung eines Messvorganges, kleiner als das nicht zu unterschreitende Zeitintervall TM_{min} . Um in diesem Fall das nicht zu un-

terschreitende Zeitintervall TM_{min} nicht zu unterschreiten, wird in diesem Fall der nächste Messzeitpunkt (n+1)" hinter das Ende des Messausschlusszeitfensters EX verlegt.

- **Fall 1b:** Der berechnete nächste Messzeitpunkt n+1 fällt in die erste Halbzeit des Messausschlusszeitfensters EX und der zeitliche Abstand zwischen dem Zeitpunkt der aktuellen Messung n und einem gemäß obiger Annahme vor den Beginn des Messausschlusszeitfensters EX zu verlegenden Messzeitpunkts (n+1)' ist, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Dauer der Durchführung eines Meßvorganges, größer als das nicht zu unterschreitende Zeitintervall TM_{min} . In diesem Fall wird der nächste Messzeitpunkt (n+1)' vor den Beginn des Messausschlusszeitfensters EX verlegt.

- **Fall 2:** Der berechnete nächste Messzeitpunkt n+1 fällt in die zweite Halbzeit oder exakt auf die Halbzeit des Messausschlusszeitfensters EX. Dann wird der nächste Messzeitpunkt (n+1)" hinter das Ende des Messausschlusszeitfensters EX verlegt.

Ist der eingesetzte Dosierungsempfehlungsalgorithmus so ausgelegt, dass ein bestimmtes Zeitintervall TM_{max} (z.B. 60 min) zwischen aufeinanderfolgenden Messungen nicht überschritten werden sollte, um zu verlässlichen Dosierungsempfehlungen für eine Wirkstoffgabe zu gelangen, können noch folgende speziellen Fallgestaltungen unterschieden werden:

- **Fall 2a:** Der berechnete nächste Messzeitpunkt n+1 fällt in die zweite Halbzeit oder exakt auf die Halbzeit des Messzeitausschlussfensters EX und der zeitliche Abstand zwischen dem Zeitpunkt der aktuellen Messung n und einem gemäß obiger Annahme nach den Beginn des Messausschlusszeitfensters EX zu verlegenden Messzeitpunkts (n+1)" ist, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Dauer der Durchführung eines Messvorganges, größer als das nicht zu überschreitende Zeitintervall TM_{max} . Um in diesem Fall das nicht zu überschreiten Zeitintervall TM_{max} nicht zu überschreiten, wird in diesem Fall der nächste Messzeitpunkt (n+1)' vor den Beginn des Messausschlusszeitfensters EX verlegt.

- **Fall 2b:** Der berechnete nächste Messzeitpunkt n+1 fällt in die zweite Halbzeit oder exakt auf die Halbzeit des Messzeitausschlussfensters EX und der zeitliche Abstand zwischen dem Zeitpunkt der aktuellen Messung n und einem gemäß obiger Annahme nach den Beginn des Messausschlusszeitfensters EX zu verlegenden Messzeitpunkts (n+1)" ist, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Dauer der Durchführung eines Messvorganges, kleiner als das nicht zu überschreitende Zeitintervall TM_{max} . In die-

sem Fall wird der nächste Messzeitpunkt (n+1)" hinter das Ende des Messausschlusszeitfensters EX verlegt.

Solche minimalen oder maximalen Zeitintervalle zwischen aufeinanderfolgenden Messzeitpunkten können insbesondere dann relevant werden, wenn gewährleistet sein sollte, dass aufeinanderfolgende Messzeitpunkte in möglichst regelmäßigen Abständen liegen, um eine möglichst optimale Einstellung des Patienten auf einen bestimmten Zielwert eines physiologischen Parameters, z.B. des Blutzuckerwertes, zu ermöglichen.

[0020] Bei der Berechnung der möglichen Verlegung des Messzeitpunkts bezieht ein solcher möglicher Dosierungsvorschlagsalgorithmus die folgenden Aspekte ein:

- Der Abstand zwischen der letzten Messung (n) und einer nach hinten verlegten Messung (n+1)" gewährleistet die Anforderung an das Risiko.
- Der zu erwartende vorausberechnete Messwert des physiologischen Parameters gewährleistet die Anforderung an das Risiko.

[0021] Bei Vor oder Rückverlegen des nächsten Messzeitpunkts kann der erwartete Messwert der Folgemessung des physiologischen Parameters vorausberechnet und in Abhängigkeit davon die empfohlene Wirkstoffdosis verändert werden, falls der vorausberechnete Messwert die Anforderung an das Risiko nicht gewährleistet, wie nachfolgend erläutert wird.

[0022] Fig. 4 zeigt ein beispielhaftes Diagramm eines Blutzuckerspiegels BG eines Patienten über der Zeit t. Zum Messzeitpunkt n erstellt der Dosierungsvorschlagsalgorithmus eine Dosierungsempfehlung DS zur Abgabe eines Wirkstoffs (in diesem Beispiel Insulin) an den Patienten. Die Dosierungsempfehlung DS ist so bemessen, dass der Verlauf des Blutzuckerspiegels BG(DS) zum Zeitpunkt n+1 der nächsten Messung einen Sollblutzuckerspiegel BGS erreichen sollte. Falls es nötig ist, den Zeitpunkt der nächsten Messung aufgrund von Messausschlusszeitfenstern nach vorne (n+1)' oder hinten (n+1)" zu verlegen, so wird sich zum vorverlegten Messzeitpunkt (n+1)' eine Abweichung D' vom Sollblutzuckerspiegel BGS nach oben bzw. zum rückverlegten Messzeitpunkts (n+1)" eine Abweichung D" nach unten einstellen. Der Dosierungsvorschlagsalgorithmus kann nun mittels Interpolation einerseits diese Abweichungen zum Zeitpunkt (n+1)', (n+1)" berücksichtigen, indem er als Sollwert des Blutzuckerspiegels die Differenzwerte berücksichtigt und bei einer Berechnung einer neuen Dosierungsempfehlung von diesen abweichenden Werten ausgeht. Er führt weiters eine Risikoabschätzung durch, ob die Abweichungen, speziell bei nach hinten verlegten Messzeitpunkten, eventuell so groß sind, dass Komplikationen für den Patienten zu berücksichtigen sind und

daher die Messzeitpunktverlegung aus Sicherheitsgründen inakzeptabel ist und der Benutzer gewarnt werden muss. Der Dosierungsvorschlagsalgorithmus kann aber auch die geänderten Messzeitpunkte (n+1)', (n+1)" insoweit berücksichtigen, dass er geänderte Dosierungsempfehlungen DS', DS" abgibt, die beim Patienten zu Blutzuckerspiegelverläufen BG(DS'), BG(DS") führen, die ein Erreichen des Sollblutzuckerspiegels BGS zu den geänderten Messzeitpunkten (n+1)', (n+1)" ermöglichen.

[0023] Anhand von Fallbeispielen werden nun weitere Ausführungsvarianten der Erfindung erläutert, wobei stets in einem Schritt S1 ein Zeitpunkt für die nächste Messung n+1 berechnet und dann geprüft wird, ob der berechnete nächste Messzeitpunkt n+1 in ein Messausschlusszeitfenster EX fällt, zu dem keine Messung durchgeführt werden kann, sei es gerätebedingt oder benutzerbedingt.

[0024] Fig. 3 zeigt ein Zeitdiagramm, bei dem Messausschlusszeitfenster durch Aktionen CL1, des Analysegeräts 1 auftreten, z.B. durch interne Kalibrierungsvorgänge, oder durch Aktionen US1 eines Benutzers auftreten. Wie aus der Zeile S2 und der Statuszeile STAT1 ersichtlich, würden die Aktionen CL1, US1 des Analysegeräts 1 bzw. des Benutzers mit dem sich aus dem Zeitabstand TM zum vorhergehenden Messzeitpunkt n errechneten Zeitpunkt n+1 der nächsten Messung zusammenfallen, d.h. ein Messausschlusszeitfenster EX definieren, das den Messzeitpunkt n+1 inkludiert. Um dies zu vermeiden, werden in einem Schritt S3 die geplanten Aktionen CL1 bzw. US 1 verlegt, und zwar nach entweder nach vorne (CL1', US1') oder nach hinten (CL1", US1"). Dies erfolgt unter Berücksichtigung der Gewährleistung der Anforderungen an das Risiko. Wie aus der Statuszeile STAT2 ersichtlich, fallen somit die sich aus der Verlegung der Aktionen des Analysegeräts ergebenden Messausschlusszeitfenster EX in Zeiten, die nicht mit dem geplanten Zeitpunkt n+1 der nächsten Messung zusammenfallen. Das heißt, das Analysegerät 1 ist zum geplanten Messzeitpunkt n+1 messbereit (RDY).

[0025] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung betrifft den Fall, dass das Messausschlusszeitfenster zu groß ist, um risikolos eine Verlegung des nächsten Messzeitpunkts durchzuführen. In diesem Fall verlegt der Algorithmus den Zeitpunkt für die nächste Messung vor das Messausschlusszeitfenster und gibt eine Warnung AL an den Benutzer aus, dass das Erreichen oder Aufrechterhalten der Zielwerte des physiologischen Parameters nicht gewährleistet ist und der Benutzer eigene Maßnahmen setzen muss.

[0026] Nachfolgend wird der Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens für das Anwendungsbeispiel der Überwachung von Blutwerten, insbesondere des Blutzuckerspiegels, von Patienten unter Verwendung des oben erläuterten Analysegeräts 1 beschrieben. Bei diesem Anwendungsfall werden die Blutzuckerwerte einer Vielzahl von Patienten im Point of Care Bereich (insbesondere Intensivstation) parallel, durch jeweils eine ei-

gene Messserie je Patient, mittels manueller Blutzuckermessungen überwacht. Nach jeder Blutzuckermessung wird für jeden Patienten durch einen entsprechenden Algorithmus eine Insulindosis empfohlen, welche bis zum nächsten Messzeitpunkt zu verabreichen ist. Ein erhöhter Glukosespiegel soll durch eine, mittels Dosierpumpe dauerhaft an den Patienten verabreichte Insulindosis gesenkt und innerhalb eines definierten Zielbereiches stabilisiert werden. Der Zeitpunkt der nächsten Messung wird zusammen mit der Insulindosis bestimmt und angezeigt. Weiters soll bei Erreichen dieses Zeitpunkts ein stiller Alarm (Anzeige) ausgelöst werden.

[0027] In den Einstellungen des Analysegeräts 1 können global (d.h. einheitlich für alle Patienten):

- das maximale Intervall zwischen zwei Messungen innerhalb einer Messserie und
- der Maximalwert der zu berechnenden Insulindosis

eingestellt werden.

[0028] In den Einstellungen des Analysegeräts 1 können weiters individuell (d.h. für jeden Patienten einzeln) Patientendaten, wie Geburtsdatum, Gewicht, Ernährungsgewohnheiten, Insulinsensitivitätsfaktoren etc., die der Dosierungsvorschlagsalgorithmus bei der Errechnung der Empfehlung (DS) für die Insulindosierung einbeziehen soll, eingestellt werden.

[0029] Eine Messserie wird während der Messung nach Eingabe der Patienten Identifikation (ID) gestartet. Das Startverhalten des Dosierungsvorschlagsalgorithmus (mild, normal, benutzerdefiniert), ein Startmultiplikator (0.5 bis 2.0) und ein Glukose-Zielwert (oder Zielbereich) können für jeden Patienten individuell bei, der ersten Messung festgelegt werden.

[0030] Die Blutentnahme (venös oder arteriell) erfolgt manuell mit konventionellen Probenahmegefäßen (Spritzen, o.ä.). Das Probenahmegefäß wird manuell mit dem Analysegerät 1 in Kontakt gebracht und die Messung gestartet, wonach automatisch zumindest ein Aliquot der Probe in das Analysegerät 1 eingesaugt wird und wonach die Messung erfolgt. Sobald der Glukose Wert am Analysegerät 1 gemessen ist, berechnet der implementierte Algorithmus auf Basis des gemessenen Glukosewertes die notwendige Insulindosis, die dem Patienten bis zum nächsten Messzeitpunkt dauerhaft mittels einer Dosierpumpe verabreicht werden soll. Der Zeitpunkt der nächsten Messung wird zusammen mit der Insulindosis angezeigt.

[0031] Die Daten werden in der Datenbank des Analysegeräts 1 abgespeichert und gegebenenfalls an ein LIS/HIS (Krankenhausinformationssystem) übertragen.

[0032] Der Benutzer dosiert die Insulingabe am Patienten mittels Dosierpumpe und muss die tatsächlich verabreichte Insulindosis am Analysengerät spätestens zu Beginn der nächstfolgenden Messung derselben Messserie bestätigen.

[0033] Optional kann der Benutzer dem Patienten eine geänderte Insulindosis verabreichen und muss diese,

zusammen mit einem Kommentar am Analysegerät 1 bestätigen.

[0034] In einer Alarmliste werden die bevorstehenden Messungen aller aktiven Messserien verwaltet, und das Analysegerät zeigt dem Benutzer mittels stillen Alarms an, dass eine Messung durchzuführen ist.

[0035] Optional kann der Benutzer während der Messung ein Trend-Diagramm des aktuellen Patienten aufrufen. Das Trend-Diagramm zeigt den gemessenen Glukose Wert und die tatsächlich verabreichte Insulindosis für den gesamten Zeitraum der Messserie oder ein Teil dieses Zeitraums.

[0036] Weiters kann der Benutzer in der Datenbank ein Trend-Diagramm für einen beliebigen Patienten aufrufen.

[0037] Der im Analysegerät 1 implementierte Dosierungsvorschlagsalgorithmus ist beispielsweise eine erfindungsgemäße Fortbildung des "Glucommander"-Algorithmus, wie im eingangs erwähnten Dokument "Intravenous Insulin Infusion Therapy: Indications, Methods, and Transition to Subcutaneous Insulin Therapy", Bode et al, ENDOCRINE PRACTICE, Vol 10 (Suppl 2) March/Aprl 2004 beschrieben.

[0038] Der "Glucoriumander"-Algorithmus beruht auf der Formel:

$$IR(k) = MM(k) \times (BG(k) - TH)$$

mit:

IR	Insulindosis [Einheiten pro Stunde]
k	Iterationsschritt [äquivalent zu Messzeitpunkten n, n+1, ..]
MM	Multiplikator
BG	Blutzuckerspiegel des Patienten
TH	Mindest-Blutzuckerschwelle, ab der Insulinverabreichung erfolgt, typisch auf 60 mg/dl festgelegt,

[0039] Der Multiplikator MM wird bei jedem Iterationsschritt neu festgelegt. Ein Anfangswert des Multiplikators MM für die erste Messung wird gewöhnlich auf 0,02 eingestellt. Für Folgemessungen kann der Arzt den Multiplikator mit einem "Agressivitätsfaktor" multiplizieren, der die Insulindosis mitdefiniert. Typische Werte dieses "Agressivitätsfaktors" sind mild 0.5, normal 1 or variabel 0.5 bis 2. Die iterationsschritte k, entsprechend dem Intervall TM zwischen zwei Messzeitpunkten n, n+1 (siehe Fig. 2) werden zunächst auf 30 Minuten festgelegt. Gemäß dem "Glucomznander"-Algorithmus wird der Multiplikator MM jede Stunde um 0,01 nachgestellt, um den SollBlutzuckerspiegel zu erreichen, Falls das Resultat eine Unterschreitung des Soll-Blutzuckerspiegels ist, so erfolgt eine Verringerung um 0,01; falls das Resultat ein Erreichen oder Beibehalten des Soll-Blutzuckerspiegels ist, so erfolgt keine Änderung; falls das Resultat über

dem Soll-Blutzuckerspiegel ist und der Blutzuckerspiegel sich nicht um 25% reduziert hat, so erfolgt eine Erhöhung um 0,01. Details des "Glucommander"-Algorithmus können insbesondere Appendix 3 des zitierten Artikels von Bode et al entnommen werden.

[0040] Der "Glucommander"-Algorithmus setzt voraus, dass die Abstände zwischen den Iterationsschritten k exakt eingehalten werden. Solange dies möglich ist, arbeitet der erfindungsgemäße Dosierungsvorschlagsalgorithmus gemäß dem "Glucommander"-Algorithmus, wobei die Dosierungsempfehlung DS der Insulindosis IR in obiger Formel entspricht. Wie oben ausgeführt, ist es entweder gerätebedingt oder benutzerbedingt nicht immer möglich, die Abstände zwischen den Iterationsschritten k exakt einzuhalten, d.h. es bestehen Messausschlusszeitfenster EX . Die vorliegende Erfindung bietet die besprochene Lösung für dieses Problem, indem die Messzeitpunkte außerhalb der Messausschlusszeitfenster EX verlegt werden (Fig. 2) oder die Messausschlusszeiten EX verlegt werden (Fig. 3). In der vorliegenden beispielhaften Implementierung des Dosierungsvorschlagsalgorithmus wird dies folgendermaßen gehandhabt:

[0041] Falls der vorläufige nächste Messzeitpunkt $n+1$ innerhalb des Messausschlusszeitfensters EX liegt, wird der nächste Messzeitpunkt nach vorne $(n+1)'$ oder hinten $(n+1)''$ verschoben, wie oben anhand der Fig. 2 erklärt worden ist, und zwar so, dass der Messzeitpunkt ein bestimmtes Zeitintervall, beispielsweise 5 Minuten, vom Beginn bzw. dem Ende des Zeitausschlussfensters EX entfernt ist.

[0042] Falls bei der Verlegung des Messzeitpunkts $(n+1)'$ nach vorne ein minimales Zeitintervall TM , beispielsweise von weniger als 15 Minuten, unterschritten würde, so interpretiert die Risikoabschätzung des Dosierungsvorschlagsalgorithmus diese Zeitspanne als zu kurz, um bei der nächsten Messung eine verlässliche Aussage über die Veränderung des Blutzuckerspiegels des Patienten treffen zu können. In diesem Fall wird der nächste Messzeitpunkt $(n+1)''$ auf fünf Minuten hinter das Messausschlusszeitfenster EX verlegt und eine Warninformation (AL) an den Arzt abgegeben.

[0043] Für die Erläuterung eine weiteren implementierten Risikoabschätzung wird nun nochmals auf Fig. 4 Bezug genommen. Wie ersichtlich, würde der (lineare) Blutzucker-Verlauf $BG(DS)$ bei einer Verlegung des nächsten Messzeitpunkts nach hinten $(n+1)''$ zu einem Unterschreiten des Sollblutzuckerspiegels BGS um die Differenz D'' führen. Dies impliziert die Gefahr von Hypoglykämie des Patienten. Daher führt der Dosierungsvorschlagsalgorithmus, wenn er die drohende Unterschreitung des Sollblutzuckerspiegels BGS detektiert, eine nochmalige Berechnung einer adaptierten Empfehlung DS'' unter Zugrundelegung des verlängerten Zeitintervalls zwischen dem Messzeitpunkt n und dem nächsten Messzeitpunkt $(n+1)''$ durch. Die adaptierte Empfehlung DS'' der Insulinverabreichung kann durch lineare Interpolation berechnet werden, die den linearen Blutzucker-

spiegelverlauf $BG(DS'')$ zum Resultat hat.

Patentansprüche

5

1. Verfahren zur Durchführung einer Serie von Messungen zumindest eines physiologischen Parameters, insbesondere Blutwertes, wie z.B. Blutzucker, an einem Patienten zu diskreten Messzeitpunkten (n) entnommenen Proben (S) und zur Errechnung einer Empfehlung (DS) für eine Dosierung zumindest eines dem Patienten bis zum nächsten Messzeitpunkt zu verabreichenden Wirkstoffs anhand eines den zumindest einen gemessenen physiologischen Parameter einbeziehenden Dosierungsvorschlagsalgorithmus, wodurch zumindest ein physiologischer Parameter des Patienten auf einen Zielbereich eingestellt wird, **dadurch gekennzeichnet, dass** der nächste Messzeitpunkt $(n+1, (n+1)', (n+1)'')$ unter Berücksichtigung von Messausschlusszeitfenstern (EX) ermittelt wird.

10

15

20

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Dosierungsvorschlagsalgorithmus Patientendaten, wie Gewicht, Ernährungsge-
wohnheiten, etc. bei der Errechnung der Empfehlung (DS) einbezieht.

25

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der ermittelte nächste Messzeitpunkt $(n+1, (n+1)', (n+1)'')$ eine Variable des Dosierungsvorschlagsalgorithmus darstellt.

30

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der nächste Messzeitpunkt $(n+1)$ ermittelt wird, indem zum letzten Messzeitpunkt (n) ein Zeitintervall (TM) addiert und geprüft wird, ob der sich daraus ergebende vorläufige nächste Messzeitpunkt $(n+1)$ in einem Messausschlusszeitfenster (EX) liegt und falls zutreffend, der nächste Messzeitpunkt $((n+1)', (n+1)'')$ außerhalb des Messausschlusszeitfensters (EX) verlegt wird.

35

40

5. Verfahren nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Verlegung des nächsten Messzeitpunkts $((n+1)', (n+1)'')$ außerhalb des Messausschlusszeitfensters (EX) unter Vorausberechnung eines zu erwartenden Messwerts, insbesondere durch Interpolation, und einer Risikoabschätzung, ob der zu erwartende Messwert für den Zustand des Patienten akzeptabel ist, erfolgt.

45

50

6. Verfahren nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Verlegung des nächsten Messzeitpunkts $((n+1)', (n+1)'')$ außerhalb des Messausschlusszeitfensters (EX) unter Risikoabschätzung einer für den Zustand des Patienten maximal

55

- zulässigen Zeitspanne zwischen zwei Messzeitpunkten erfolgt.
7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** bei unvertretbar hohem Risiko eine Warninformation (AL) ausgegeben wird, wobei optional der Messzeitpunkt vor das Messausschlusszeitfenster verlegt wird. 5
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Messausschlusszeitfenster durch Aktionen (CL1) des Analysegeräts bedingt ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** der nächste Messzeitpunkt (n+1) ermittelt wird, indem zum letzten Messzeitpunkt (n) ein Zeitintervall (TM) addiert und geprüft wird, ob der sich daraus ergebende nächste Messzeitpunkt (n+1) in dem Messausschlusszeitfenster liegt und, falls zutreffend, das messgerätebedingte Messausschlusszeitfenster (EX) außerhalb des nächsten Messzeitpunkts (n+1) verlegt wird. 10 15 20
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Messausschlusszeitfenster durch Aktionen (US1) des Benutzers bedingt ist, **dadurch gekennzeichnet, dass** der nächste Messzeitpunkt (n+1) ermittelt wird, indem zum letzten Messzeitpunkt (n) ein Zeitintervall (TM) addiert und geprüft wird, ob der sich daraus ergebende nächste Messzeitpunkt (n+1) in dem Messausschlusszeitfenster liegt und, falls zutreffend, dem Benutzer eine Meldung (INF) übermittelt wird, in der er aufgefordert wird, den Zeitpunkt für seine Aktionen (US1) und damit das benutzerbedingte Messausschlusszeitfenster (EX) außerhalb des nächsten Messzeitpunkts (n+1) zu verlegen. 25 30 35
10. Verfahren nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Benutzer das benutzerbedingte Messausschlusszeitfenster (EX) außerhalb des nächsten Messzeitpunkts (n+1) verlegt, und gegebenenfalls auch nachfolgende benutzerbedingte Messausschlusszeitfenster verlegt. 40
11. Medizinisch-diagnostisches Analysegerät (1), wie beispielsweise ein Blutanalysegerät, zur Aufnahme von einem Patienten zu diskreten Messzeitpunkten entnommenen Proben (S), zumindest einem Messsensor (3) zur Messung zumindest eines physiologischen Parameter, insbesondere Blutwertes, wie z.B. Blutzucker, an den Proben, einer die Messsignale (MS) des zumindest einen Messsensors erhaltenden Recheneinheit (4) zur Aufbereitung von Messwerten des zumindest einen physiologischen Parameters aus den Messsignalen, zur Errechnung einer Empfehlung (DS) für eine Dosierung eines dem Patienten bis zum nächsten Messzeitpunkt zu verabreichenden Wirkstoffs anhand eines 45 50 55
- den zumindest einen gemessenen physiologischen Parameter einbeziehenden Dosierungsvorschlagalgorithmus, wobei die Recheneinheit (4) dazu ausgebildet ist, das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10 abzarbeiten.
12. Analysegerät nach Anspruch 11, **gekennzeichnet durch** ein Ausgabeinterface (5), über das die Recheneinheit (4) die Dosierungsempfehlung (DS), Warnungen (AL) und andere Meldungen (INF) an einen Benutzer ausgibt.
13. Analysegerät nach Anspruch 11 oder 12, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Recheneinheit dazu ausgebildet ist, das Verfahren parallel für eine Vielzahl von Patienten durchzuführen;

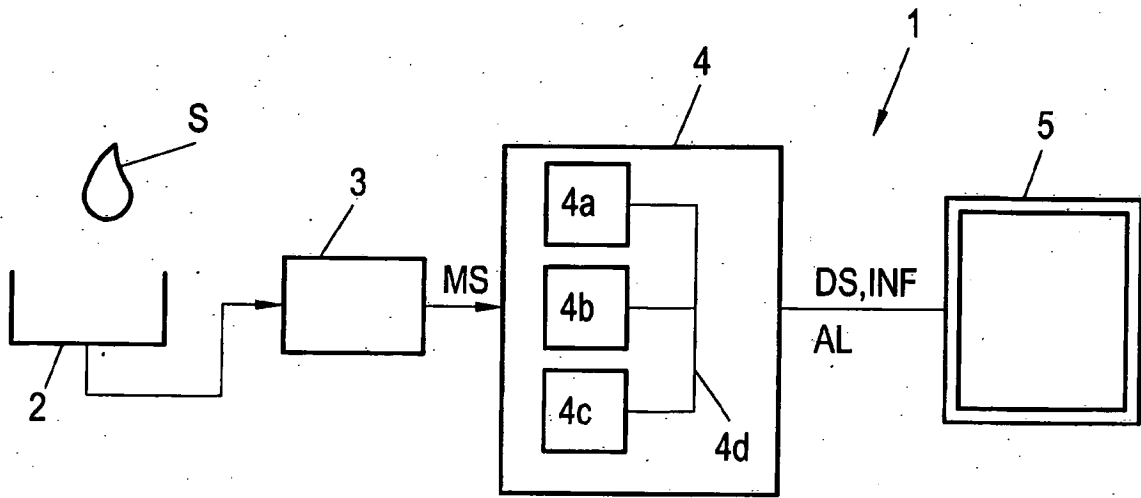


Fig. 1

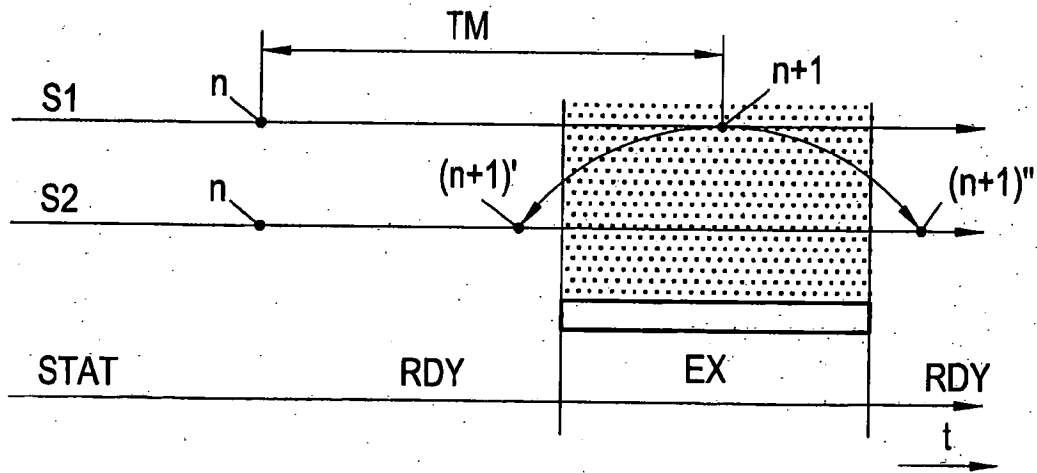


Fig. 2

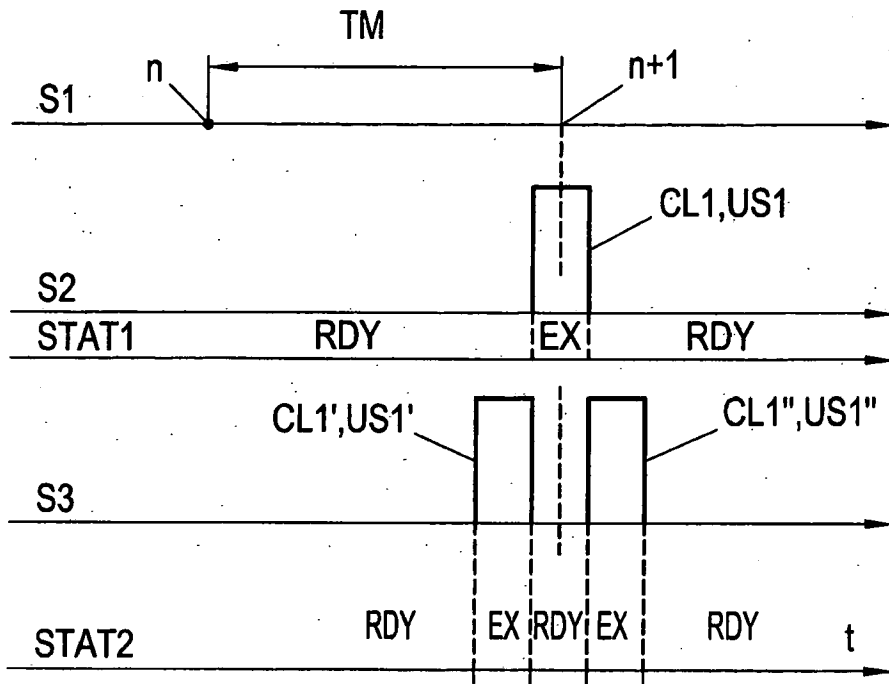


Fig. 3

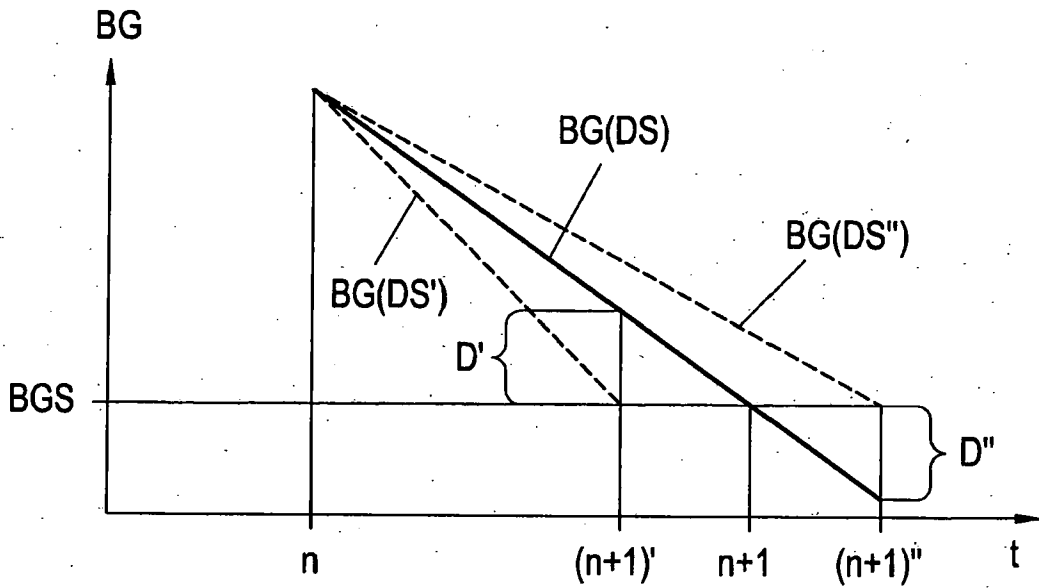


Fig. 4



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 09 45 0088

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	WO 2009/049245 A (OPTISCAN BIOMEDICAL CORP [US]; RULE PETER [US]; RIVAS GIL [US]) 16. April 2009 (2009-04-16) * Absatz [0223] - Absatz [0235] * * Absatz [0248] - Absatz [0251] * * Abbildungen 24-27 *	1-4,6, 11-13	INV. A61B5/00 A61M5/172
X	MATHIJS VOGELZANG ET AL: "Computer-assisted glucose control in critically ill patients" INTENSIVE CARE MEDICINE, SPRINGER, BERLIN, DE, Bd. 34, Nr. 8, 4. April 2008 (2008-04-04), Seiten 1421-1427, XP019619075 ISSN: 1432-1238 * Zusammenfassung * * Seite 1422 - Seite 1423 * * Seite 1425 * * Abbildung 2 *	1-3, 11-13	
A	US 2009/054753 A1 (ROBINSON MARK RIES [US] ET AL) 26. Februar 2009 (2009-02-26) * Absatz [0035] * * Absatz [0058] *	1-13	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) A61B A61M
A	US 5 697 899 A (HILLMAN ROBERT S [US] ET AL) 16. Dezember 1997 (1997-12-16) * Spalte 8, Zeile 65 - Spalte 9, Zeile 19 *	1,11-13	
----- -/--			
3 Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 3. August 2009	Prüfer Gärtner, Andreas
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03-82 (P04C03)



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 09 45 0088

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
D,A	PAUL C DAVIDSON ET AL: "A computer-directed intravenous insulin system shown to be safe, simple, and effective in 120,618 h of operation" DIABETES CARE, AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, ALEXANDRIA, VA, US, Bd. 20, Nr. 10, 1. Januar 2005 (2005-01-01), Seiten 2418-2423, XP009120784 ISSN: 0149-5992 * das ganze Dokument * -----	1,11-13	
D,A	WO 2008/057213 A (TUAKI MEDICAL INC [US]; INTERSECTION LIFESCIENCES LTD [NZ]; DOUGLAS JO) 15. Mai 2008 (2008-05-15) * das ganze Dokument * -----	1,11-13	
A	GB 2 436 873 A (UNIV CAMBRIDGE TECH [GB]; CAMBRIDGE ENTPR LTD [GB]) 10. Oktober 2007 (2007-10-10) * Seite 8, Absatz 3 * * Seite 17, letzter Absatz * -----	1,11-13	
D,A	BODE ET AL: "Intravenous Insulin Infusion Therapy: Indications, Methods, and Transition to Subcutaneous Insulin Therapy" ENDOCRINE PRACTICE, AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY, US, Bd. 10, Nr. Suppl.2, 1. Januar 2004 (2004-01-01), Seiten 71-80, XP009120785 ISSN: 1530-891X * das ganze Dokument * -----	1,11-13	
D,A	US 2007/168136 A1 (BOOTH ROBERT C [US] ET AL) 19. Juli 2007 (2007-07-19) * das ganze Dokument * -----	1,11-13	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 3. August 2009	
		Prüfer Gärtner, Andreas	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet		E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder	
Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie		nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	
A : technologischer Hintergrund		D : in der Anmeldung angeführtes Dokument	
O : nichtschriftliche Offenbarung		L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument	
P : Zwischenliteratur		
		& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

3
EPO FORM 1503 03-82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 09 45 0088

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

03-08-2009

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 2009049245 A	16-04-2009	US 2009157430 A1	18-06-2009
US 2009054753 A1	26-02-2009	KEINE	
US 5697899 A	16-12-1997	KEINE	
WO 2008057213 A	15-05-2008	US 2008306353 A1	11-12-2008
GB 2436873 A	10-10-2007	WO 2007116226 A2	18-10-2007
US 2007168136 A1	19-07-2007	KEINE	

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- US 20070168136 A [0009]
- WO 2008057213 A [0010]

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

- **Bode et al.** Intravenous Insulin Infusion Therapy: Indications, Methods, and Transition to Subcutaneous Insulin Therapy. *ENDOCRINE PRACTICE*, Marz 2004, vol. 10 (2 [0003] [0037]
- **Davidson et al.** *Diabetes Care*, 2005, vol. 20 (10), 2418-2423 [0003]

专利名称(译)	用于基于患者的至少一个生理参数的测量序列确定给药剂的推荐的方法和装置		
公开(公告)号	EP2243423A1	公开(公告)日	2010-10-27
申请号	EP2009450088	申请日	2009-04-23
[标]申请(专利权)人(译)	罗氏诊断公司		
申请(专利权)人(译)	罗氏诊断有限公司 F.霍夫曼罗氏公司		
当前申请(专利权)人(译)	罗氏诊断有限公司 F.霍夫曼罗氏公司		
[标]发明人	KRAINZ MICHAEL LEINER MARCO JEAN PIERRE		
发明人	KRAINZ, MICHAEL LEINER, MARCO JEAN-PIERRE		
IPC分类号	A61B5/00 A61M5/172		
CPC分类号	A61B5/14532 A61B5/4839 A61M5/1723 A61M2205/18 G06F19/3456 G16H20/10		
其他公开文献	EP2243423B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

该方法涉及将患者的生理参数调整到目标范围。将时间间隔 (TM) 添加到最后的测量时间，并且检查初步的下一个测量时间是否位于排除时间窗口中。通过考虑测量排除时间窗口 (EX) 来确定下一个测量时间。基于包括患者数据的剂量提议算法计算对待施用于患者的活性成分的剂量的推荐，直到下一个测量时间为止。病人体重。还包括用于诊断血液分析仪的独立权利要求，用于接收在离散测量时间从患者采集的样本。

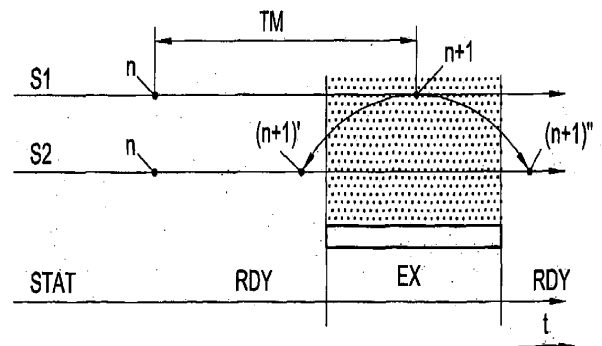


Fig. 2