



(11) **EP 3 477 278 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
**01.05.2019 Patentblatt 2019/18**

(51) Int Cl.:  
**G01N 21/17 (2006.01) A61B 5/145 (2006.01)**  
**A61B 5/00 (2006.01)**

(21) Anmeldenummer: **17198860.3**

(22) Anmeldetag: **27.10.2017**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**BA ME**  
Benannte Validierungsstaaten:  
**MA MD**

(72) Erfinder:  
• **Schlesinger, Raphael**  
**12165 Berlin (DE)**  
• **Kischkat, Jan-Ferenc**  
**10829 Berlin (DE)**  
• **von Lilienfeld-Toal, Hermann**  
**63571 Gelnhausen (DE)**

(71) Anmelder: **Humboldt-Universität zu Berlin**  
**10099 Berlin (DE)**

(74) Vertreter: **RCD Patent**  
**Giesen, Schmelcher & Griebel**  
**Patentanwälte PartG mbB**  
**Kaiserstraße 100**  
**52134 Herzogenrath (DE)**

(54) **PHOTOAKUSTIK-VERFAHREN MIT EINEM MESSLICHT AUFWEISEND EINEN VORBESTIMMTEN WELLENLÄNGENBEREICH ZUR BESTIMMUNG VON EIGENSCHAFTEN EINER INHOMOGENEN PROBE**

(57) Die Erfindung betrifft ein Photoakustik-Verfahren mit einem Messlicht aufweisend einen vorbestimmten Wellenlängenbereich zur Bestimmung von Eigenschaften einer inhomogenen Probe, wobei die Probe für den vorbestimmten Wellenlängenbereich eine mittlere Absorptionslänge  $\mu$  aus dem Intervall 1 - 100 Mikrometer aufweist, umfassend die Schritte:

a) Einstrahlen von wenigstens einem Messlichtpuls mit vorbestimmter Pulsdauer und vorbestimmter Intensität

auf eine Messfläche der Fläche  $F$  mit  $\sqrt{F} \gg \mu$  der

Oberfläche der inhomogenen Probe;

b) Detektieren von wenigstens einer Drucktransienten an der Messfläche, wobei die Drucktransiente durch Absorption des wenigstens einen Messlichtpulses in der inhomogenen Probe unter Erzeugen von einer zur Messfläche propagierenden Druckwelle entsteht;

c) Berechnen eines Wertes für die während der Pulsdauer von der Probe absorbierte Energiedichte aus dem Verlauf der wenigstens einen Drucktransienten am Anfang und am Ende des wenigstens einen Messlichtpulses; gekennzeichnet durch

d) Wiederholen der Schritte a) bis c) für voneinander verschiedene Einfallswinkel des Messlichts gegenüber der Normalen der Messfläche, wobei die in c) bestimmten Energiedichtewerte jeweils mit dem Einfallswinkel indiziert werden;

e) Modellieren der inhomogenen Probe als Schichtenstapel, wobei jeder Schicht wenigstens eine Schichtdicke

und ein Absorptionskoeffizient zugeordnet werden, wobei wenigstens ein Absorptionskoeffizient einer Schicht ein Fitparameter ist;

f) Ausführen einer Fitprozedur für die Fitparameter des Schichtenstapels, wobei durch Variation der Fitparameter die Aufteilung der mit dem Einfallswinkel indizierten Energiedichtewerte auf Beiträge der einzelnen Schichten variiert wird, bis ein vorbestimmtes Konsistenzkriterium erfüllt ist;

g) Auslesen der gefitteten Fitparameter als Werte wenigstens für den tiefenaufgelösten Absorptionskoeffizienten der inhomogenen Probe.

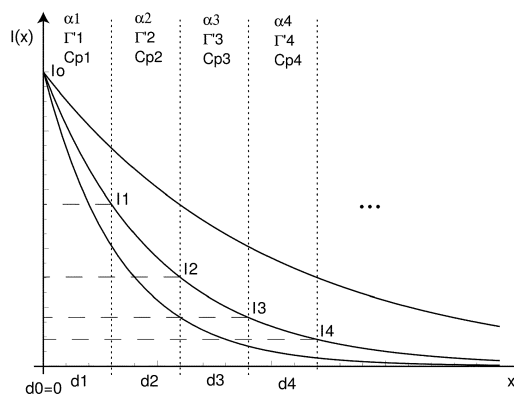


Fig. 2

**EP 3 477 278 A1**

**Beschreibung**

**[0001]** Die Erfindung betrifft ein Photoakustik-Verfahren zur Bestimmung von Eigenschaften einer inhomogenen Probe mit Mikrometer-Tiefenauflösung. Insbesondere betrifft die Erfindung ein Photoakustik-Verfahren, bei dem elektromagnetische Strahlung auf eine Oberfläche einer Probe eingestrahlt und von der Probe unter Erzeugen einer Druckwelle absorbiert wird, wobei die Druckwelle zur Messfläche propagiert und als eine Drucktransiente detektiert wird.

**[0002]** Die Erfindung betrifft auch ein Photoakustik-Verfahren zur nichtinvasiven Bestimmung von Eigenschaften lebenden Gewebes, z.B. lebender Haut.

**[0003]** Photoakustik-Messapparate und -Sensoren sind bekannte Mittel zur Detektion und Quantifizierung von Substanzen durch deren charakteristische Lichtabsorption. Zur Untersuchung einer Probe auf eine gesuchte Substanz erfolgt die Beleuchtung der Probe mit einem Messlicht, das eine oder mehrere Lichtwellenlängen aufweist, die als charakteristische Absorptionswellenlängen der Substanz vorbekannt sind. Das Messlicht wird gepulst in die Probe eingestrahlt und dort in Abhängigkeit von der Verteilung der Substanz lokal unterschiedlich stark absorbiert. Die mit der Lichtabsorption eingetragene Energie bewirkt eine Erwärmung und eine thermomechanische Expansion der Probe. Beides löst Relaxationsprozesse aus, die die inhomogen eingetragene Energie über die Probe verteilen, um das Equilibrium wieder herzustellen. Dies geschieht über Wärmediffusion und die Propagation von Druckwellen - Schallwellen - durch die Probe, u.a. hin zur Probenoberfläche.

**[0004]** Bei gängigen Photoakustik-Verfahren werden die Druckwellen als Drucktransienten an der Probenoberfläche von piezoelektrischen Schallwandlern detektiert. Solche Schallwandler, i. F. auch Detektoren, können mit einer entsprechenden Messelektronik hohe Zeitaufösungen von üblich einigen zehn Nanosekunden erreichen und eignen sich daher zur Unterscheidung von Druckwellenlaufzeiten aus verschiedene Tiefen der Probe. Wählt man die Wellenlänge des Messlichts so aus, dass es vorwiegend von lokalisierten Substanzen oder Strukturen (z.B. Hämoglobin in Blutgefäßen) absorbiert wird und detektiert man die Drucktransienten an einer Mehrzahl von Orten auf der Proben simultan, dann kann man die Orte der Absorption ermitteln und als 3D-Bild darstellen. So lassen sich beispielweise Darstellungen von Blutgefäßnetzen in vivo erzeugen. Aufgrund der großen Schallgeschwindigkeit in festen oder flüssigen Proben, z.B. 1,5  $\mu\text{m}/\text{ns}$  in Wasser, ist herkömmliche Photoakustik aber nur begrenzt zur Untersuchung einer Probe geeignet, wenn diese mit einem Messlicht bestrahlt wird, das die Probe bereits in einer Tiefe von einigen zehn Mikrometern unter der Probenoberfläche vollständig absorbiert hat. Unter diesen Bedingungen sollte das Drucksignal auf derselben Messfläche in der Oberfläche detektiert werden, in die das Messlicht zuvor eingestrahlt worden ist, da praktisch nur direkt unter der Messfläche Absorption stattfinden kann. Entsprechend kurz sind alle Laufzeiten der annähernd gleichzeitig am Detektor eintreffenden Drucksignale. Die begrenzte Zeitauflösung des Detektors erlaubt in der Regel keine Mikrometer-Auflösung für die Probentiefen, aus denen die Drucksignale stammen.

**[0005]** In der Veröffentlichung von Fei Gao et al., "Single laser pulse generated dual photoacoustic signals for differential contrast photoacoustic imaging", Scientific Reports | 7: 626 | DOI:10.1038/s41598-017-00725-4 1, (2017) wird die Verwendung langer Messlichtpulse vorgeschlagen, um mit jedem Puls zwei zeitlich separierte Drucksignale auszulösen, nämlich je eines am Anfang und am Ende eines Messlichtpulses. Die beiden zu einem Messlichtpuls gehörenden Drucksignale sind dabei nicht-linear korreliert. Sie weisen einen festen Zeitabstand und entgegengesetzte Polarität auf, können aber unterschiedliche Amplituden besitzen in Abhängigkeit von der Messlichtpulsdauer und von der Erwärmung der Probe während der langen Pulsdauer. Aus der Differenz der korrelierten Drucksignale lassen sich insofern Erkenntnisse über die in der Probe deponierte Energiedichte gewinnen. Das Verfahren von Fei Gao et al. soll im Folgenden als Differentielle Photoakustik (DPA) bezeichnet werden.

**[0006]** Beispielsweise aus dem Paper von Kottmann et al., "Glucose sensing in human epidermis using midinfrared photoacoustic detection", Vol. 3, No. 4 / BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS, S. 667 ff., geht die folgende Messaufgabe hervor: das Bestimmen des Blutzuckergehalts in vivo durch Messen der Absorption von MIR-Messlicht mit einer Wellenlänge um 10  $\mu\text{m}$  im "interstitial fluid" (ISF) unterhalb der etwa 20  $\mu\text{m}$  dicken Stratum Corneum (SC) der lebenden Haut. Das Messlicht wird dabei laut Quelle innerhalb eines Tiefenbereichs von bis zu 100  $\mu\text{m}$  unter der Hautoberfläche absorbiert, und die Absorption generiert ein Drucksignal. Das SC selbst liefert aber keine aussagekräftige Information über die Blutzuckerkonzentration. Erst die Absorption in tiefer gelegenen Schichten, insbesondere im Stratum Spinosum, ist dazu geeignet, den Glukoselevel abzuleiten. Solche variierenden Eigenschaften einer inhomogenen Probe zu ermitteln, setzt das Erreichen einer Mikrometer-Tiefenauflösung auf lediglich wenigen zehn Mikrometern Messtiefe direkt unter der Oberfläche voraus.

**[0007]** Vor diesem Hintergrund besteht ein Interesse an einem neuen photoakustischen Messverfahren, das inhomogene Proben mit Mikrometer-Tiefenauflösung untersuchen kann, gerade dann, wenn das Messlicht aus einem Spektralbereich stammt, der von der inhomogenen Probe stark absorbiert wird. Nach Kenntnis der Erfinder wurde die Differentielle Photoakustik für diese Fragestellung noch nicht als eine Lösungsmöglichkeit in Betracht gezogen.

**[0008]** Die Erfindung stellt sich die Aufgabe, ein Photoakustik-Verfahren mit einem Messlicht aufweisend einen vorbestimmten Wellenlängenbereich zur Bestimmung von Eigenschaften einer inhomogenen Probe vorzuschlagen, wobei die Probe für den vorbestimmten Wellenlängenbereich eine mittlere Absorptionslänge aus dem Intervall 1- 100 Mikro-

meter aufweist.

**[0009]** Die Aufgabe wird gelöst durch ein Photoakustik-Verfahren mit einem Messlicht aufweisend einen vorbestimmten Wellenlängenbereich zur Bestimmung von Eigenschaften einer inhomogenen Probe, wobei die Probe für den vorbestimmten Wellenlängenbereich eine mittlere Absorptionslänge  $\mu$  aus dem Intervall 1-100 Mikrometer aufweist, umfassend die Schritte:

a) Einstrahlen von wenigstens einem Messlichtpuls mit vorbestimmter Pulsdauer und vorbestimmter Intensität auf eine Messfläche der Fläche  $F$  mit  $\sqrt{F} \gg \mu$  in der Oberfläche der inhomogenen Probe;

b) Detektieren von wenigstens einer Drucktransienten an der Messfläche, wobei die Drucktransiente durch Absorption des wenigstens einen Messlichtpulses in der inhomogenen Probe unter Erzeugen von einer zur Messfläche propagierenden Druckwelle entsteht;

c) Berechnen eines Wertes für die während der Pulsdauer von der Probe absorbierte Energiedichte aus dem Verlauf der wenigstens einen Drucktransienten am Anfang und am Ende des wenigstens einen Messlichtpulses; gekennzeichnet durch

d) Wiederholen der Schritte a) bis c) für voneinander verschiedene Einfallswinkel des Messlichts gegenüber der Normalen der Messfläche, wobei die in c) bestimmten Energiedichtewerte jeweils mit dem Einfallswinkel indiziert werden;

e) Modellieren der inhomogenen Probe als Schichtenstapel, wobei jeder Schicht wenigstens eine Schichtdicke und ein Absorptionskoeffizient zugeordnet werden, wobei wenigstens ein Absorptionskoeffizient einer Schicht ein Fitparameter ist;

f) Ausführen einer Fitprozedur für die Fitparameter des Schichtenstapels, wobei durch Variation der Fitparameter die Aufteilung der mit dem Einfallswinkel indizierten Energiedichtewerte auf Beiträge der einzelnen Schichten variiert wird, bis ein vorbestimmtes Konsistenzkriterium erfüllt ist;

g) Auslesen der gefitteten Fitparameter als Werte wenigstens für den tiefenaufgelösten Absorptionskoeffizienten der inhomogenen Probe.

**[0010]** Die Unteransprüche geben vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens an.

**[0011]** Das erfindungsgemäße Photoakustik-Verfahren analysiert den zeitlichen Verlauf von detektierten Drucktransienten, verzichtet dabei aber auf jegliche Zuordnung von Schalllaufzeiten auf Probentiefen. Vielmehr werden prominente Strukturen der Drucktransienten, die sich am Anfang und am Ende eines Messlichtpulses zeigen und hier als Druckpulse bezeichnet werden, zeitlich voneinander separiert erfasst und beispielsweise und bevorzugt zeitlich integriert. Die Differenz der Druckpulsintegrale,  $\Delta p$ , einer einzelnen Drucktransiente ist das Resultat einer unterschiedlichen Expansionsantwort auf das Messlicht am Anfang und am Ende des langen Messlichtpulses. Beispielsweise erfolgt in der Regel eine Expansion der Probe, wenn der Messlichtpuls in der Probe eintrifft, und es erfolgt eine Kontraktion, sobald der Messlichtpuls endet, d.h. die Beleuchtung abgeschaltet wird. Während der Dauer des Messlichtpulses wird elektromagnetische Energie in der Probe deponiert, was zur lokalen Erwärmung führt. Der temperaturabhängige Grüneisen-Koeffizient,  $\Gamma(T)$ , des beleuchteten Volumens der Probe ist ein bestimmender Parameter für die photoakustische Antwort und in erster Näherung linear von der Temperaturänderung abhängig:

$$\Gamma(T) = \Gamma_0 + \Gamma' \Delta T \tag{1}$$

**[0012]** Zugleich wird die Temperaturerhöhung im beleuchteten Volumen infolge der absorbierten Strahlung durch die Wärmekapazität  $C_p$  der Probe bestimmt. Sind diese Materialkoeffizienten für die untersuchte Probe bekannt oder kann man darüber aus der Kenntnis der Probe heraus vernünftige Annahmen machen, dann lässt sich die unmittelbare Messgröße  $\Delta p$  in die deponierte Energie,  $\Delta E$ , bezogen auf das beleuchtete Volumen,  $V$ , d.h. in die absorbierte Energiedichte, umrechnen:

$$\Delta p = \eta I_0 \delta t \times \frac{\Gamma'}{C_p} \times \frac{\Delta E}{V} \tag{2}$$

**[0013]** In Gleichung (2) bezeichnet  $I_0$  die auf die Probe eingestrahlte Messlichtintensität (in Einheiten Leistung/Fläche),  $\delta t$  die Anstiegs- oder Abklingdauer des Messlichtpulses (vgl. auch Fig. 1) und  $\eta$  die Umwandlungseffizienz von Wärme in Druck in Analogie zu Fei Gao et al. (2017), geteilt durch die Schallgeschwindigkeit und die detektorabhängige Integrationszeit des Drucktransienten.

**[0014]** Die Grundidee der Erfindung basiert nun auf der Erkenntnis, dass  $\Delta p$  eine deutliche Abhängigkeit vom Einfallswinkel,  $\theta$ , des Messlichts gegen die Normale der Messfläche zeigt, gerade weil das Messlicht gemäß Voraussetzung schon auf kurzen Strecken in der Probe stark absorbiert wird. Es erreicht bei großen Winkeln tiefer liegende Schichten der Probe nicht mehr, die es bei senkrechtem Einfall ( $\theta = 0^\circ$ ) noch erreichen kann. Somit repräsentiert eine Sequenz von Messungen von  $\Delta p(\theta)$  zu voneinander verschiedenen - gleichbedeutend: jeweils paarweise verschiedenen - Winkeln  $\theta$  einen Satz linear unabhängiger Messungen der Probe, aus dem sich auch eine Information über die Tiefenauflösung der Probe extrahieren lässt - und zwar ganz zwangsläufig dann auf der Mikrometerskala.

**[0015]** Das erfindungsgemäße Verfahren ähnelt etwas einer Tomographie, etwa der Röntgen-CT, bei der ein Objekt unter verschiedenen Winkeln durchstrahlt und abgebildet wird, und aus der Zusammenschau der gewonnenen Bilder hiernach ein Computer-Modell rekonstruiert wird.

**[0016]** Die Erfindung muss ebenfalls eine Rekonstruktion der inhomogenen Probe vornehmen, wobei diese Rekonstruktion die deutlich vereinfachende Annahme machen kann, dass Strukturänderungen nur entlang der Tiefenachse auftreten. Die inhomogene Probe kann dann als ein eindimensionaler Schichtenstapel umfassend eine Anzahl  $M$  Schichten modelliert werden, wobei  $M$  eine natürliche Zahl ist. Erfindungsgemäß werden jeder Schicht (mit Index  $i = 1, \dots, M$ ) des Modells wenigstens eine Schichtdicke,  $d_i$ , und ein Absorptionskoeffizient,  $\alpha_i$ , als Eigenschaft zugewiesen, wobei wenigstens ein Absorptionskoeffizient einer Schicht als Fitparameter vorgesehen ist.

**[0017]** Die einzigen unmittelbar winkelabhängigen Größen auf der rechten Seite von Gleichung (2) sind die deponierte Energie  $\Delta E(\theta)$  und das beleuchtete Volumen  $V(\theta) = F \times \mu(\theta)$ , wobei mit  $F$  die Fläche der vorbestimmten Messfläche bezeichnet ist, auf die das Messlicht eingestrahlt wird, und mit  $\mu(\theta)$  die über die Probe gemittelte Eindringtiefe der Strahlung. Tatsächlich erfolgt senkrecht zur Tiefenachse, also parallel zur Probenoberfläche, bereits eine implizite Mittelung der photoakustischen Antwort der Probe, weil die Abmessungen der Messfläche, z.B. Kantenlängen oder Durchmesser jeweils proportional zu  $\sqrt{F}$ , sehr groß gegenüber  $\mu$  eingerichtet sind.

**[0018]** Dass der in Wahrheit beleuchtete Probenbereich aufgrund von Brechung des Messlichts bei schrägem Einfall auch noch einen Randbereich aufweisen kann, der nicht unter der Messfläche liegt, wird hier zur Vereinfachung vernachlässigt.

**[0019]** Die Verteilung der in der Probe deponierten Energiedichte hängt wesentlich davon ab, welche Weglängen das Messlicht in welchen Schichten - unter der Wirkung des jeweiligen Absorptionskoeffizienten - zurücklegt. Beispielsweise bei einem Einfallswinkel nahe  $90^\circ$  - streifender Einfall - ist es möglich, dass das Messlicht vollständig in der obersten Schicht der Probe propagiert und absorbiert wird. Wird der Winkel verringert, dann ändert sich die Eindringtiefe und das Messlicht kann auch in einer zweiten oder auch noch in einer dritten Schicht usw. absorbiert werden.

**[0020]** Die Veränderung des Einfallswinkels kommt effektiv der simultanen Streckung aller Schichtdicken des Modells der Probe gleich. Anders gesagt reicht es aus, für das Schichtmodell die Lichtintensität  $I(x)$  mit  $x$  als Tiefenachse aus den Modellparametern zu berechnen und für die verschiedenen Winkel  $\theta$  dabei einfach alle  $d_i$  durch  $d_i \cos(\theta)$  zu ersetzen. Zur Verdeutlichung: Es ist für jede Variation der Schichtdicken  $d_i$  oder des Winkels  $\theta$  eine Neuberechnung der Intensität  $I(x)$  erforderlich, da sich die Intensität - und damit zugleich die messbare Druckantwort - auch bei einer reinen Variation des Einfallswinkels verändert.

**[0021]** Mit Hilfe der modellierten Lichtintensitäten kann man erfindungsgemäß die absorbierte Energiedichte auf die einzelnen Schichten des Schichtenstapels aufteilen, anders gesagt, die Beiträge der einzelnen Schichten zur gemessenen Energiedichte ermitteln. Dazu dient die folgende Überlegung:

Die Zunahme der deponierten Energie über ein Tiefenintervall,  $\Delta x$ , entspricht der Abnahme der eingestrahlten Leistung über dasselbe Intervall multipliziert mit der Dauer des Messlichtpulses,  $\Delta t$  (vgl. Fig. 1). Die Messlichtintensität  $I(x)$  ist die tiefenabhängige Leistungsflächendichte, und es gilt näherungsweise

$$\frac{\Delta E(x)}{\Delta x} \cong -F \times \Delta t \times \frac{dI(x)}{dx} \quad (3)$$

wobei auf der rechten Seite zur Vereinfachung vom Differenzenquotienten zum Differentialquotienten übergegangen wurde. Die über die gesamte Eindringtiefe  $\mu$  gemittelte absorbierte Energie erhält man durch eine gewichtete Integration

$$\frac{\Delta E}{\mu} = \int_0^{\mu} \frac{\Delta E(x)}{\Delta x} \times \rho(x) dx \tag{4}$$

5 mit Gewichten

$$\rho(x) = \frac{I(x)}{\int_0^{\infty} I(x') dx'} \tag{5}$$

10 **[0022]** Die Gewichtsfunktion aus (5) ist fast null für  $x > \mu$ , also kann die obere Integrationsgrenze in (4) näherungsweise auf  $\infty$  gesetzt werden. Setzt man (3) und (5) in (4) ein und dividiert man durch die Fläche  $F$ , ergibt sich

$$15 \frac{\Delta E}{V} = \frac{-\Delta t}{\int_0^{\infty} I(x') dx'} \times \int_0^{\infty} \frac{dI(x)}{dx} \times I(x) dx \tag{6}$$

$$20 \frac{\Delta E}{V} = \frac{\Delta t}{\int_0^{\infty} I(x') dx'} \times \sum_{i=1}^M \int_{d_{i-1}}^{d_i} \alpha_i \times I^2(x) dx \tag{7}$$

**[0023]** Beim Übergang von (6) zu (7) wird die Probe als Schichtenstapel mit  $M$  Schichten der Schichtdicken  $d_i$ ,  $i = 1, \dots, M$  mit der Festlegung  $d_0 = 0$  sowie den Absorptionskoeffizienten  $\alpha_i$ ,  $i = 1, \dots, M$  eingeführt. In den einzelnen Schichten  
 25 folgt die Intensität dem bekannten Exponentialverlauf, und es gilt jeweils  $\frac{dI(x)}{dx} = -\alpha_i \times I(x)$ .

**[0024]** Die Abhängigkeit vom Einfallswinkel  $\theta$  wird in den bisherigen Gleichungen unterdrückt. Nimmt man diese nun explizit hinzu, erhält man als Ergebnis:

$$30 \frac{\Delta E(\theta)}{F\mu(\theta)} = \frac{\Delta t}{\int_0^{\infty} I(\theta, x') dx'} \times \sum_{i=1}^M \int_{d_{i-1}/\cos\theta}^{d_i/\cos\theta} \alpha_i \times I^2(\theta, x) dx \tag{8}$$

**[0025]** Gleichung (8) ist ein Bestimmungsgleichungssystem für Parameter, die den Verlauf der Intensität  $I(x)$  im Schichtenstapel festlegen, wenn zusätzlich  $I_0$  vorkannt ist. Die linke Seite von (8) repräsentiert gemessene Werte aus den Drucktransienten ausgewertet nach Gleichung (2). Es können Messwerte für eine grundsätzlich beliebige Anzahl  $N$  von Einfallswinkeln  $\theta$  verwendet werden, um das Gleichungssystem (8) mit linear unabhängigen Gleichungen aufzufüllen.

**[0026]** Es liegt vordergründig beim Anwender der Erfindung, wie er das Modell der inhomogenen Probe gestalten möchte und welche Parameter er als a priori unbekannte Fitparameter auswählt. Beispielsweise könnten die Schichtdicken einer biologischen Probe vorab mit einer Optischen Kohärenztomographie gemessen worden sein. Dann wären die  $d_i$ ,  $i = 1, \dots, M$  bekannt und keine Fitparameter mehr. Man kann im Regelfall davon ausgehen, dass jede Schicht des Schichtenstapels wenigstens einen unbekanntes Fitparameter zugewiesen bekommt. Erfindungsgemäß wird wenigstens einer Schicht ein Absorptionskoeffizient als Fitparameter zugeschrieben.

**[0027]** Vorzugsweise sollte die Anzahl  $N$  der in Gleichung (8) in Betracht gezogenen Einfallswinkel ungefähr der Anzahl der unbekanntes Fitparameter in Gleichung (8) entsprechen, die unabhängig voneinander variiert werden können. Erfindungsgemäß sollen wenigstens zwei voneinander verschiedene Einfallswinkel verwendet werden.

**[0028]** Es ist im Übrigen auch von der Erfindung umfasst, die beim Aufstellen von Gleichung (2) getroffene Annahme über den Quotienten  $\frac{\Gamma'}{C_p}$  zu überprüfen und ggf. noch zu verbessern. Tatsächlich ist die gemessene Druckantwort des Schichtenstapels die Summe der Druckantworten,  $\Delta p_i$ , der Einzelschichten, und jeder Schicht kann ein eigener Quotient  $\frac{\Gamma'_i}{C_p}$  zugeordnet werden, der dem  $\Delta p_i$  proportional ist. Dies gestattet das Aufsetzen einer Selbstkonsistenzschleife, beispielsweise wie folgt:

- 55
- a) Messe  $N$  Druckantworten für  $N$  Einfallswinkel
  - b) Berechne  $N$  Werte für absorbierte Energiedichten nach Gleichung (2)

c) Setze berechnete Energiedichten in Gleichung (8) ein und löse das Gleichungssystem (i.d.R. numerisch) für ein Modell mit  $M$  Schichten

d) Weise den  $M$  Schichten Quotienten  $\frac{\Gamma'_i}{C_p^i}$  zu und berechne neuen mittleren Wert  $\frac{\Gamma'}{C_p}$

e) Wiederhole Schritte b) bis d), bis sich die Parameter des Modells nicht mehr ändern

**[0029]** Üblicherweise bricht man Selbstkonsistenzschleifen ab, wenn die Änderungen der Parameter zwischen zwei aufeinanderfolgenden Durchläufen unter vorbestimmte Grenzen fallen. Grundsätzlich muss es immer dem Nutzer des Verfahrens vorbehalten bleiben, ein Konsistenzkriterium konkret zu formulieren, da nur er die genaue Natur der Probe und seine Genauigkeitsanforderungen an die zu ermittelnden Parameter kennt.

**[0030]** Zur weiteren Verdeutlichung und zur Erläuterung von Ausgestaltungen dienen die folgenden Figuren. Dabei zeigt:

Fig. 1 einen Plot des typischen Zeitverlaufs eines Messlichtpulses;

Fig. 2 eine Skizze eines Schichtmodells der Probe mit den Parametern, die den einzelnen Schichten zugeordnet werden, und drei Intensitätsverläufen für unterschiedliche Einfallswinkel;

**[0031]** In Fig. 1 ist der Zeitverlauf eines Messlichtpulses exemplarisch dargestellt. Die Intensität steigt während einer kurzen Zeitspanne  $\delta t$  von 0 auf ihren Maximalwert  $I_0$  an, bleibt dort für eine Zeitspanne  $\Delta t \gg \delta t$ , und fällt hiernach während  $\delta t$  wieder auf 0 zurück. Druckpulse durch Expansion und Kontraktion der Probe werden jeweils während der Anstiegs- oder Abklingdauer der Messlichtpulse ausgelöst und erzeugen während der Zeitintervalle der Länge  $\delta t$  die Ausschläge in den messbaren Drucktransienten. Während der Pulsdauer  $\Delta t$  findet die Energiedeposition und Erwärmung der Probe statt. In dieser Phase zeigen die Drucktransienten keine nennenswerte Struktur. Vorzugsweise beträgt die Pulsdauer zwischen 100 und 1000 Nanosekunden, besonders bevorzugt zwischen 200 und 600 Nanosekunden. Dadurch ist sichergestellt, dass der Zeitabstand der beiden Druckpulse so groß ist, dass der erste bereits erfasst worden sein kann - auf jeden Fall den Erwärmungsbereich der Probe längst verlassen hat - bevor der zweite ausgelöst wird. Zugleich ist die Pulsdauer noch zu klein, um zwischen den Auslösezeitpunkten der Druckpulse einen signifikanten Abtransport der deponierten Energie durch Wärmediffusion zu gestatten.

**[0032]** Das Messlicht wird auf eine Messfläche in der Oberfläche der Probe eingestrahlt. Die genaue Definition der Messfläche hinsichtlich Position, Form und Flächeninhalt obliegt dem Nutzer. Aufgrund der vorausgesetzten geringen Eindringtiefe des Messlichts in der Probe ist mit der stärksten Druckantwort auf die photoakustische Anregung direkt an der Messfläche zu rechnen.

**[0033]** Beispielsweise und bevorzugt kann die Einstrahlung des Messlichts durch ein Kontaktprisma erfolgen, das für das Messlicht transparent ist. Das Kontaktprisma weist eine Probenkontaktfläche auf, auf die das Messlicht gerichtet ist, und die sich in mechanischem Kontakt mit der Probe befindet. Druckpulse, die durch das in die Probe eindringende Messlicht erzeugt werden, propagieren bis zur Probenkontaktfläche und können dort abgegriffen werden, beispielsweise durch einen Schallwandler (Piezotransducer), der auf einer der Probenkontaktfläche gegenüberliegenden Detektionsfläche des Kontaktprismas angeordnet ist. Die Druckpulse müssen dafür eine zusätzliche Wegstrecke im Innern des Kontaktprismas durchlaufen und treffen zeitverzögert ein, was aber für die Auswertung nach dem erfindungsgemäßen Verfahren unbedeutend ist. Der Zweck des Zusatzweges besteht allein darin, den Einfall des Messlichts auf die Probe nicht durch den Schallwandler zu behindern. Insofern wird auch die Messung mittels eines Kontaktprismas als Erfassen der Drucktransienten an der Messfläche - hier identisch mit der Probenkontaktfläche - betrachtet.

**[0034]** Ein Modell der inhomogenen Probe als Schichtenstapel ist in Fig. 2 dargestellt. Den einzelnen Schichten können Schichtdicken, Absorptionskoeffizienten, Grüneisen-Koeffizienten und Wärmekapazitäten zugeordnet werden. Für die erfindungsgemäße Auswertung benötigt man indes nur den Temperaturanstieg des Grüneisen-koeffizienten im Verhältnis zur Wärmekapazität, also den Quotienten beider. Insofern sind mit dem Verfahren auch nur die Quotienten als Fitparameter verwendbar, wie bereits erläutert, beispielsweise bei der Ausführung von selbstkonsistenten Schleifenberechnungen. Die Einführung von Quotienten aus dem Temperaturanstieg des Grüneisen-Koeffizienten und der Wärmekapazität als Fitparameter für die Einzelschichten des Schichtenstapels ist eine vorteilhafte Ausgestaltung des Verfahrens.

**[0035]** Welche Parameter bekannt sind und welche gefittet werden müssen, hängt grundsätzlich von der Natur der Probe und dem Vorwissen des Nutzers ab. Konkret für lebende biologische Proben, insbesondere für die Glukosebestimmung in lebender Haut, ist jedoch der Absorptionskoeffizient für das Messlicht besonders interessant und üblich aufgrund physiologischer Vorgänge veränderlich und daher unbekannt. Die Erfindung zielt deshalb darauf ab, wenigstens den tiefe aufgelösten Absorptionskoeffizienten,  $\alpha(x)$ , der inhomogenen Probe aus winkelabhängig erfassten Drucktran-

sienten zu bestimmen. Dies erfolgt näherungsweise durch Identifizieren von  $\alpha(x)$  mit schichtweise konstanten Parametern  $\alpha_i$ ,  $i = 1, \dots, M$  eines Schichtenstapel-Modells der Probe, wobei wenigstens ein  $\alpha_i$  a priori unbekannt ist und durch eine Fitprozedur bestimmt wird. In der Regel sind alle  $\alpha_i$  unbekannt und dienen als Fitparameter der Fitprozedur.

**[0036]** Die Schichtdicken in Fig. 2 sollen vorzugsweise aus dem Bereich 500 Nanometer bis 100 Mikrometer ausgewählt sein. Wesentlich dünnere Schichten als 500 Nanometer werden kaum ausreichende lineare Absorption zeigen und somit keine nennenswerte Energiedeposition. Es ist zweckmäßiger, solche dünnen Schichten im Verbund mit einer dickeren Nachbarschicht zu modellieren. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst jedoch ausdrücklich auch den Fall des - nahezu trivialen - Modells mit nur genau einer Schicht. Denn auch in diesem Fall wird hier vorgeschlagen, wenigstens zwei Messungen der Drucktransienten, mithin zwei Messungen der deponierten Energiedichte, unter wenigstens zwei verschiedenen Einfallswinkeln vorzunehmen, um die Schichtparameter zu ermitteln. Die erfindungsgemäße Fitprozedur für die Fitparameter kann dabei dann natürlich recht simpel ausfallen.

**[0037]** Anhand der drei Intensitätskurven in Fig. 2 kann die Erfindungsidee noch einmal in anderen Worten verdeutlicht werden. Die obere Kurve kennzeichnet beispielsweise den Intensitätsverlauf des Messlichts in der Probe, wenn das Messlicht senkrecht auf die Messfläche einfällt ( $\theta = 0^\circ$ ). Das Messlicht dringt am weitesten ein und verliert in den Einzelschichten am wenigsten Leistung, weil es jede der Schichten auf dem kürzesten Weg durchquert. Die zweite Kurve von oben repräsentiert die Intensität bei einem Einfallswinkel  $\theta = \varphi > 0^\circ$  und die unterste Kurve beschreibt den Intensitätsverlauf für den Einfallswinkel  $\theta = \varphi' > \varphi$ . Jede der Einzelschichten wird mit wachsendem Einfallswinkel auf einem längeren Weg durchquert, so dass die Schichten während der Pulsdauer des Messlichtpulses umso mehr Energiedichte akkumulieren, je näher sie sich an der Messfläche befinden. Tiefere Schichten tragen für große Einfallswinkel immer weniger bis gar nichts mehr bei. In der Zusammenschau der winkelabhängigen Drucksignale lässt sich auf die Abfolge und die Eigenschaften der Schichten zurückschließen.

**[0038]** Die Angabe von Zwischenwertintensitäten  $I_1, I_2, I_3, \dots$  an der mittleren Kurve soll darauf hinweisen, dass die Integrale in Gleichung (8) alle analytisch lösbar sind und dabei auf eben diese Zwischenwerte führen. Es kann hilfreich sein, diese Zwischenwerte als zusätzliche Fitparameter einzuführen und das Gleichungssystem mit einer größeren Zahl an Einfallswinkeln zu lösen. Allerdings hängen die Zwischenwerte von den Absorptionskoeffizienten und Dicken der Schichten direkt ab, so dass man dann noch eine weitere Konsistenzkontrolle durchzuführen hat.

**[0039]** Eine vorteilhafte Möglichkeit, die Fitprozedur auch für Schichtmodelle mit einer Mehrzahl von Einzelschichten und sogar mehreren Fitparametern pro Schicht schnell und effizient auszuführen, bietet sich durch ein geschicktes Verwenden der winkelabhängig gemessenen Drucktransienten bzw. absorbierten Energiedichten an. Wenn man nämlich die Messwerte nach Einfallswinkeln ordnet und zunächst nur Teilmengen der Messwerte für Einfallswinkel  $\theta > \theta_0 \gg 0^\circ$  in das Gleichungssystem (8) einfließen lässt - also nicht das vollständige System auswertet -, dann kann man bereits zu verlässlichen Ergebnissen für die Fitparameter der äußersten Schicht(en) gelangen. Die benutzten Messwerte enthalten eben tatsächlich keine Beiträge tieferer Schichten, d.h. dieses Vorgehen stellt keine Näherung dar, sondern umfasst lediglich eine Annahme über die Eindringtiefe des Messlichts unter den selektierten Einfallswinkeln.

**[0040]** Sollte die Annahme grob falsch getroffen werden, d.h. sollte man für die gewählte Teilmenge von Messwerten zu wenige Schichten im Modell vorsehen, dann erhält man zunächst fehlerhafte Fitparameter, die sich bei späterer Hinzunahme von mehr Schichten und unter Verwendung einer größeren Teilmenge der Messwerte wieder in Richtung auf korrekte Werte bewegen werden. Schlimmstenfalls vergeudet man Rechenzeit, erhält aber kein falsches Ergebnis.

**[0041]** Wenn man aber korrekte Annahmen macht, kann sich die Ausführung der Fitprozedur erheblich beschleunigen, weil bevorzugt die Fitparameter des Schichtenstapels für Schichten ausgehend von der äußersten Schicht sukzessiv gefittet werden, wobei das Erfüllen des vorbestimmten Konsistenzkriteriums beginnend mit dem größten Einfallswinkel des Messlichts für sukzessiv kleinere Einfallswinkel wiederholt überprüft wird. Dadurch dass man die Parameter der äußeren Schichten zuerst und die tieferliegenden nach und nach fixiert, kann man Rechenaufwand in den nachfolgenden Schritten des Fitverfahrens einsparen, vor allem wenn man pro Schicht mehrere Materialgrößen als Fitparameter ermitteln will.

**[0042]** Es ist hier zu erwähnen, dass man korrekte Annahmen im Sinne des zuvor Gesagten insbesondere dann machen kann, wenn man eine sich wiederholende Messaufgabe an immer derselben Probe zu lösen hat, wo man aus vorangegangenen Messungen bereits über eine fundierte Historie der möglichen Variationen der Fitparameter verfügt. Dies ist ganz besonders bei wiederholten Glukosemessungen an einem Probanden der Fall.

**[0043]** Wie bereits ausgeführt, ist das erfindungsgemäße Verfahren sehr gut zur Messung an lebenden biologischen Proben, insbesondere an lebenden Hautproben, geeignet. Ein Ziel ist die nichtinvasive Blutglukosebestimmung in vivo an einem menschlichen Körperteil. Für die Zielsetzung ist konkret die Wahl von mittleren Infrarot (MIR) Wellenlängen für das Messlicht besonders geeignet. Vorzugsweise weist das Messlicht Wellenlängen aus dem Intervall von 1 bis 20 Mikrometer, besonders bevorzugt von 6 bis 12 Mikrometer auf.

**[0044]** Es ist offenkundig, dass man die Wellenlänge des Messlichts während der Untersuchung einer einzigen Probe verändern kann. Beispielsweise kann man für eine erste Wellenlänge eine Sequenz von Einfallswinkeln durchlaufen und erste winkelabhängige Drucktransienten aus der Probe erfassen, um danach für eine zweite Wellenlänge dieselbe Sequenz von Einfallswinkeln zur Messung einer zweiten Sequenz von Drucktransienten zu verwenden. Dieses Vorgehen

ist insbesondere sinnvoll zur erfindungsgemäßen Bestimmung von Absorptionskoeffizienten, da diese selbst üblich von der Wellenlänge abhängen. Gerade anhand der Wellenlängenabhängigkeit der Absorption erfolgt die spektrale Identifikation gesuchter Substanzen.

[0045] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung wird jedoch darin gesehen, dass die Wellenlänge des Messlichts für vorbestimmte Einfallswinkel über ein vom Einfallswinkel abhängiges Intervall variiert wird. Auch hier liegt der Hauptvorteil in einer Beschleunigung der Untersuchung. Wenn nämlich im Beispiel der Glukosebestimmung an der lebenden Haut die Drucktransienten für große Einfallswinkel - streifender Einfall - gemessen und daraus vorzugsweise Werte der wellenlängenabhängigen Absorptionskoeffizienten für epidermale Schichten, insbesondere für das Stratum Corneum und das Stratum Spinosum, bestimmt werden, dann sind diese Messwerte zunächst nur für das außen liegende Stratum Corneum aussagekräftig. Hierbei weiß man aber aus Voruntersuchungen, dass Glukose kein wesentlicher Bestandteil des Stratum Corneum ist. Es ist daher nicht nötig, eine Mehrzahl von Wellenlänge einzustrahlen, die besonders stark von Glukose absorbiert werden, um einen ohnehin nur schwach veränderlichen Absorptionskoeffizienten in der äußersten Schicht zu verifizieren. Erst wenn das Messlicht auch das Stratum Spinosum erreichen kann, sind Glukosesensitive Wellenlängen sinnvoll und wichtig zur quantitativen Bestimmung der Absorption, damit eine realistische Glukose-Konzentration ermittelt werden kann. Von daher reicht es aus, solche Wellenlängen erst bei kleineren Einfallswinkeln des Messlichts hinzuschalten.

[0046] Als abschließende Bemerkung soll darauf hingewiesen werden, dass die Veränderung des Einfallswinkels bei der Beleuchtung der Messfläche mit Messlicht den unerwünschten Nebeneffekt haben kann, dass die tatsächlich in die Probe eingestrahlte Intensität variiert, weil ein ebenfalls variabler Lichtanteil von der Probe reflektiert wird. Die reflektierte Intensität kann man allerdings z.B. direkt mit einem Photodetektor messen. Hierdurch ist ohne weiteres ein numerischer Korrekturfaktor für die Intensitäten in den Gleichungen (2) und (8) ermittelbar. Es kann jedoch von Vorteil sein, stattdessen lieber die tatsächlich eintretende Messlichtintensität konstant zu halten, weil ansonsten mit erhöhtem Rauschen bei den gemessenen Drucktransienten zu rechnen ist. Zu diesem Zweck wird vorgeschlagen, das Messlicht durch eine elektronisch schaltbare Abschwächungseinrichtung, beispielsweise linear polarisiert durch einen Solenoid und einen Polarisator hindurch, auf die Messfläche einzustrahlen. Durch die Wahl der Bestromung der Spule lässt sich die Polarisationssebene des Messlichts dann so drehen, dass wahlweise mehr oder weniger Messlicht auf die Messfläche gelangt. Es kann damit eine automatisierbare Nachregelung der Messlichtintensität erfolgen, wenn z. B. besagter Photodetektor fortlaufend die reflektierte Intensität misst und an eine Steuereinheit für den Spulenstrom weitermeldet.

## Patentansprüche

1. Photoakustik-Verfahren mit einem Messlicht aufweisend einen vorbestimmten Wellenlängenbereich zur Bestimmung von Eigenschaften einer inhomogenen Probe, wobei die Probe für den vorbestimmten Wellenlängenbereich eine mittlere Absorptionslänge  $\mu$  aus dem Intervall 1 - 100 Mikrometer aufweist, umfassend die Schritte:

a) Einstrahlen von wenigstens einem Messlichtpuls mit vorbestimmter Pulsdauer und vorbestimmter Intensität auf eine Messfläche der Fläche  $F$  mit  $\sqrt{F} \gg \mu$  in der Oberfläche der inhomogenen Probe;

b) Detektieren von wenigstens einer Drucktransienten an der Messfläche, wobei die Drucktransiente durch Absorption des wenigstens einen Messlichtpulses in der inhomogenen Probe unter Erzeugen von einer zur Messfläche propagierenden Druckwelle entsteht;

c) Berechnen eines Wertes für die während der Pulsdauer von der Probe absorbierte Energiedichte aus dem Verlauf der wenigstens einen Drucktransienten am Anfang und am Ende des wenigstens einen Messlichtpulses;  
**gekennzeichnet durch**

d) Wiederholen der Schritte a) bis c) für voneinander verschiedene Einfallswinkel des Messlichts gegenüber der Normalen der Messfläche, wobei die in c) bestimmten Energiedichtewerte jeweils mit dem Einfallswinkel indiziert werden;

e) Modellieren der inhomogenen Probe als Schichtenstapel, wobei jeder Schicht wenigstens eine Schichtdicke und ein Absorptionskoeffizient zugeordnet werden, wobei wenigstens ein Absorptionskoeffizient einer Schicht ein Fitparameter ist;

f) Ausführen einer Fitprozedur für die Fitparameter des Schichtenstapels, wobei durch Variation der Fitparameter die Aufteilung der mit dem Einfallswinkel indizierten Energiedichtewerte auf Beiträge der einzelnen Schichten variiert wird, bis ein vorbestimmtes Konsistenzkriterium erfüllt ist;

g) Auslesen der gefitteten Fitparameter als Werte wenigstens für den tiefenaufgelösten Absorptionskoeffizienten der inhomogenen Probe.

2. Photoakustik-Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** in Schritt f) jeder Schicht weiterhin ein

## EP 3 477 278 A1

Quotient aus der Temperaturableitung des Grüneisen-Koeffizient und der Wärmekapazität des Schichtmaterials als Fitparameter zugeordnet werden.

- 5 3. Photoakustik-Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Fitparameter des Schichtenstapels für Schichten ausgehend von der äußersten Schicht sukzessiv gefittet werden, wobei das Erfüllen des vorbestimmten Konsistenzkriteriums beginnend mit dem größten Einfallswinkel des Messlichts für sukzessiv kleinere Einfallswinkel wiederholt überprüft wird.
- 10 4. Photoakustik-Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Pulsdauer der Messlichtpulse auf einen Wert aus dem Intervall von 100 bis 1000 Nanosekunden, bevorzugt aus dem Intervall von 200 bis 600 Nanosekunden, vorbestimmt wird.
- 15 5. Photoakustik-Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Schichtenstapel Einzelschichten mit Schichtdicken aus dem Intervall von 500 Nanometer bis 100 Mikrometer aufweist.
- 20 6. Photoakustik-Verfahren nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die inhomogene Probe eine biologische Probe, vorzugsweise eine lebende Probe, besonders bevorzugt eine lebende Hautprobe, ist.
- 25 7. Photoakustik-Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Messlicht Wellenlängen aus dem Intervall 1 bis 20 Mikrometer, bevorzugt 6 bis 12 Mikrometer aufweist.
- 30 8. Photoakustik-Verfahren nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Wellenlänge des Messlichts für vorbestimmte Einfallswinkel über ein vom Einfallswinkel abhängiges Intervall variiert wird.
- 35 9. Photoakustik-Verfahren nach den Ansprüchen 6 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die wellenlängenabhängigen Absorptionskoeffizienten für epidermale Schichten bestimmt werden, insbesondere für das Stratum Corneum und das Stratum Spinosum.

30

35

40

45

50

55

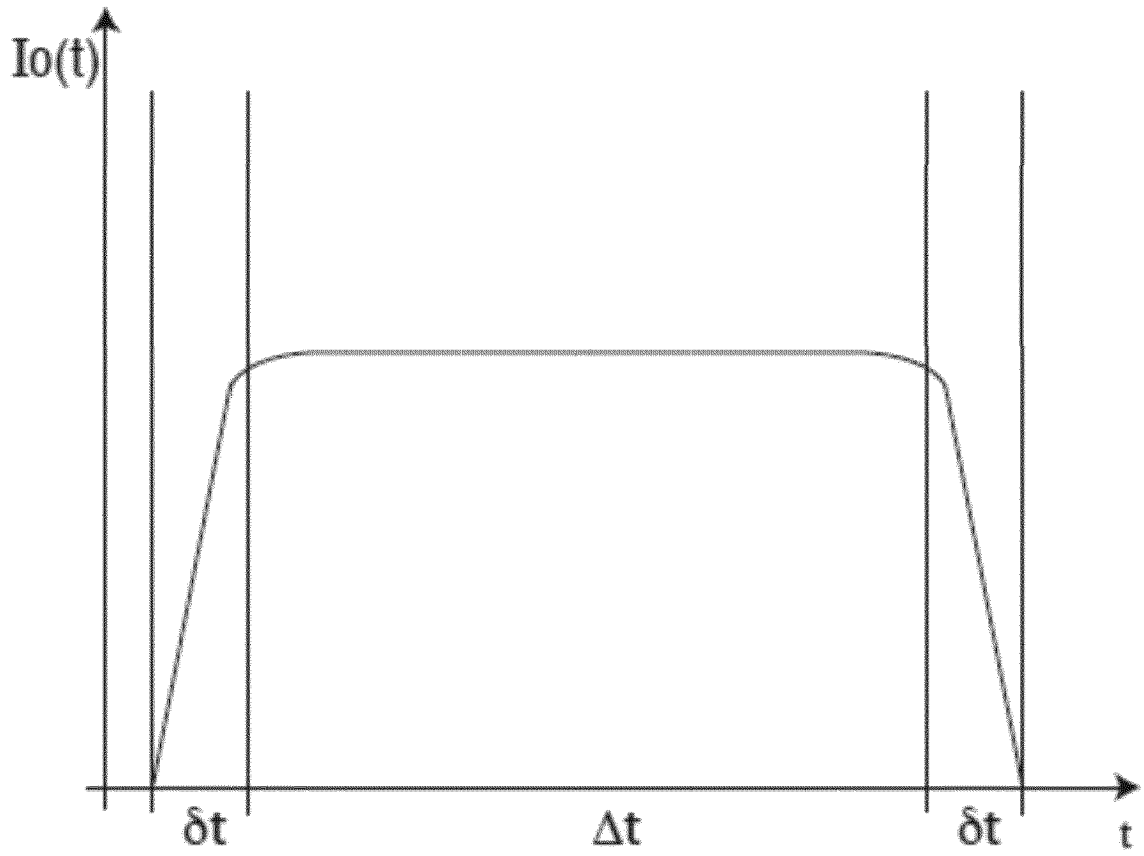


Fig. 1

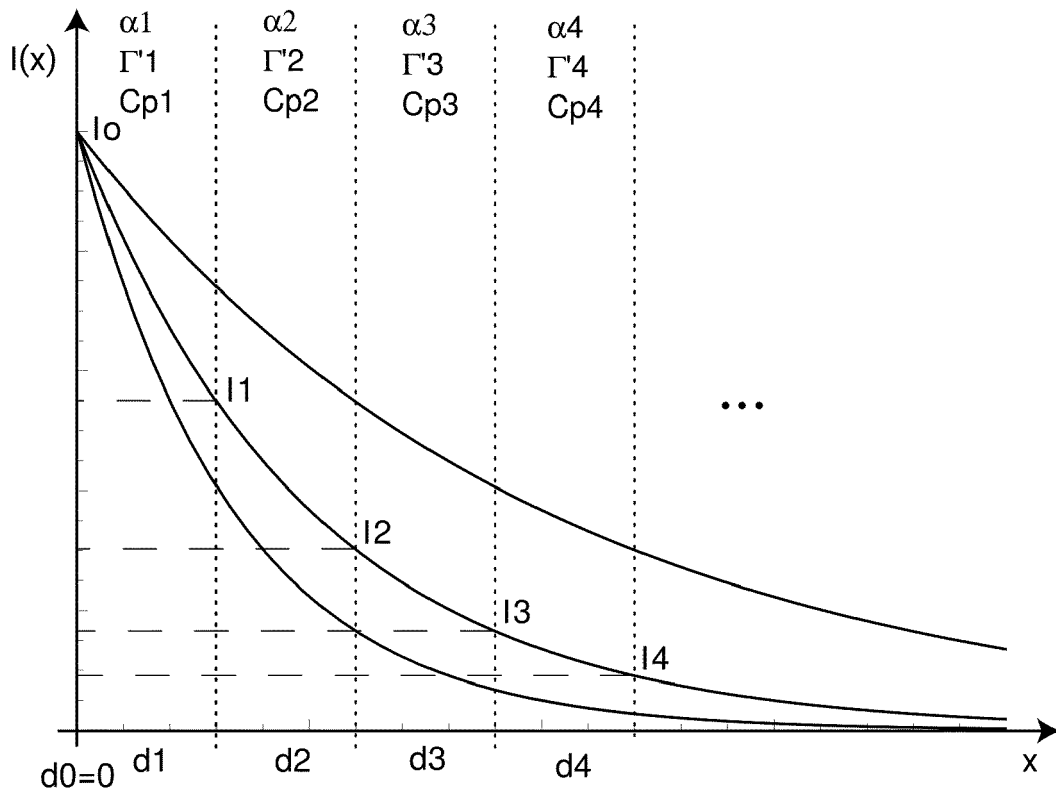


Fig. 2



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 17 19 8860

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
A,D	FEI GAO ET AL: "Single laser pulse generates dual photoacoustic signals for differential contrast photoacoustic imaging", SCIENTIFIC REPORTS, Bd. 7, Nr. 1, 4. April 2017 (2017-04-04), XP55433123, DOI: 10.1038/s41598-017-00725-4 * das ganze Dokument *	1-9	INV. G01N21/17 A61B5/145 A61B5/00
A	US 2010/070233 A1 (MASUMURA TAKAHIRO [US]) 18. März 2010 (2010-03-18) * Absätze [0004] - [0006], [0010], [0037] - [0047] * * Abbildungen 2, 4, 6, 7 *	1-9	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			G01N A61B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>München</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>5. April 2018</b>	Prüfer <b>Hoogen, Ricarda</b>
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument ..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 17 19 8860

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

05-04-2018

10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2010070233 A1	18-03-2010	JP 2010068885 A	02-04-2010
		US 2010070233 A1	18-03-2010
-----			

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE**

*Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.*

**In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur**

- **FEI GAO et al.** Single laser pulse generated dual photoacoustic signals for differential contrast photoacoustic imaging. *Scientific Reports*, 2017, vol. 7, 626 [0005]
- **VON KOTTMANN et al.** Glucose sensing in human epidermis using midinfrared photoacoustic detection. *BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS*, vol. 3 (4), 667 ff [0006]

专利名称(译)	具有测量光的光声方法，该测量光包括用于确定不均匀样品的性质的预定波长范围		
公开(公告)号	<a href="#">EP3477278A1</a>	公开(公告)日	2019-05-01
申请号	EP2017198860	申请日	2017-10-27
[标]申请(专利权)人(译)	HUMBOLDT UNIVET ZU BERLIN		
申请(专利权)人(译)	洪堡大学ZU BERLIN		
当前申请(专利权)人(译)	洪堡大学ZU BERLIN		
[标]发明人	VON LILIENFELD TOAL HERMANN		
发明人	SCHLESINGER, RAPHAEL KISCHKAT, JAN-FERENC VON LILIENFELD-TOAL, HERMANN		
IPC分类号	G01N21/17 A61B5/145 A61B5/00		
CPC分类号	A61B5/0095 A61B5/14532 G01N21/1702 G01N2021/1706		
其他公开文献	EP3477278B1		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

本发明涉及一种光声方法，包括具有预定波长范围的测量光，用于确定不均匀样品的性质，该样品具有对于预定波长范围在1至100微米范围内的平均吸收长度 $\mu$ ，该方法包括：以下步骤：a) 将具有预定脉冲持续时间和预定强度的至少一个测量光脉冲辐射到区域F的测量区域上，在非均匀样本的表面中具有 $\sqrt{F} \gg \mu$ ；b) 检测测量区域处的至少一个压力瞬变，由非均匀样品中的至少一个测量光脉冲的吸收产生的压力瞬变，产生传播到测量区域的压力波；c) 在脉冲持续时间内从至少一个压力瞬变曲线开始和结束时计算样品吸收的能量密度值一个测量光脉冲；其特征在于，d) 重复步骤a) 至c)，测量光相对于测量区域的法线的不同入射角，c) 中确定的能量密度值各自用入射角表示；e) 将非均匀样品建模为层叠，每层至少分配层厚度和吸收系数，层的至少一个吸收系数是拟合参数；f) 对层堆叠的拟合参数执行拟合程序，通过拟合参数的变化来改变各个层的贡献的入射角所指示的能量密度值的划分，直到满足预定的一致性标准。；g) 将拟合拟合参数读出至少为非均匀样品的深度分辨吸收系数的值。

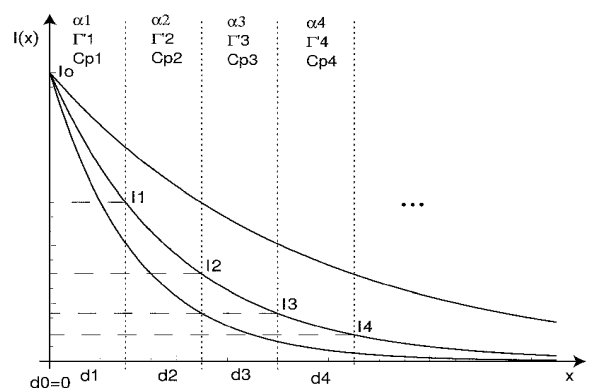


Fig. 2