



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
08.09.2010 Patentblatt 2010/36

(51) Int Cl.:
A61B 5/00 (2006.01) A61B 5/103 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **09154437.9**

(22) Anmeldetag: **05.03.2009**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA RS

(71) Anmelder: **BrainLAB AG**
85622 Feldkirchen (DE)

(72) Erfinder:
• **Urban, Alexander**
85661, Forstinning (DE)

• **Druse, Alexander**
80637, München (DE)
• **Vollmer, Fritz**
80469, München (DE)

(74) Vertreter: **Schwabe - Sandmair - Marx**
Patentanwälte
Stuntzstraße 16
81677 München (DE)

(54) **Medizintechnische Bildregistrierung mittels optischer Kohärenztomographie**

(57) Die Erfindung betrifft ein medizintechnisches Bildregistrierungsverfahren, bei dem ein realer Patientenkörperteil (20) positionell einem gespeicherten Bild des Körperteils (20) computerunterstützt zugeordnet wird, wobei der Patientenkörperteil (20) eine starre Struktur (24), und eine darüber liegende Weichstruktur (22) aufweist, wobei bei der Erfassung der realen Raumpo-

sition des Körperteils (20) die Position mindestens eines Referenzpunktes (27) auf der starren Struktur (24) durch die geschlossene Weichstruktur (22) hindurch mittels einer optischen Kohärenztomographie (OCT) ermittelt wird. Sie betrifft ferner eine Pointereinheit (10) eines medizintechnischen Bildregistrierungsgeräts, die einen optischen Kohärenztomographen (OCT) oder seine Abstrahleinheit umfasst.

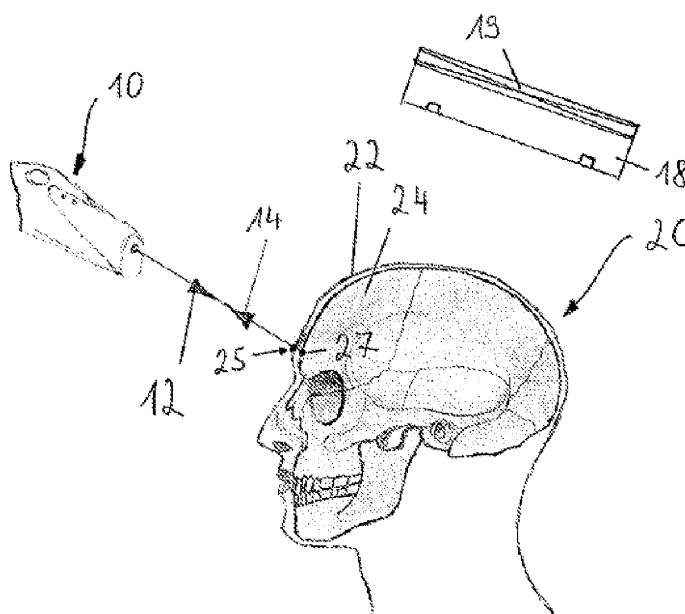


Fig. 1

Beschreibung

[0001] Die folgende Erfindung betrifft das technische Gebiet der medizintechnischen Bildregistrierung, bei welcher ein realer Patienten Körperteil positionell einem gespeicherten Bild des Körperteils computerunterstützt zugeordnet wird, um so eine bildgeführte bzw. bildunterstützte Behandlung durchführen zu können.

[0002] Es gibt verschiedene Arten, in einem solchen Umfeld einen Patienten zu registrieren, und eine davon umfasst die Verwendung von Markern, die gescannt und während der Behandlung mittels eines medizintechnischen Trackingsystems erfasst werden. Eine solche Registrierungsverfahren ist beispielsweise in der DE 196 39 861 A1 beschrieben.

[0003] Eine andere Art der Registrierung ist aus der EP 1 142 536 B1 bekannt, und hierbei wird die Oberfläche des Patienten, die mit aufgestrahlten Lichtpunkten erfassbar gemacht wurde, gescannt und einem entsprechenden Oberflächenverlauf in vorab akquirierten Patientenbilddaten zugeordnet.

[0004] Aus der WO 2008/134236 A1 ist schließlich noch ein Registrierungssystem bekannt, das mit einem so genannten "Weichgewebe-durchdringenden" Lasersystem arbeitet.

[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Registrierungsverfahren für einen Patienten körperteil zu schaffen, welches eine hochgenaue Registrierung ermöglicht und dabei nicht invasiv bleibt.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein medizintechnisches Bildregistrierungsverfahren gemäß dem Anspruch 1 sowie durch eine Pointereinheit eines medizintechnischen Bildregistrierungsgeräts gemäß dem Anspruch 13 gelöst. Die Unteransprüche definieren bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung.

[0007] Beim erfindungsgemäßen medizintechnischen Bildregistrierungsverfahren wird ein Patienten Körperteil registriert, der eine starre Struktur und eine darüber liegende Weichstruktur aufweist, indem bei der Erfassung der realen Raumposition des Körperteils die Position mindestens eines Referenzpunktes auf der starren Struktur durch die geschlossene Weichstruktur hindurch mittels einer optischen Kohärenztomographie (OCT) ermittelt wird. Mit der optischen Kohärenztomographie ist es möglich, starre Strukturen durch Weichstrukturen hindurch anzumessen, sowie verschiedene Gewebearten und deren Position zu ermitteln. Die vorliegende Erfindung hat den Wert dieser Technologie für die medizintechnische Bildregistrierung erkannt, ebenso wie eine geeignete Umsetzung durch das Anmessen und Lokalisieren von starren Strukturen, die sich unter Weichteilstrukturen befinden.

[0008] Die Erfindung könnte in diesem Sinne auch bzw. zusätzlich als Verwendung eines optischen Kohärenztomographen bei der Lokalisierung bzw. Anmessung von Starrstruktur-Referenzpunkten unterhalb einer Weichstruktur angesehen werden.

[0009] Der Vorteil des Anmessens bzw. Erfassens von

Referenzpunkten auf starren Strukturen liegt darin, dass sie eindeutig zugeordnet werden können und keinen Verschiebungen unterliegen, wie sie z.B. bei aufgeklebten Markern auf Weichgewebe oder bei natürlichen Weichgewebe-Landmarken auftreten können. Auch ist die Genauigkeit des Referenzpunkt-Erfassungsvorganges nicht mehr von der Oberflächenbeschaffenheit des Weichgewebes abhängig, z.B. von dessen Reflektions-eigenschaften oder Adsorptionseigenschaften für Licht. Dies alles führt zu einer hochgenauen Registrierung.

[0010] Bei einer Ausführungsform der Erfindung wird die reale Raumposition mehrerer Referenzpunkte, einer Wolke von Referenzpunkten, linienförmig aneinander liegender oder beabstandet nebeneinander liegender Referenzpunkte bestimmt, um so ein zuordnungsfähiges Oberflächenabbild zu schaffen.

[0011] Die starre Struktur kann eine knöcherne Struktur oder eine Knorpelstruktur sein, während die Weichstruktur eine Hautstruktur sein kann. Diese Beispiele sind aber nicht einschränkend zu verstehen, weil sich eine solche Einschränkung nur durch die Funktionsweise des optischen Kohärenztomographen ergibt. Solange also eine Schicht, die mit dem Kohärenztomographen-Strahl durchdrungen werden kann (hier bezeichnet als Weichgewebe) über eine nicht durchdringungsfähigen, für den Strahl reflektiven Schicht (hier bezeichnet als starre Struktur) liegt, können das vorliegende, erfindungsgemäße Verfahren und die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Einsatz kommen. Garantiert wird dabei eine hochgenaue Registrierung, die nicht von der Hautbeschaffenheit oder Lage abhängig ist. Bei der optischen Kohärenztomographie wird monochromatisches Licht verwendet, das eine kurze Kohärenz aufweist und somit die Akquirierung eines detaillierten Tiefenprofils am Patienten körperteil gestattet. Wenn beispielsweise ein Schädel eines Patienten gescannt wird, um den Scan mit voroperativ akquirierten Daten zu matchen, bringt dies viele Vorteile mit sich, weil die Schädelhautbewegung nicht länger ein Problem ist, ebenso wenig wie das Schwitzen oder die Farbe der Haut. Der knöcherne Schädel entspricht immer den mit einem Bilderzeugungsverfahren (CT, MR, etc.) erfassten präoperativen Daten. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass das Licht, welches verwendet wird, um die Referenzpunkterfassung zu bewirken (OCT-Scan) sehr nahe am infraroten Bereich liegt, so dass für die Sicherheit des Patienten gesorgt ist.

[0012] Grundsätzlich können das Verfahren sowie die Pointereinheit gemäß der vorliegenden Erfindung auch verwendet werden, um interoperativ Bilddaten zu erhalten oder zu aktualisieren.

[0013] Auf Einzelheiten zur optischen Kohärenztomographie und ihrer erfindungsgemäßen Verwendung wird später bei der Erläuterung des Ausführungsbeispiels noch detaillierter eingegangen, wobei die beschriebenen Eigenschaften natürlich einzeln sowie in jedweder sinnvollen Kombination beim erfindungsgemäßen Verfahren bzw. bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung umgesetzt werden können.

[0014] Gemäß einer Ausführungsform des Verfahrens der vorliegenden Erfindung wird die Raumpositionserfassung mit Hilfe eines medizintechnischen, optischen Trackingsystems erfolgen und die Registrierung insbesondere durch ein medizintechnisches Navigationssystem durchgeführt werden, dem das Trackingsystem zugeordnet ist. Der OCT-Strahl, d.h. der Scan- oder Abtaststrahl des optischen Kohärenztomographen kann durch den Tomographen selbst oder seine Abstrahleinheit auf das Patientenkörperteil aufgestrahlt werden.

[0015] Es ist möglich, die Raumlage des Referenzpunktes auf der starren Struktur zu ermitteln, und zwar durch:

- a) die räumliche Erfassung des ihm zugehörigen OCT-Strahl-Reflexpunktes außen auf der Weichstruktur mittels des Trackingsystems, und
- b) die Bestimmung der Tiefenlage des Referenzpunktes unter dem Reflexpunkt mittels der optischen Kohärenztomographie.

[0016] Zusätzlich oder alternativ kann die genannte Raumlage ermittelt werden durch:

- a) die Erfassung der Raumposition des optischen Kohärenztomographen (10) oder seiner Abstrahleinheit, insbesondere durch eine daran angeordnete Referenzeinrichtung bzw. -anordnung (13), mittels des Trackingsystems, und
- b) die Bestimmung der Raumlage des Referenzpunktes bezüglich der Raumposition des optischen Kohärenztomographen (10) oder seiner Abstrahleinheit mittels der optischen Kohärenztomographie.

[0017] Der optische Kohärenztomograph kann also, muss aber nicht selbst im Trackingsystem verfolgt werden. Er kann bei der Positionsermittlung für den Referenzpunkt mit der Weichstruktur in Kontakt sein oder kontaktlos über der Weichstruktur angeordnet werden. Es gibt auch unterschiedliche, im Rahmen der Erfindung mögliche Registrierung-Zuordnungsarten, wobei bei einer davon eine Zuordnung diskreter Bildwerte erfolgt, insbesondere erfasste Strukturkanten aufeinander registriert werden. Zusätzlich oder alternativ ist es möglich, dass bei der Registrierung der räumlich erfassten Referenzpunkte mit dem gespeicherten Bild eine Grauwert-Zuordnung der Bildwerte erfolgt, die zwar rechnerisch aufwendiger sein dürfte, jedoch eine noch höhere Registrierungsgenauigkeit ermöglicht.

[0018] Die erfindungsgemäße Pointereinheit eines medizintechnischen Bildregistrierungsgerätes identifiziert oder definiert einen Referenzpunkt für die Zuordnung bzw. zeigt diesen Referenzpunkt an, und sie umfasst einen optischen Kohärenztomographen (OCT) bzw. seine Abstrahleinheit. Sie kann auch aus dem optischen Kohärenztomographen oder seiner Abstrahleinheit aufgebaut sein, also im Wesentlichen daraus beste-

hen bzw. ein integriertes Bauteil bilden.

[0019] Wie oben schon bei der Erörterung des erfindungsgemäßen Verfahrens angedeutet, kann die Pointereinheit mit einer Referenzeinrichtung bzw. -anordnung versehen sein, die von einem medizintechnischen Trackingsystem identifiziert und/oder positionell erfasst werden kann. Wenn ein geeignetes Referenzpunkt-Erfassungsverfahren gewählt wird, ist dies aber nicht unbedingt notwendig.

[0020] Es ist möglich, die Pointereinheit mit einer Datenübertragungsvorrichtung auszustatten, um ermittelte Referenzpunkt-Positionsdaten an eine Auswerteeinheit, insbesondere ein zugeordnetes medizintechnisches Navigationssystem zu übermitteln. Die Datenübertragungsvorrichtung kann kabelgebunden oder kabellos (Funk, Bluetooth, etc.) sein.

[0021] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist die Abstrahleinheit des optischen Kohärenztomographen einen Aufsatz auf, insbesondere eine verlängerte Optik speziell eine Lichtleiteroptik, wobei die Lichtleiteroptik im Besonderen ein starrer, länglicher Verlängerungsaufsatz sein kann. Mit einem solchen Aufsatz lassen sich auch Bereiche erreichen und registrieren, die sich an schwer von außen in direkter Sichtlinie zugänglichen Stellen befinden, beispielsweise in der Mundhöhle oder der Nasenhöhle.

[0022] Die Erfindung wird im Weiteren anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Sie kann alle hierin beschriebenen Merkmale einzeln, sowie in jedweder sinnvollen Kombination umfassen. In den beiliegenden Zeichnungen zeigen:

- Figur 1 eine schematische Darstellung eines OCT-Scans an einem Patientenschädel;
- Figur 2 eine Vergrößerung und schematische Darstellung der OCT- Strahlreflektion; und
- Figuren 3 bis 5 schematische Darstellungen unterschiedlicher Aufbauvarianten für optische Kohärenztomographen.

[0023] Zunächst wird hier auf grundsätzliche Eigenschaften der optischen Kohärenztomographie eingegangen, wie sie im Rahmen der vorliegenden Erfindung, d.h. beim erfindungsgemäßen Verfahren, bei der erfindungsgemäßen Pointereinheit oder allgemein bei der Verwendung eines OCT-Gerätes in der Bildregistrierung, umgesetzt werden können. Die im Folgenden beschriebenen Merkmale müssen nicht immer gemeinsam verwirklicht werden, sondern können je nach Ausgestaltung auch alternativ zum Einsatz kommen.

[0024] Die erfindungsgemäß einsetzbare optische Kohärenztomographie ist ein zerstörungsfreies, bildgebendes Verfahren, welches die innere Struktur von Materialien darstellen kann. Mittels beispielsweise Infrarotlicht kann kontaktfrei und daher zerstörungsfrei ein Querschnitt einer Probe angefertigt werden, also beispiels-

weise eines Patientenkörperteils. Die Tiefenauflösung kann bei 20 μm bis 1 μm liegen und das physikalische Prinzip liegt in der interferometrischen Überlagerung von Infrarotlichtwellen, die in unterschiedlicher Probentiefe gestreut werden, mit einer Referenzwelle. Die rückgestrahlte Intensität enthält die Tiefeninformation der Probe und lässt sich nach Anwendung mathematischer Algorithmen als Querschnittsbild darstellen. Mit anderen Worten wird bei der optischen Kohärenztomographie eine Topographie von Oberflächen und Strukturen in streuenden Medien sichtbar gemacht, und zwar mittels eines optischen Interferometers, das die Streustärke und die Tiefenlage der Strukturen mit hoher Auflösung bestimmt.

[0025] Die Darstellung von Gewebestrukturen kann z.B. bis zu einer Tiefe von 3 - 8 mm in Form von zweidimensionalen Schnittbildern hindurch bis zur Oberfläche folgen. Das verwendete monochromatische Licht hat eine sehr kurze Kohärenzlänge, und wenn eine Probe mit diesem Licht bestrahlt wird, kommt es zu Reflektionen an der Oberfläche und Streuprozessen in der Probe, die einen Teil des Lichtes zurücksenden. Dieses Probenlicht wird - wie schon erwähnt - mit dem Licht einer Referenzebene überlagert, wobei als Lichtquelle eine SLD mit kurzer Kohärenzlänge eingesetzt wird. Die optische Kohärenztomographie zählt damit zur Kurzkohärenz-Interferometrie.

[0026] Zur Erläuterung grundsätzlicher Ausgestaltungen optischer Kohärenztomographen wird im Weiteren zunächst auf die Figuren 3 bis 5 Bezug genommen. Der optische Kohärenztomograph ist in diesen drei Figuren insgesamt jeweils mit dem Bezugszeichen 10 gekennzeichnet, und in der Figur 3, die einen grundsätzlichen Aufbau zeigt, sind noch Ausstattungsmerkmale vorhanden, die den Tomographen 10 in ein medizintechnisches Tracking- und Navigationssystem integrieren. Hierzu gehören beispielsweise eine Referenzanordnung 13, die, wie oben schon angedeutet, vorhanden sein kann aber nicht unbedingt notwendig ist (je nach Referenzpunkt-Bestimmungsmethode). Aus diesem Grund ist in der Darstellung die Verbindungslinie durch eine Wellenlinie unterbrochen worden. Ein weiteres solches Merkmal betrifft die Datenanbindung 31, die kabelgebunden oder auch, wie schematisch durch das Funk-Symbol angezeigt, kabellos sein kann. Weil auch hier beide Möglichkeiten bestehen, ist die dargestellte Datenleitung durch eine Wellenlinie unterbrochen.

[0027] Bei dem dargestellten, einfachen schematischen Aufbau des Kohärenztomographen 10 der Figur 3 ist eine SLD-Lichterzeugungseinheit vorhanden, d.h. eine Superlumineszenzdiode, die beispielsweise Licht mit einer Wellenlänge von $\lambda = 1280 \text{ nm}$ und einer Kohärenzlänge von etwa 20 μm erzeugen kann. Die SLD 32 strahlt ihr Licht durch einen Strahlteiler (z.B. einen halbdurchlässigen Spiegel), und ein Teil, der OCT-Strahl 12, gelangt auf die Probe P und wird aus verschiedenen Ebenen zurückgestrahlt (Strahl 14). Der Strahl 14 trifft dann wieder auf den Strahlteiler 34 und wird von diesem auf den Detektor 38 gelenkt. Der Referenzstrahl 15 geht vom

Strahlteiler aus direkt auf einen Spiegel 36 und durch den Strahlteiler 34 hindurch auch zum Detektor 38. Das rückgestrahlte Licht des OCT-Strahls 12, 14 wird also mit dem Licht des Referenzstrahls 15 überlagert. Ein Interferenzsignal entsteht dann, wenn sich die Wellenzüge des rückgestrahlten Lichts mit denen des Referenzstrahls innerhalb der Kohärenzlänge überlagern. Mehrfach gestreutes Licht hat durch die größere Wegdifferenz keine definierte Phasenbeziehung zum Licht des Referenzstrahls und trägt deshalb nicht zum Interferenzsignal bei. Dadurch wird nur einfach gestreutes Licht aus einer definierten Gewebetiefe verarbeitet. Je kürzer die Kohärenzlänge, desto besser ist das Auflösungsvermögen des Verfahrens. Die Darstellung eines Tiefenprofils wird möglich, weil alle Lichtwellen eliminiert werden, die das einfach gestreute Licht verdecken. Das Interferenzsignal ist ein Maß für die Stärke der Streuung in der entsprechenden Gewebetiefe. Die Einstrahltiefe wird durch die Streueigenschaften des Gewebes begrenzt.

[0028] Durch die kontinuierliche Variation der Referenzstrahlänge entsteht somit ein Tiefenprofil der Rückstreuintensität an einer Stelle des Gewebes. Durch die laterale Ablenkung des Strahls über die Gewebeoberfläche entstehen zweidimensionale Schnittbilder.

[0029] Die am Detektor empfangenen Daten können dann zur Auswertung über die Datenleitung 31 versendet werden oder durch eine eingebaute Auswerteeinheit ausgewertet und als fertige Tiefen- bzw. Schnittbilddaten weitergegeben werden.

[0030] Der Kohärenztomograph 10 der Figur 4 unterscheidet sich in seinem Aufbau dadurch, dass die SLD 42 im Gehäuse 40 einen breiten Strahl 13 durch den Strahlteiler 44 aussendet, der durch eine Linse 45 gebündelt wird, bevor er auf die Probe auftritt. Der durch Spiegel 46 reflektierte Referenzstrahl und der zurückgeworfene OCT-Strahl 13 werden ebenfalls durch eine Linse 47 gebündelt, bevor sie auf den Detektor 48 auftreffen. Durch eine Bewegung des Spiegel 46 in der Horizontalen von links nach rechts kann die Eindringtiefe des Strahls 13 in das Gewebe P verändert werden.

[0031] Eine weitere Ausführungsform eines optischen Kohärenztomographen ist in der Figur 5 dargestellt. Hier wird im Tomographen 10 im Gehäuse 50 durch die SLD 52 das Licht erzeugt und tritt dann in einen Phasenschmelzkoppler 53 ein. Von dort aus wird es über den Kollimator 54 zum Galvanometerscanner 56 geleitet, aufgeteilt, durch die Linse 55 geführt und als OCT-Strahlen 51 zur Probe P gestrahlt. Die Rückführung erfolgt umgekehrt durch die entsprechenden Bauteile und dann über einen weiteren Kollimator 59, das Gitter 56, die Linse 57 auf den Detektor 58. Mit einer Veränderung des Neigungswinkel des Galvanometerscanner 56 lässt sich die Position des Strahls 51 auf der Oberfläche der Probe P verändern.

[0032] Den Figuren 1 und 2 ist nun die erfindungsgemäße Verwendung in schematischer Form zu entnehmen. Dargestellt ist in der Figur 1 der Kopf 20 eines Patienten, also der Patientenkörperteil, wie er oben be-

zeichnet wurde. Er besteht vereinfacht aus dem knöchernen Schädel 24 und der darüber liegenden Haut 22, und mit dem Referenztomographen 10 soll nun mit Hilfe des integrierten Navigations- und Trackingsystems 18, 19, das optische Signale positionell erfassen kann, der Kopf 20 des Patienten registriert werden. Dabei wird er einem vorab erstellten Bilddatensatz positionell zugeordnet, der beispielsweise aus einer CT- oder einer MR-Bilderfassung stammt.

[0033] Bei der dargestellten Methode der Figur 1 ist der Kohärenztomograph nicht mit einer Referenzanordnung versehen, er ist also frei bewegbar und wird nicht durch das Trackingsystem 18 lokalisiert. Er sendet den OCT-Strahl 12 aus, der auf den Kopf 20 trifft und zurückgestrahlt wird.

[0034] Zur Verdeutlichung wird hier auf die Figur 2 Bezug genommen. Hier ist der einfallende Strahl 12 gezeigt, der in verschiedener Weise zurückgestrahlt wird, was hier nur grundsätzlich durch die Rückstrahlen 15, 16 und 17 angedeutet wird. Mit den Strahlen 15, 16 und 17 wird in Figur 2 jeweils ein seitlicher Anteil des Rückstrahls aufgezeigt, um die verschiedenen Reflektionsebenen bzw. Schichten deutlich zu machen. Zur Auswertung bei der Tiefenbestimmung des Referenzpunktes 27 auf der knöchernen Schädelstruktur wird aber natürlich der Rückstrahl 14 im Kohärenztomographen 10 verarbeitet, der entgegen dem OCT-Strahl 12 zurückkehrt (siehe Figur 3). Man sieht aber an der Darstellung der Figur 2, dass der OCT-Strahl 12 in verschiedenen Ebenen unterschiedliche Rückläufer bzw. Reflektionsstrahlen 15, 16 und 17 erzeugt, und hierdurch lässt sich ein Tiefenprofil erstellen. Interessant ist für eine hier gewählte Art der erfindungsgemäßen Registrierung noch speziell der tatsächlich schräg reflektierte Strahl 15, der einen Lichtpunkt 25 auf der Hautoberseite repräsentiert. Dieser Lichtpunkt auf der Hautoberseite kann nämlich vom Trackingsystem 18 erfasst und positionell eingeordnet werden, wodurch man schon einen absoluten Raumpunkt (mit bestimmten Raumkoordinaten) aus dem Trackingsystem erhält, der dann zusammen mit der Tiefeninformation für den Punkt 27 aus der optischen Kohärenztomographie eine sehr gute Positionserfassung und Registrierung zulässt. Der Punkt 25 ist zwar wieder ein Reflektionspunkt auf der Haut, jedoch genügt diese Informationsgenauigkeit, weil die tatsächliche Registrierung auf den "harten" Werten für den knöchernen Schädel und dessen Oberfläche basiert. Ein entsprechendes Registrierungs-Matching von Oberflächen, die durch mehrere OCT-Punkte des Schädelknochens erhalten werden (Punkte 27) wird also die höchste Genauigkeit ergeben, während die Information über die Position des reflektierten Lichtpunkts 25 als Einstiegshilfe für die Zuordnung beim computerunterstützten Matching-Verfahren dient.

[0035] Wenn - wie in Figur 1 als Möglichkeit dargestellt - eine Referenzanordnung 13 am Tomographen 10 angeordnet ist, muss nicht unbedingt der "Umweg" über den Lichtpunkt 25 gemacht werden. Man würde dann die

Position des Tomographen 10 und damit der Lichtquelle bzw. des Lichtaustrittspunktes kennen und müsste dieser Position nur noch die Tiefeninformation aus der optischen Kohärenztomographie hinzufügen, um direkt den Referenzpunkt 27 lokalisieren zu können.

Patentansprüche

1. Medizintechnisches Bildregistrierungsverfahren, bei dem ein realer Patientenkörper (20) positionell einem gespeicherten Bild des Körperteils (20) computerunterstützt zugeordnet wird, wobei der Patientenkörper (20) eine starre Struktur (24), und eine darüber liegende Weichstruktur (22) aufweist, **dadurch gekennzeichnet, dass** bei der Erfassung der realen Raumposition des Körperteils (20) die Position mindestens eines Referenzpunktes (27) auf der starren Struktur (24) durch die geschlossene Weichstruktur (22) hindurch mittels einer optischen Kohärenztomographie (OCT) ermittelt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die reale Raumposition mehrerer Referenzpunkte, einer Wolke von Referenzpunkten, linienförmig aneinander liegender oder beabstandet nebeneinander liegender Referenzpunkte bestimmt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die starre Struktur eine knöcherne oder Knorpelstruktur ist.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem die Weichstruktur eine Hautstruktur ist.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem die Raumpositionserfassung mit Hilfe eines medizintechnischen, optischen Trackingsystems (18) erfolgt und die Registrierung insbesondere durch ein medizintechnisches Navigationssystem (19) durchgeführt wird, dem das Trackingsystem (18) zugeordnet ist.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei dem durch einen optischen Kohärenztomographen (10) oder seine Abstrahleinheit ein OCT-Strahl auf das Patientenkörper (20) aufgestrahlt wird.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei dem die Raumlage des Referenzpunktes (27) auf der starren Struktur ermittelt wird durch:
 - a) die räumliche Erfassung des ihm zugehörigen OCT-Strahl-Reflexpunktes außen auf der Weichstruktur mittels des Trackingsystems, und
 - b) die Bestimmung der Tiefenlage des Referenzpunktes unter dem Reflexpunkt mittels der optischen Kohärenztomographie.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem die Raumlage des Referenzpunktes (27) auf der starren Struktur ermittelt wird durch:
- a) die Erfassung der Raumposition des optischen Kohärenztomographen (10) oder seiner Abstrahleinheit, insbesondere durch eine daran angeordnete Referenzeinrichtung bzw. -anordnung (13), mittels des Trackingsystems, und
 - b) die Bestimmung der Raumlage des Referenzpunktes bezüglich der Raumposition des optischen Kohärenztomographen (10) oder seiner Abstrahleinheit mittels der optischen Kohärenztomographie.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei dem der optische Kohärenztomograph oder seine Abstrahleinheit bei der Positionsermittlung für den Referenzpunkt (27) mit der Weichstruktur (22) in Kontakt ist.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, bei dem der optische Kohärenztomograph oder seine Abstrahleinheit bei der Positionsermittlung für den Referenzpunkt (27) kontaktlos über der Weichstruktur (22) angeordnet ist.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, bei dem bei der Registrierung der räumlich erfassten Referenzpunkte mit dem gespeicherten Bild eine Zuordnung diskreter Bildwerte erfolgt, wobei insbesondere erfasste Strukturkanten aufeinander registriert werden.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei dem bei der Registrierung der räumlich erfassten Referenzpunkte mit dem gespeicherten Bild eine Grauwert-Zuordnung der Bildwerte erfolgt.
13. Pointereinheit eines medizintechnischen Bildregistrierungsgeräts, mit dessen Hilfe ein realer Patienten Körperteil (20) positionell einem gespeicherten Bild des Körperteils (20) computerunterstützt zugeordnet wird, wobei mit der Pointereinheit ein Referenzpunkt (27) zur Zuordnung identifiziert bzw. angezeigt wird, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Pointereinheit einen optischen Kohärenztomographen (OCT) (10) oder seine Abstrahleinheit umfasst.
14. Pointereinheit nach Anspruch 13, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie aus einem optischen Kohärenztomographen (OCT) (10) oder seiner Abstrahleinheit aufgebaut ist.
15. Pointereinheit nach Anspruch 13 oder 14, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie mit einer Referenzeinrichtung bzw. -anordnung (13) versehen ist, die von einem medizintechnischen Trackingsystem identifiziert und/oder positionell erfasst werden kann.
16. Pointereinheit nach einem der Ansprüche 13 bis 15, **dadurch gekennzeichnet, dass** sie mit einer Datenübertragungsvorrichtung (31), insbesondere einer kabelgebundenen oder kabellosen Datenübertragungsvorrichtung, versehen ist, um ermittelte Referenzpunkt-Positionsdaten an eine Auswerteeinheit, insbesondere ein zugeordnetes medizintechnisches Navigationssystem (19), zu übermitteln.
17. Pointereinheit nach einem der Ansprüche 13 bis 16, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Abstrahleinheit des optischen Kohärenztomographen einen Aufsatz aufweist, insbesondere eine verlängerte Optik, speziell eine Lichtleiteroptik, wobei die Lichtleiteroptik im Besonderen ein starrer, länglicher Verlängerungsaufsatz ist.

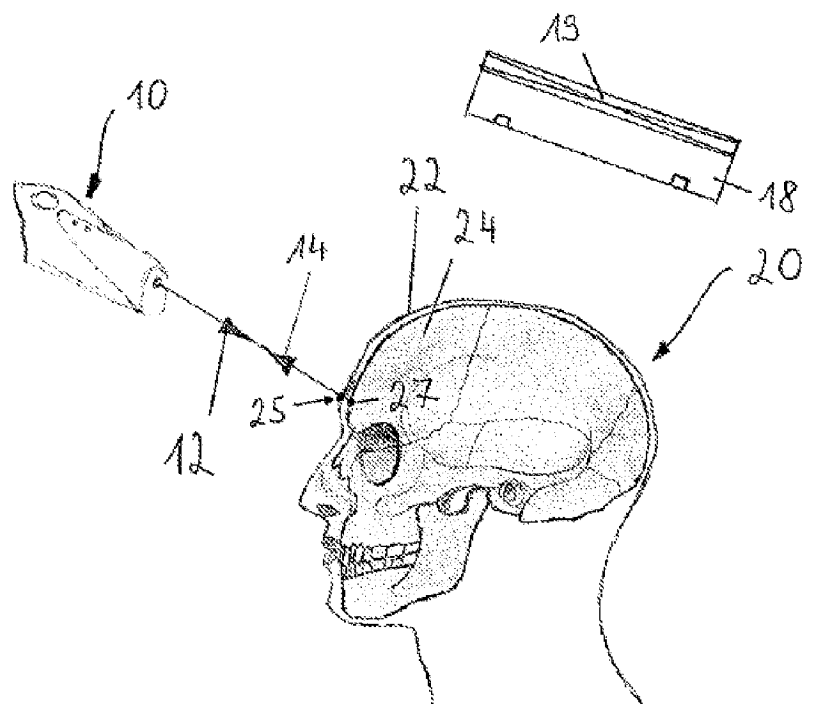


Fig. 1

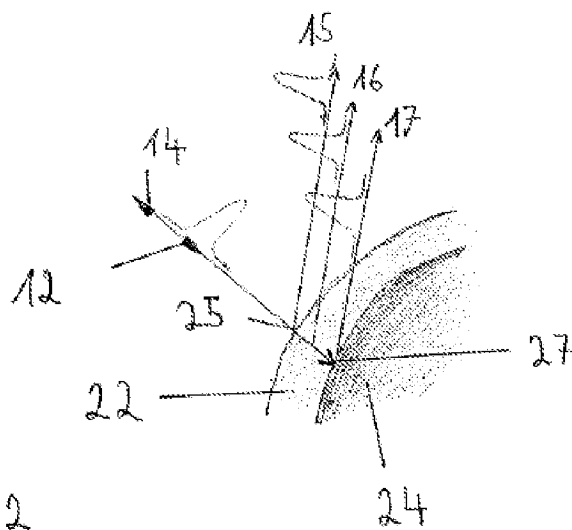


Fig. 2



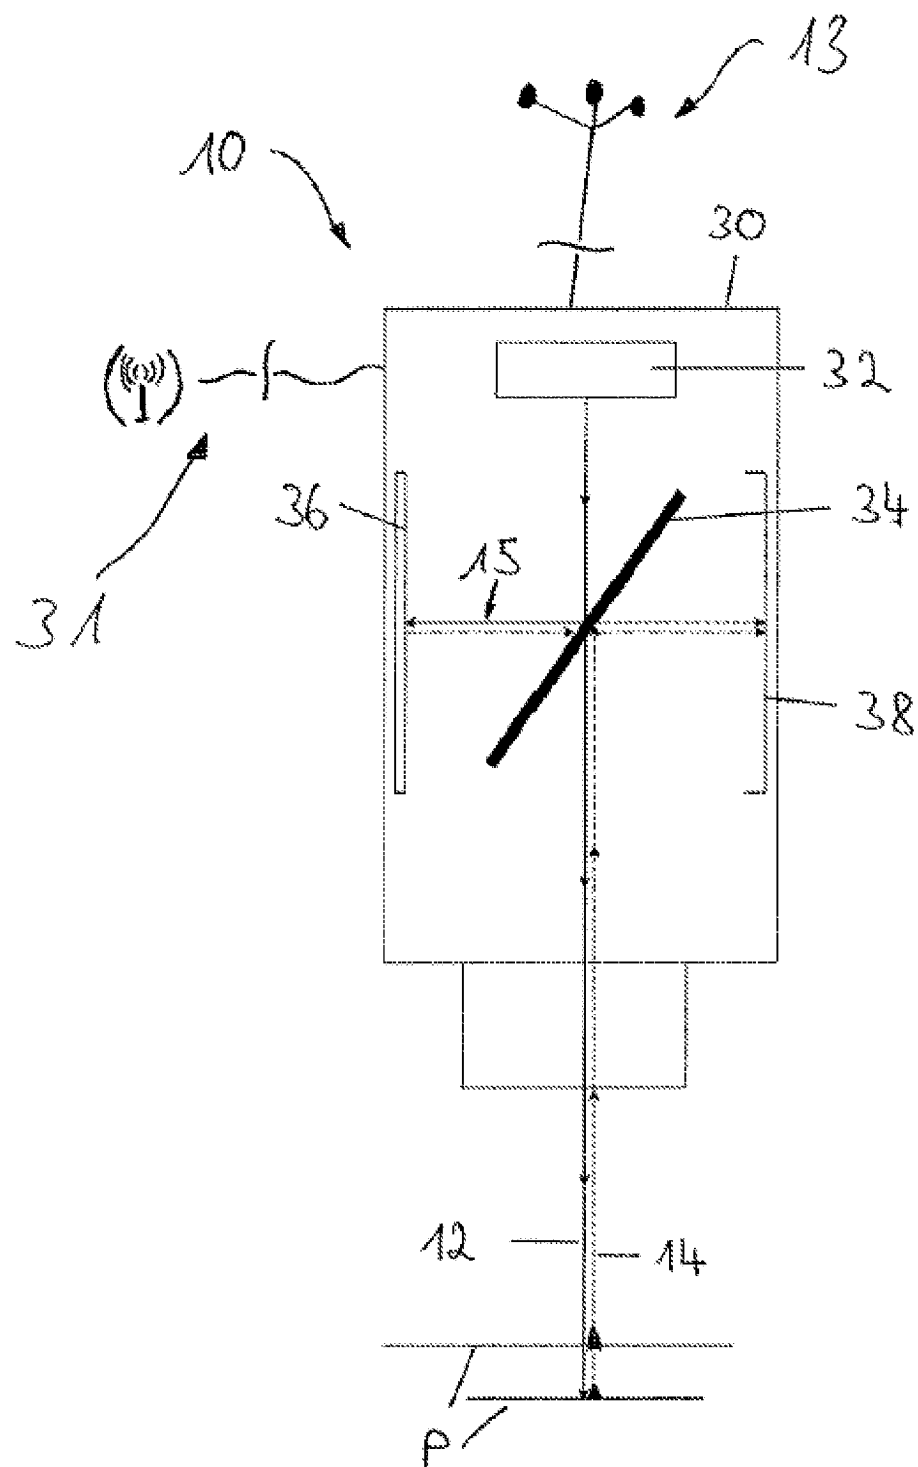


Fig. 3

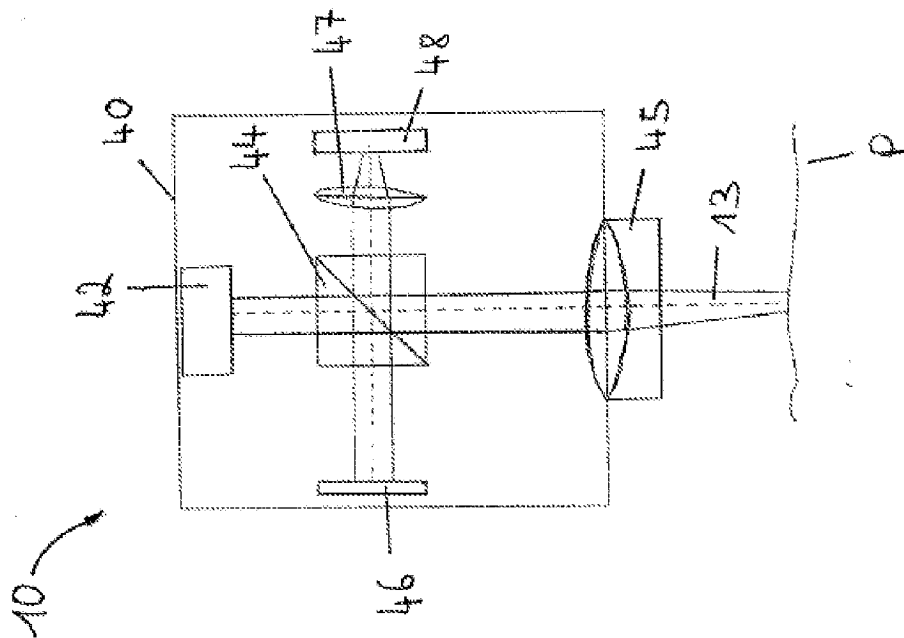

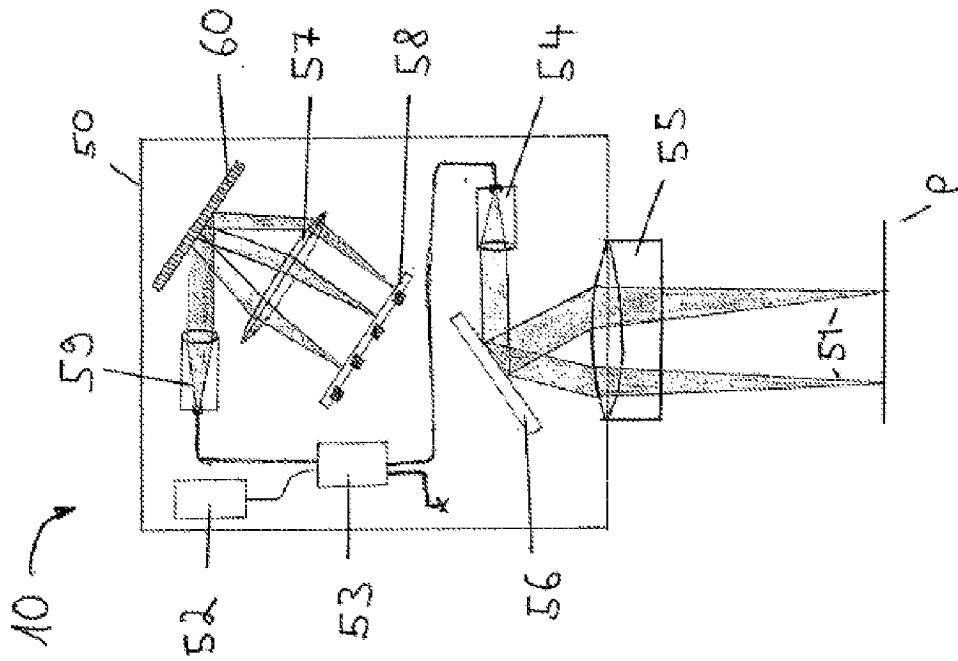

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 09 15 4437

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X,D	WO 2008/134236 A (MEDTRONIC INC [US]; CSAVOY ANDREW N [US]; SOLAR MATTHEW S [US]; WAYNIK) 6. November 2008 (2008-11-06) * Zusammenfassung * * Seite 3, Zeile 7 - Zeile 11 * * Seite 9, Zeile 7 - Seite 10, Zeile 10 * * Ansprüche 1-4 * * Abbildungen 1,2,6 * * Seite 12, Zeile 16 - Seite 14, Zeile 3 * * Seite 18, Zeile 1 - Seite 25, Zeile 23 * * Seite 36, Zeile 7 - Seite 37, Zeile 13 * -----	1-17	INV. A61B5/00 A61B5/103
A	WO 2008/036050 A (BRACCO IMAGING SPA [IT]; ZHU CHUANGGUI [SG]) 27. März 2008 (2008-03-27) * Zusammenfassung * * Absatz [0031] - Absatz [0033] * * Abbildungen 1-8 * * Ansprüche 1-3 * -----	1-17	
A	US 6 006 126 A (COSMAN ERIC R [US]) 21. Dezember 1999 (1999-12-21) * Zusammenfassung * * Spalte 3, Zeile 9 - Zeile 27 * * Spalte 13, Zeile 60 - Spalte 18, Zeile 33 * * Abbildungen 8A-8C, 9A-9C, 10A-10C * -----	1,13	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) A61B
A	US 6 167 145 A (FOLEY KEVIN T [US] ET AL) 26. Dezember 2000 (2000-12-26) * Zusammenfassung * -----	1,13	
5 Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 27. August 2009	Prüfer Tommaseo, Giovanni
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 09 15 4437

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

27-08-2009

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 2008134236 A	06-11-2008	US 2009012509 A1	08-01-2009
WO 2008036050 A	27-03-2008	US 2008123910 A1	29-05-2008
US 6006126 A	21-12-1999	US 6351661 B1	26-02-2002
		US 5662111 A	02-09-1997
US 6167145 A	26-12-2000	KEINE	

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- DE 19639861 A1 [0002]
- EP 1142536 B1 [0003]
- WO 2008134236 A1 [0004]

专利名称(译)	通过光学相干断层扫描进行医学图像配准		
公开(公告)号	EP2226003A1	公开(公告)日	2010-09-08
申请号	EP2009154437	申请日	2009-03-05
[标]申请(专利权)人(译)	博医来股份公司		
申请(专利权)人(译)	博医AG		
当前申请(专利权)人(译)	博医AG		
[标]发明人	URBAN ALEXANDER DRUSE ALEXANDER VOLLMER FRITZ		
发明人	URBAN, ALEXANDER DRUSE, ALEXANDER VOLLMER, FRITZ		
IPC分类号	A61B5/00 A61B5/103 G01B9/02		
CPC分类号	A61B5/0073 A61B5/0066 A61B5/103 G01B9/02091		
其他公开文献	EP2226003B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

该方法涉及将真实的患者身体部位 (20) 分配给身体部位的存储图像 , 其中身体部位具有刚性结构 (24) 和覆盖的软结构 (22) 。在记录身体部位的真实空间位置期间 , 通过光学相干断层摄影 (OCT) 装置 (10) 由软结构确定刚性结构上的参考点 (27) 的位置。OCT光束通过OCT装置或OCT装置的辐射单元照射在身体部分上。还包括用于医学图像配准设备的指针单元的独立权利要求。

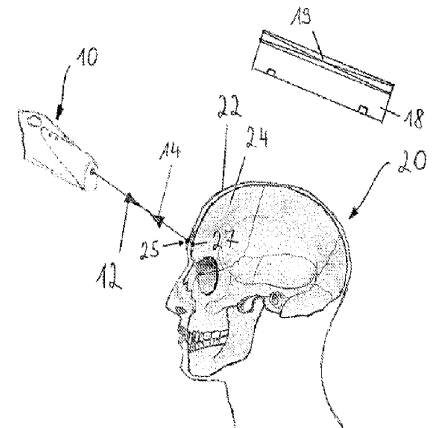


Fig. 1