



(11) **EP 2 025 285 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
**18.02.2009 Patentblatt 2009/08**

(51) Int Cl.:  
**A61B 5/00<sup>(2006.01)</sup> A61B 5/0215<sup>(2006.01)</sup>**

(21) Anmeldenummer: **08160582.6**

(22) Anmeldetag: **17.07.2008**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**AL BA MK RS**

- **Czygan, Gerald**  
**91054, Buckenhof (DE)**
- **Diebold, Michael**  
**12169, Berlin (DE)**
- **Lippert, Michael**  
**91522, Ansbach (DE)**
- **Harder, Claus**  
**91080, Uttenreuth (DE)**
- **Schmitz-Rode, Thomas**  
**52070, Aachen (DE)**

(30) Priorität: **17.08.2007 DE 102007038801**

(71) Anmelder: **BIOTRONIK CRM Patent AG**  
**6341 Baar (CH)**


(72) Erfinder:  
• **Wildau, Hans-Jürgen**  
**10717, Berlin (DE)**

(74) Vertreter: **Lindner-Vogt, Karin L.**  
**Biotronik GmbH & Co. KG**  
**Corporate Intellectual Properties**  
**Woehrmannkehe 1**  
**12359 Berlin (DE)**

(54) **Implantierbare Druckmesseinrichtung und Anordnung zur Innendruckmessung in einem Blutgefäß**

(57) Implantierbare Druckmesseinrichtung zur Innendruckmessung in einem Blutgefäß oder Herzen eines Patienten, mit einem Drucksensor mit elektrischem Signalausgang, an den vorgesehenen Messort angepassten Fixierungsmitteln zur Fixierung des Drucksensors, einer Stromversorgungseinrichtung des Drucksensors,

einer mit dem Signalausgang des Drucksensors leitungsmäßig verbundenen Signalerfassungseinrichtung und einer mit einem Messdatenausgang der Signalerfassungseinrichtung verbundenen Sendeeinrichtung, insbesondere zur drahtlosen Übertragung von Messdaten zu einer Auswertungs-einrichtung, insbesondere nach außerhalb des Patientenkörpers.

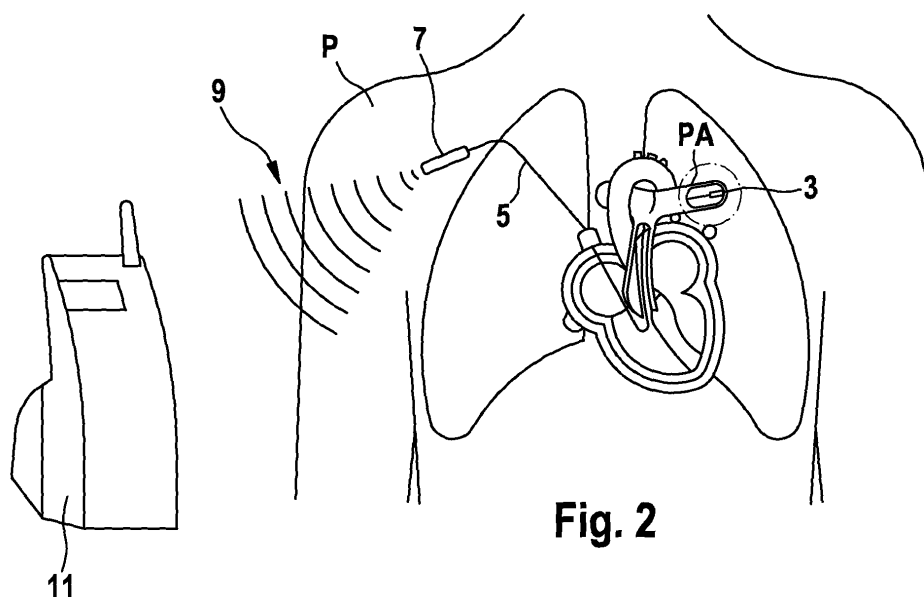

**Fig. 2**

**EP 2 025 285 A1**

## Beschreibung

**[0001]** Die Erfindung betrifft eine implantierbare Druckmeseinrichtung zur Innendruckmessung in einem Blutgefäß oder im Herzen und des weiteren eine um eine Auswertungseinheit (ein "Patientengerät") erweiterte Anordnung.

**[0002]** Die kontinuierliche Überwachung des Körperzustandes von Patienten mit chronischen Leiden ist essentiell für die Gewährleistung einer optimalen Therapie. Speziell Patienten mit Herzkrankheiten bedürfen einer Überwachung des Herz- und Kreislaufzustandes, um ihre medikamentöse Therapie zu kontrollieren und zu steuern, akute Verschlechterungen vorhersehen zu können und eine Dekompensation zu verhindern. Für Patienten mit Herzschäden sind diverse Überwachungskonzepte vorgeschlagen worden, u.a. die periodische Erfassung des Körperzustandes in der Klinik, aber auch die Überwachung mit externen Mess- bzw. Überwachungseinrichtungen, etwa zur Kontrolle des Gewichtes, des Blutdrucks, der Zeitabhängigkeit des Pulses etc. In diesem Zusammenhang werden auch seit langem "telemedizinische" Konzepte zur Fernüberwachung des Patienten in seinem normalen Lebensumfeld diskutiert.

**[0003]** In vielen Fällen sind implantierbare Messeinrichtungen gegenüber anderen Verfahren bevorzugt, weil sie die relevanten Größen direkt im Körper bestimmen und daher grundsätzlich genauer und zuverlässiger als externe Verfahren arbeiten können. Zudem können diese Messungen beim heutigen Stand der Technik weitgehend automatisiert und mit Datenfernübertragung ablaufen, ohne dass der Patient selbst oder das ihn überwachende medizinische Personal wesentlich eingreifen müssten.

**[0004]** Bei der Überwachung des hämodynamischen Zustandes von Patienten mit Herzkrankheiten stellt der Blutdruck eine der wichtigsten Größen dar, die überwacht werden sollten. Idealerweise sollte der end-diastolische Druck im linken Ventrikel (LV) oder der Druck im linken Atrium (LA) erfasst werden. Da der Zugang zur linken Seite des Herzens erheblich risikobehaftet ist, hat sich die Überwachung des Blutdrucks in der pulmonalen Arterie (PA) als hinreichend verlässliches Mittel zur Überwachung der Pumpleistung des Linksherzens etabliert. Der PA-Druck korreliert hinreichend mit dem LA-Druck, unter der Annahme, dass der Lungenzustand stabil ist.

**[0005]** Drucksensoren zur Erfassung des Innendruckes in einem Flüssigkeitsgefäß sind in großer Vielzahl bekannt und in der Technik auch im praktischen Einsatz. Viele der in der Technik üblichen Lösungen sind jedoch nicht ohne weiteres auf Messaufgaben im lebenden Organismus übertragbar, weil sie nicht kompakt genug, zu energieaufwendig im Betrieb oder zu anfällig gegenüber Beeinträchtigungen ihrer Funktion durch biologisches Material sind oder in diesem speziellen Einsatzfeld sonstige Unzulänglichkeiten zeigen.

**[0006]** Gleichwohl sind seit Jahren auch Druckmeseinrichtungen für den Einsatz im lebenden Organismus,

speziell auch in menschlichen Blutgefäßen, bekannt. Lediglich beispielhaft wird in diesem Zusammenhang hingewiesen auf die neueren Patentveröffentlichungen EP 1117982 A1, US 2002/0045921, US 6,645,143 oder US 6,743,180.

**[0007]** Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung einer verbesserten Druckmeseinrichtung mit der oben genannten Funktion sowie einer entsprechenden Messanordnung, welche insbesondere über längere Zeit genau und zuverlässig arbeiten, kostengünstig herzustellen und leicht und gefahrlos im Körper eines Patienten zum Einsatz zu bringen sind.

**[0008]** Diese Aufgabe wird durch eine Druckmeseinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und eine Anordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 22 gelöst. Zweckmäßige Fortbildungen des Erfindungsgedankens sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

**[0009]** Die Erfindung schließt den wesentlichen Gedanken ein, zur Lösung der Aufgabe der Innendruckmessung (in-vivo) in einem Blutgefäß oder ggf. auch dem Herzen einen Drucksensor mit elektrischem Signalausgang und zugehöriger Stromversorgungseinrichtung vorzusehen, dessen Signal im Körper erfasst und dann drahtlos zur weiteren Auswertung/Verwendung nach außerhalb des Körpers übertragen wird. Dem steht in einem angemessen breiten Verständnis der Erfindung indes nicht entgegen, dass die Messdaten auch innerhalb des Körpers - etwa zur Steuerung einer Körperfunktions-Unterstützungseinrichtung - genutzt werden können und in dieser Ausgestaltung keine Übertragung nach außerhalb des Körpers erfolgen muss.

**[0010]** Derzeit wird als zweckmäßig der Einsatz eines kapazitiven Drucksensors angesehen, grundsätzlich kommen aber auch nach anderen physikalischen Wirkprinzipien funktionierende, insbesondere ohne bewegliche Teile auskommende Drucksensoren in Betracht, so etwa piezoelektrische oder piezoresistive Sensoren.

**[0011]** Ein wesentlicher Akzent der Erfindung liegt im Vorsehen an den vorgesehenen Messort angepasster Fixierungsmittel zur Fixierung des Drucksensors. Als solches Fixierungsmittel kommt ein mit einem Drucksensorkörper verbundenes expandierbares Gefäßwandimplantat (Stent) in Betracht. Derartige Stents sind seit längerem in zahlreichen Ausführungen bekannt und auf dem Markt, so dass ohne weiteres auf kommerziell verfügbare Fixierungsmittel mit geeignetem Aufbau und passender Geometrie zurückgegriffen werden kann. Bei der Auswahl spielt der grundsätzliche Einsatzort - etwa die pulmonale Arterie - eine bestimmende Rolle, es ist aber natürlich auch die individuelle Anatomie des einzelnen Patienten zu berücksichtigen.

**[0012]** Dies gilt selbstverständlich auch für weitere mögliche Ausführungen der Fixierungsmittel, etwa als elastisch absteigende oder abspreizbare Gefäßwandstützen, beispielsweise in Form eines "Dreibeines" aus Silikon. Es gilt in gleichem Maße für eine Ausbildung als Stützspirale oder -helix oder dergleichen Fixierungsmittel, welche sich durch elastisch deformierbare Bogenab-

schnitte auszeichnen, die eine problemlose Implantation ermöglichen und sich im eingesetzten Zustand der Druckmesseinrichtung an die entsprechende Gefäßwand anlegen sollen.

**[0013]** Erwähnenswert sind auch Fixierungsmittel im weiteren Sinne, welche die Positionierung des Drucksensors in geeigneter Lagebeziehung zur Wandung des Blutgefäßes (oder Herzens) ohne Wandkontakt bewerkstelligen können, etwa eine strömungsgünstige Ausföhrung des Drucksensorkörpers oder Strömungsleitmittel an diesem, die seine dynamische Positionierung in einem Blutstrom bewirken. In Betracht kommen im übrigen auch ballonartige Fixierungsmittel, welche den Effekt einer dynamischen strömungsgeführten Fixierung mit demjenigen einer wandständigen Fixierung verknüpfen.

**[0014]** Um, speziell mit wandständig wirkenden Fixierungsmitteln, den Drucksensor einerseits während seines Einsatzes in geeigneter Position und stabil im Blutgefäß positionieren und ihn andererseits nach Beendigung der Messaufgabe wieder leicht entfernen zu können, ist bevorzugt eine lösbare Verbindung zwischen dem Drucksensorkörper und den Fixierungsmitteln vorgesehen. Diese sichert, dass der Drucksensor ohne Verletzung der Gefäßwand (an der die Fixierungsmittel dann verbleiben) explantiert werden kann. Alternativ kann auch vorgesehen werden, dass der Drucksensor so mit den Fixierungsmitteln fest verbunden ist, dass er zusammen mit den Fixierungsmitteln verletzungsfrei explantiert werden kann, indem die Fixierungsmittel leicht von der Wand, also vom Gewebe, gelöst werden können. Die Fixierungsmittel können als rückziehbare oder ausschraubbare aktive Fixierungsmittel ausgebildet sein oder aber alternativ als vom Drucksensorkörper abstehende passive Fixierungsmittel, die angeklappt werden können, geformt sein.

**[0015]** In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass die Signalerfassungseinrichtung ein separates Gehäuse aufweist, das zur Implantation entfernt vom Drucksensor, außerhalb des Blutgefäßes oder Herzens, ausgebildet ist. Das separate Gehäuse kann etwa im Brustkorb des Patienten angeordnet sein. In weiterer Ausgestaltung nimmt es neben der Signalerfassungseinrichtung die Stromversorgungseinrichtung des Drucksensors auf, und es ist eine Stromversorgungs-Leitungsverbindung zwischen der Stromversorgungseinrichtung und dem Drucksensor vorgesehen. Weiter bevorzugt ist in dem Gehäuse der Signalerfassungseinrichtung zusätzlich eine Steuereinrichtung zur Steuerung der Sensor- und Sendefunktion und optional der Stromversorgung vorgesehen. Es ist schließlich besonders sinnvoll, wenn es sich bei dem Gehäuse um das Gehäuse eines implantierbaren Therapiegerätes, insbesondere Herzstimulationsgerätes, handelt. Speziell wenn die Druckmesseinrichtung im Zusammenhang mit der Funktion eines solchen Therapiegerätes benötigt wird, verringert sich dadurch erheblich der Herstellungs- und Implantationsaufwand.

**[0016]** Eine hierzu alternative Ausführung sieht vor,

dass die Stromversorgungseinrichtung, Signalerfassungseinrichtung, Sendeeinrichtung und eine Steuereinrichtung zur Steuerung der Sensor- und Telemetriefunktion und optional der Stromversorgung in einem Drucksensorkörper aufgenommen sind. Es versteht sich, dass dann einer Miniaturisierung der besagten Funktionseinheiten besonderes Augenmerk zu schenken ist, um die in diesem Sinne integrierte Druckmesseinrichtung insgesamt kompakt gestalten zu können.

**[0017]** In einer weiteren Ausführung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Signalerfassungseinrichtung eine Vorverarbeitungseinrichtung und ein Messwert-Pufferspeicher zur Messwert-Vorverarbeitung und internen Zwischenspeicherung nachgeschaltet sind. Dies kann sowohl bei der integrierten Ausführung der Messeinrichtung als auch bei der Ausführung sinnvoll sein, in der der eigentliche Drucksensor und die übrigen Komponenten baulich nicht integriert sind. Es trägt speziell zu einer Reduzierung des Datenübertragungsaufwandes zwischen dem Körper des Patienten und einer externen Auswertungseinheit bei, da die Datensammlung und -vorverarbeitung, insbesondere eine Mittelwertbildung über bestimmte Messperioden, intrakorporal erfolgen kann.

**[0018]** In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Drucksensor und optional die Fixierungsmittel eine endotheliasierungs- bzw. thrombose-hemmende Beschichtung aufweisen. Obgleich sich die vorgeschlagene Messeinrichtung durch eine vergleichsweise große Unempfindlichkeit gegenüber Ablagerungen von biologischem Material auszeichnet, wenn ein Drucksensor ohne bewegte Teile zum Einsatz kommt, vermögen diese letztlich, wenn sie ein bestimmtes Maß übersteigen, auch bei der vorgeschlagenen Einrichtung die Funktion zu beeinträchtigen. Daher ist eine geeignete Beschichtung oder Einkapselung des gesamten Drucksensorkörpers oder jedenfalls der messsignal-aufnehmenden Abschnitte zur Verhinderung von Ablagerungen oder zu Verhinderung zur Bildung von Thrombosen von Wert für einen Langzeitbetrieb mit hoher Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit beziehungsweise für eine Verhinderung des Ablöses von Thromben.

**[0019]** Unter dem Gesichtspunkt einer effizienten, kostengünstigen Stromversorgung der Druckmesseinrichtung ist bevorzugt, dass die Stromversorgungseinrichtung ein Primär- oder Sekundärelement aufweist. Mit Blick auf die weite Verbreitung von Li-Ionen-Elementen bei Schrittmachern oder anderen implantierbaren Therapiegeräten erscheint die Wahl einer solchen Stromversorgung auch bei der vorgeschlagenen Druckmesseinrichtung als zweckmäßig. In Kombination hiermit, aber auch unabhängig hiervon, kann die Stromversorgung eine Energie-Empfangseinrichtung zur drahtlosen Energiezufuhr von außerhalb des Körpers, insbesondere zum drahtlosen Aufladen eines Sekundärelementes, aufweisen. Es kann sich hierbei etwa um eine induktive Einrichtung handeln, wie sie bei Körperpflegegeräten üblich und kostengünstig kommerziell erhältlich ist.

**[0020]** In einer weiteren Ausgestaltung umfasst die

Druckmesseinrichtung mindestens einen zweiten Sensor zur Messung einer zusätzlichen Größe im Körper des Patienten. Hierbei kann als zweiter Sensor ein weiterer Drucksensor in Prandtl-Rohr-Anordnung mit dem ersten Drucksensor zur Gewinnung eines Strömungsgeschwindigkeitssignals vorgesehen sein. Alternativ oder auch in Kombination hiermit kann auch ein Temperatursensor zur Bestimmung der Bluttemperatur und/oder zur Temperatur-Kompensation des Druckmesssignals vorgesehen sein. Durch das Vorsehen zusätzlicher Sensoren lässt sich also einerseits ein Beitrag zur Erweiterung des Messgrößenspektrums und andererseits ein Beitrag zur Erhöhung der Aussagekraft der Ergebnisse der Druckmessung leisten. Mit den hier beispielhaft genannten Varianten sind die Möglichkeiten einer solchen Mehr-SensorEinrichtung hierbei keineswegs ausgeschöpft.

**[0021]** Die im Rahmen der Erfindung vorgeschlagene Gesamtanordnung umfasst neben der Druckmesseinrichtung eine zur extrakorporalen Platzierung ausgebildete Auswertungseinheit, welche eine externe Telemetrieeinheit zur Messdaten- und optional auch Steuersignalverbindung mit der Sendeeinrichtung der Druckmesseinrichtung aufweist. Diese enthält bevorzugt einen atmosphären Drucksensor und eine Druck-Kompensationseinrichtung zur Berechnung eines atmosphären-druck-korrigierten Innendruckwertes. Zusätzlich oder alternativ hierzu kann vorgesehen sein, dass eine mit dem Drucksensor und einem Temperatursensor der implantierten Druckmesseinrichtung verbundene Temperatur-Kompensationseinrichtung zur Berechnung eines bluttemperatur-kompensierten Innendruckwertes vorgesehen ist.

**[0022]** Neben diesen Ausgestaltungen, die die Bereitstellung eines aussagekräftigeren Ergebnisses der Druckmessung zum Ziel haben, kann die Auswertungseinheit auch eine mit dem Drucksensor und/oder weiteren Sensor der implantierbaren Druckmesseinrichtung verbundene Sekundärgrößen-Auswertungseinrichtung aufweisen. Entsprechende Sekundärgrößen können von erheblichem Wert für die Ableitung therapeutischer Maßnahmen aus den Ergebnissen der Innendruckmessung sein. In diesem Sinne kann etwa die Sekundärgrößen-Auswertungseinrichtung zur Bestimmung des Schlagvolumens und/oder der Auswurfleistung des rechten Ventrikels durch Impulsformanalyse des Druckmesssignals der Druckmesseinrichtung ausgebildet sein.

**[0023]** Vorteile und Zweckmäßigkeiten der Erfindung ergeben sich im übrigen aus der nachfolgenden - teils nur skizzenhaften - Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele anhand der Figuren. Von diesen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Messanordnung,

Fig. 2 eine weitere Darstellung der Messanordnung, in ihrer Anordnung im/zum Körper eines Pa-

tienten,

Fig. 2A eine Detaildarstellung der Anordnung des Drucksensors in einem Blutgefäß des Patienten und

Fig. 3 eine Prinzipskizze eines Zwei-Sensoren-Messkopfes.

**[0024]** Fig. 1 zeigt skizzenartig eine Messanordnung 1 zur Innendruckmessung in einem Blutgefäß eines Patienten, deren Hauptbestandteile ein Druckmesskopf 3, eine mit diesem über eine Leitung 5 verbundene implantierbare Einheit 7 und eine mit dieser über eine Telemetriestrecke 9 verbundene extrakorporale Auswertungseinheit (Patientengerät) 11 sind.

**[0025]** Der Messkopf 3 umfasst einen Drucksensorkörper 13 mit einer biokompatiblen und thrombose-hemmenden Verkapselung 15, in dem ein kapazitiver Drucksensor 17 und eine Schnittstelleneinrichtung 19 aufgenommen sind. Der Drucksensorkörper 13 ist über Verbindungsmittel 21 lösbar mit einem an die Innenabmessungen der pulmonalen Arterie eines Patienten angepassten Stent 23 verbunden (der hier im bereits expandierten Zustand dargestellt ist).

**[0026]** Die implantierbare Einheit 7 hat ebenso wie der Drucksensorkörper 13 eine biokompatible Hülle 25 und enthält einen Leitungsverbinder 27, eine Hochleistungsbatterie 29 als Stromversorgungseinrichtung des Drucksensors 17, eine Signalerfassungseinrichtung 31, eine Signal-Vorverarbeitungseinrichtung 33, einen Pufferspeicher 35, eine HF-Sende-/Empfangseinrichtung 37 als implantierbare Telemetrieeinheit der Telemetriestrecke 9 und eine zugehörige Antenne 39. Zur Steuerung der Funktionen der implantierbaren Einheit 7 ist schließlich ein Controller 41 vorgesehen.

**[0027]** Das Patientengerät 11 beinhaltet (unter anderem) eine externe HF-Sende-/Empfangseinrichtung 43 mit zugehöriger Antenne 45, einen Controller 47 und eine Bedien- und Anzeigetafel 49. Sie umfasst des weiteren eine eigene Stromversorgung 51 und schließlich eine Druckberechnungsstufe 53, der eine Kompensations-Verarbeitungsstufe 55 zugeordnet ist, die das Signal eines angeschlossenen Atmosphärendruckfühlers 57 zur Luftdruck-Kompensation des Gefäßinnendruck-Messsignals verarbeitet, aber auch weitere Kompensations-Verfahrensprozeduren (etwa zur T-Kompensation aufgrund des Signals eines im Messkopf vorgesehenen zusätzlichen T-Sensors) ausführen kann.

**[0028]** Fig. 2 und 2A zeigen die Anordnung der Komponenten der Messanordnung 1 in Bezug auf den Körper eines Patienten P. Neben der extrakorporalen Platzierung des Patientengerätes 11 ist die Platzierung der implantierbaren Einheit 7 im Brustkorb, unterhalb des Schlüsselbeines, und die Platzierung des Messkopfes 3 in der pulmonalen Arterie PA zu erkennen. Fig. 2A zeigt auch die Abstützung des Messkopfes 3 im Zentrum der pulmonalen Arterie mittels des Stents 23.

**[0029]** In Fig. 3 ist eine modifizierte Ausführung 3' des Messkopfes in dem in die pulmonale Arterie eingesetzten Zustand zu erkennen. Die Pfeile bezeichnen hier die Richtung eines Blutstromes B. Der Messkopf 3' zeichnet sich durch das Vorhandensein zweier Drucksensoren 17.1, 17.2 in räumlicher Anordnung in Art eines Prandtl'schen Staurohres zur kombinierten Messung des Druckes und der Strömungsgeschwindigkeit des Blutstroms B aus.

**[0030]** Des Weiteren enthält der Messkopf 3' einen T-Sensor 18 zur gleichzeitigen Erfassung der Bluttemperatur, dessen Signal zur Ermittlung eines genaueren, nämlich T-kompensierten Innendruckwertes genutzt werden kann; vgl. die obige Beschreibung der Messanordnung 1 hinsichtlich des Patientengerätes 11. Schließlich ist in dieser Figur eine modifizierte Ausführung der Fixierungsmittel zur Positionierung des Messkopfes 3' im Zentrum der pulmonalen Arterie PA gezeigt, welche eine Mehrzahl von elastisch andrück- bzw. aufspreizbaren Gefäßwandstützen 24 umfasst. Diese können etwa aus einem Silikon gefertigt und ggf. an eine (hier nicht dargestellte) Silikon-Umhüllung des Messkopfes 3' angeformt sein.

**[0031]** Die Ausführung der Erfindung ist nicht auf die hier erläuterten Beispiele und hervorgehobenen Aspekte beschränkt, sondern ebenso in einer Vielzahl von Abwandlungen möglich, die im Rahmen fachgemäßen Handelns liegen.

#### Patentansprüche

1. Implantierbare Druckmesseinrichtung (3, 7; 3') zur Innendruckmessung in einem Blutgefäß (PA) oder Herzen eines Patienten (P), mit
  - einem Drucksensor (17; 17.1, 17.2) mit elektrischem Signalausgang,
  - an den vorgesehenen Messort angepassten Fixierungsmitteln (23; 24) zur Fixierung des Drucksensors,
  - einer Stromversorgungseinrichtung (29) des Drucksensors,
  - einer mit dem Signalausgang des Drucksensors leitungsmäßig verbundenen Signalerfassungseinrichtung (31) und
  - einer mit einem Messdatenausgang der Signalerfassungseinrichtung verbundenen Sendeeinrichtung (37), insbesondere zur drahtlosen Übertragung von Messdaten zu einer Auswertungseinrichtung (11), insbesondere nach außerhalb des Patientenkörpers.
2. Druckmesseinrichtung nach Anspruch 1, wobei die Fixierungsmittel an einem Drucksensorkörper angeordnete Strömungsleitmittel zur blutstrom-induzierten dynamischen Zentrierung des Drucksensors in dem Blutgefäß oder Herzen umfas-

sen oder der Drucksensorkörper zum Bewirken einer blutstrom-induzierten Zentrierung strömungsgünstig gestaltet ist.

3. Druckmesseinrichtung nach Anspruch 1, wobei die Fixierungsmittel von einem Drucksensorkörper (13) elastisch abstehende oder abspreizbare Gefäßwandstützen (24), eine Stützspirale oder -helix oder dergleichen oder einen Gefäßwandanker zum Einbringen in eine Wandung des Blutgefäßes oder Herzens, insbesondere an einem Verzweigungsabschnitt, aufweisen.
4. Druckmesseinrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Fixierungsmittel (23, 24) zur Fixierung des Drucksensors in einer pulmonalen Arterie (PA) dimensioniert sind.
5. Druckmesseinrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Drucksensor (17) mit den Fixierungsmitteln (23) lösbar (21) verbunden ist derart, dass er unter Verbleiben der Fixierungsmittel in dem Blutgefäß aus diesem herausgezogen werden kann.
6. Druckmesseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Drucksensor (17) mit den Fixierungsmitteln (23) fest verbunden ist derart, dass er zusammen mit den Fixierungsmitteln verletzungsarm explantiert werden kann, indem die Fixierungsmittel leicht von der Wand, also vom Gewebe, gelöst werden können.
7. Druckmesseinrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Signalerfassungseinrichtung (31) ein separates Gehäuse (7) aufweist, das zur Implantation entfernt vom Drucksensor, außerhalb des Blutgefäßes (PA) oder Herzens, ausgebildet ist.
8. Druckmesseinrichtung nach Anspruch 7, wobei das Gehäuse (7) der Signalerfassungseinrichtung (31) die Stromversorgungseinrichtung (29) des Drucksensors (17; 17.1, 17.2) aufnimmt und eine Stromversorgungs-Leitungsverbindung (5) zwischen der Stromversorgungseinrichtung und dem Drucksensor vorgesehen ist.
9. Druckmesseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Stromversorgungseinrichtung, Signalerfassungseinrichtung, Sendeeinrichtung und eine Steuereinrichtung zur Steuerung der Sensor- und Telemetriefunktion und optional der Stromversorgung in einem Drucksensorkörper aufgenommen sind.

10. Druckmesseinrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche,  
wobei die Stromversorgungseinrichtung (29) ein Primär- oder Sekundärelement aufweist. 5
11. Druckmesseinrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche,  
mit einem zweiten Sensor (17.2) zur Messung einer zusätzlichen Größe im Körper des Patienten. 10
12. Anordnung (1) zur Innendruckmessung in einem Blutgefäß (PA) oder Herzen eines Patienten (P), mit einer implantierbaren Druckmesseinrichtung (3, 7; 3') nach einem der vorangehenden Ansprüche und einer zur extrakorporalen Platzierung ausgebildeten Auswertungseinheit (11), welche eine externe Telemetrieinheit (43) zur Messdaten- und optional auch Steuersignalverbindung mit der Sendeeinrichtung (37) der Druckmesseinrichtung aufweist. 15  
20
13. Anordnung nach Anspruch 12,  
wobei die Auswertungseinheit (11) einen atmosphären Drucksensor (57) und eine Druck-Kompensationseinrichtung (55) zur Berechnung eines atmosphärendruck-korrigierten Innendruckwertes aufweist. 25
14. Anordnung nach Anspruch 12 oder 13,  
wobei die Auswertungseinheit (11) eine mit dem Drucksensor (17; 17.1, 17.2) und einem Temperatursensor (18) der implantierten Druckmesseinrichtung (3, 7; 3') verbundene Temperatur-Kompensationseinrichtung (55) zur Berechnung eines bluttemperatur-kompensierten Innendruckwertes aufweist. 30  
35
15. Anordnung nach einem der Ansprüche 12 bis 14,  
wobei die Auswertungseinheit (11) eine mit dem Drucksensor (17; 17.1) und/oder weiteren Sensor (17.2; 18) der implantierbaren Druckmesseinrichtung verbundene Sekundärgrößen-Auswertungseinrichtung aufweist. 40  
45  
50  
55


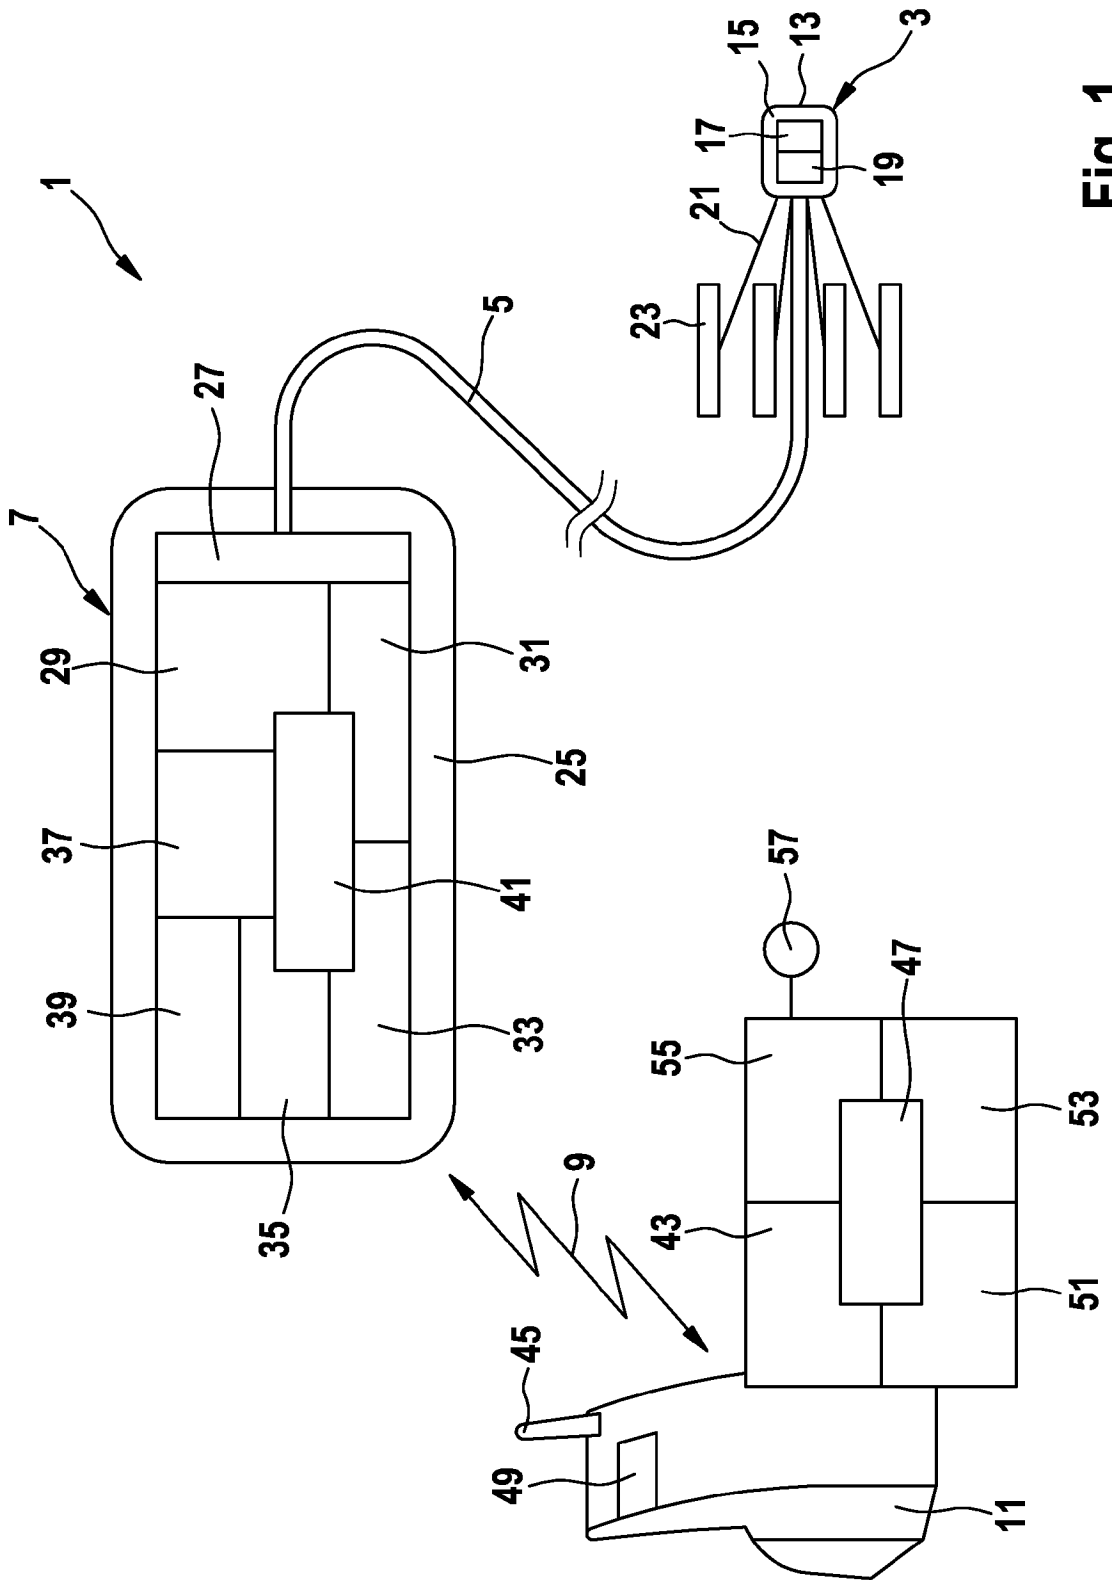


Fig. 1



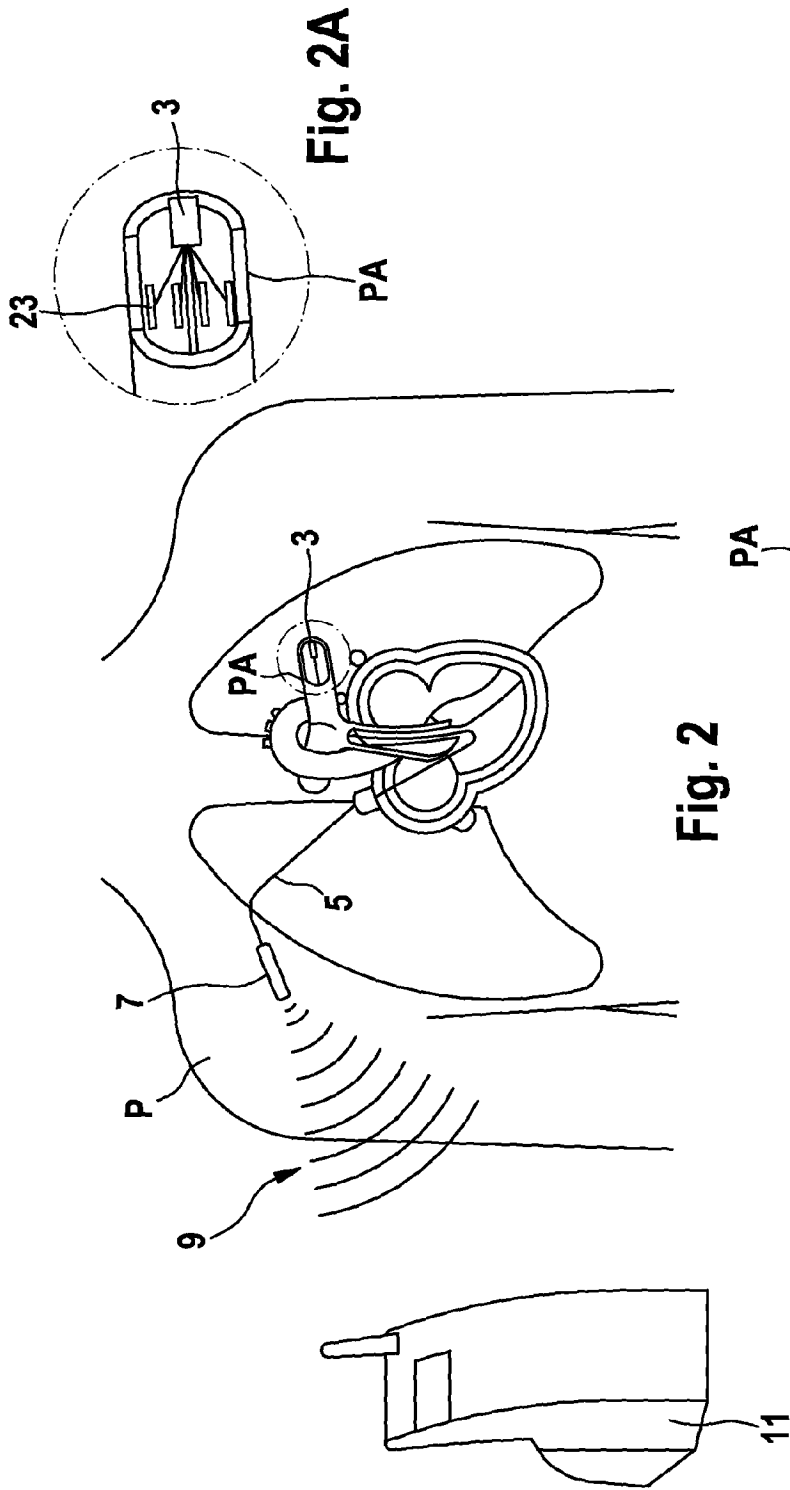

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 08 16 0582

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	US 2007/088221 A1 (STAHMANN JEFFREY E [US]) 19. April 2007 (2007-04-19)	1,3-5, 7-15	INV. A61B5/00
Y	* Abbildungen 1,4,14,17,18,22-25 * * Absätze [0042], [0043], [0052], [0057], [0058], [0080], [0081], [0099], [0101] - [0106] *	2,6	A61B5/0215
X	US 2006/064142 A1 (CHAVAN ABHI [US] ET AL) 23. März 2006 (2006-03-23)	1,7, 11-15	
	* Absätze [0026], [0027], [0034], [0037] - [0040], [0043], [0044], [0050] - [0053] *		
X	WO 2007/022620 A (SCISENSE INC [CA]; PLOUF PETER [CA]; POETSCHKE BLAIR [CA]; PLACKO MILA) 1. März 2007 (2007-03-01)	1,7,8, 11,12,14	
	* Absätze [0024] - [0026], [0032] - [0034], [0040] - [0042], [0047], [0048]; Abbildungen 1-3,6 *		
Y	US 5 873 835 A (HASTINGS ROGER N [US] ET AL) 23. Februar 1999 (1999-02-23)	2	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) A61B
	* Spalte 1, Zeilen 16-22 * * Spalte 17, Zeilen 6-16 *		
Y	EP 1 488 735 A (MOSER RAYMOND [CH]) 22. Dezember 2004 (2004-12-22)	6	
	* Absätze [0009] - [0024], [0031], [0032]; Abbildungen 1,2a-2d,4a-4b,5-12 *		
3 Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort Berlin		Abschlußdatum der Recherche 2. Dezember 2008	Prüfer Kronberger, Raphael
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 08 16 0582

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

02-12-2008

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2007088221 A1	19-04-2007	EP 1933699 A2 WO 2007047287 A2	25-06-2008 26-04-2007
US 2006064142 A1	23-03-2006	EP 1817076 A1 JP 2008513143 T US 2006064133 A1 US 2006064143 A1 WO 2006034183 A1	15-08-2007 01-05-2008 23-03-2006 23-03-2006 30-03-2006
WO 2007022620 A	01-03-2007	CA 2619986 A1 EP 1919355 A2 US 2007043298 A1	01-03-2007 14-05-2008 22-02-2007
US 5873835 A	23-02-1999	KEINE	
EP 1488735 A	22-12-2004	AT 364348 T DE 60314379 T2 WO 2004110263 A1 US 2006100531 A1	15-07-2007 26-06-2008 23-12-2004 11-05-2006

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE**

*Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.*

**In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente**

- EP 1117982 A1 [0006]
- US 20020045921 A [0006]
- US 6645143 B [0006]
- US 6743180 B [0006]

专利名称(译)	可植入的压力测量装置和用于测量血管内部压力的组件		
公开(公告)号	<a href="#">EP2025285A1</a>	公开(公告)日	2009-02-18
申请号	EP2008160582	申请日	2008-07-17
[标]申请(专利权)人(译)	百多力CRM专利公司		
申请(专利权)人(译)	BIOTRONIK CRM专利AG		
当前申请(专利权)人(译)	BIOTRONIK CRM专利AG		
[标]发明人	WILDAU HANS JURGEN CZYGAN GERALD DIEBOLD MICHAEL LIPPERT MICHAEL HARDER CLAUS SCHMITZ RODE THOMAS		
发明人	WILDAU, HANS-JÜRGEN CZYGAN, GERALD DIEBOLD, MICHAEL LIPPERT, MICHAEL HARDER, CLAUS SCHMITZ-RODE, THOMAS		
IPC分类号	A61B5/00 A61B5/0215		
CPC分类号	A61B5/0215 A61B5/0031 A61B5/02156 A61B5/02158 A61B5/6862 A61B5/6876 A61B5/6882 A61B2560/0219 A61B2560/0252 A61B2560/0257		
优先权	102007038801 2007-08-17 DE		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

该装置具有带有电信号输出的压力传感器 ( 17 ) , 以及在所提供的测量点处对准的固定单元 ( 23 ) , 用于固定包括电流供应装置 ( 29 ) 的压力传感器。信号检测装置 ( 31 ) 以适度导电的方式与压力传感器的信号输出连接。发射器 ( 37 ) 与信号检测装置的测量数据输出端连接, 用于将测量数据无线传输到评估装置 ( 11 ) , 特别是在患者体外。还包括用于使用可植入压力测量装置测量患者的血管或心脏内的压力的装置的独立权利要求。

