



(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
16.10.2019 Patentblatt 2019/42

(51) Int Cl.:
G01R 33/54 (2006.01) **G01R 33/565** (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01) **G05B 13/02** (2006.01)
A61B 5/055 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **18167310.4**

(22) Anmeldetag: **13.04.2018**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME
Benannte Validierungsstaaten:
KH MA MD TN

(72) Erfinder:
• **Speier, Peter**
91056 Erlangen (DE)
• **Zeller, Mario**
91054 Erlangen (DE)

Bemerkungen:
Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.


(71) Anmelder: **Siemens Healthcare GmbH**
91052 Erlangen (DE)

(54) **MAGNETRESONANZ-PULSSEQUENZEINSTELLUNG ANHAND BEWEGUNGSVORHERSAGE**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einstellung einer Pulssequenz einer Magnetresonanz- (MR) Untersuchung eines Patienten, eine MR-Vorrichtung (10) und ein Computerprogrammprodukt. Das Verfahren umfasst folgende Schritte: Es wird ein Untersuchungs-Bewegungssignal erfasst, das abhängig von der Bewegung des Patienten ist. Anhand des Untersu-

chungs-Bewegungssignals und einer Bestimmungsinformation wird eine Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation bestimmt. Die Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation umfasst eine Wahrscheinlichkeitsangabe zukünftiger Bewegung des Patienten. Anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation wird die Pulssequenz eingestellt.

FIG 1

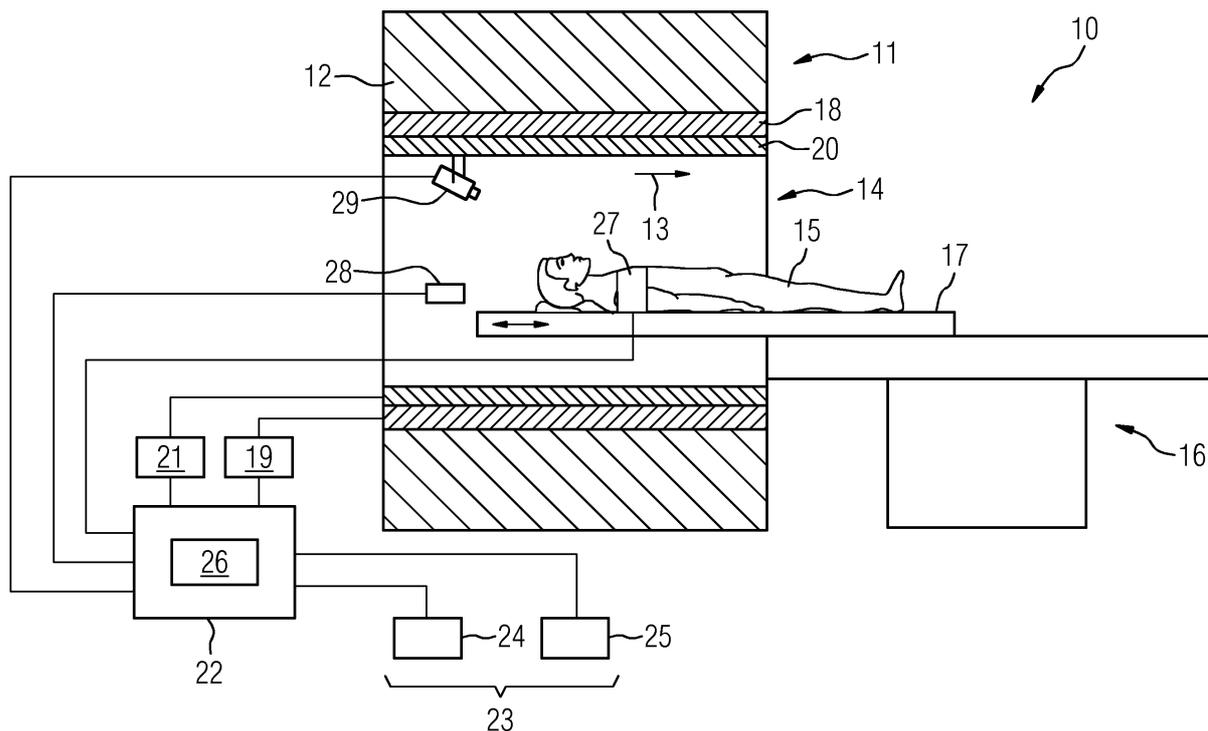

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einstellung einer Pulssequenz einer MR-Untersuchung, eine MR-Vorrichtung und ein Computerprogrammprodukt.

[0002] In der Medizintechnik zeichnet sich die Bildgebung mittels Magnetresonanz (MR), auch Magnetresonanztomographie (MRT, engl. Magnetic Resonance Imaging, MRI) genannt, durch hohe und variable Weichteilkontraste aus. Hierbei werden mit Hilfe einer MR-Vorrichtung Anregungspulse einer Pulssequenz in einen Patienten eingestrahlt, welche im Patienten MR-Signale auslösen. Die MR-Signale werden üblicherweise durch MR-Spulen empfangen und an eine Auswerteeinheit weitergeleitet, um aus den MR-Signalen eine MR-Abbildung des Patienten zu erzeugen.

[0003] Bewegt sich der Patient bei der Aufnahme der MR-Signale, so kann dies die Qualität der MR-Abbildung negativ beeinflussen. Eine Patientenbewegung kann also die Diagnostik einschränken oder sogar gänzlich unmöglich machen. Unter Umständen kann eine Neuaufnahme der MR-Signale erforderlich sein.

[0004] Für dieses Problem existiert eine Vielzahl an Herangehensweisen. Dazu zählen insbesondere Korrekturmethode, welche z.B. auf Navigatoren (siehe z.B. DE 102006055933 B4), externen Sensoren wie Kameras (siehe z.B. US 9714998 B2), Magnetfeldsonden (engl. magnetic field probes) oder Pilotton-Aufnahmen (engl. pilot tone) (siehe z.B. DE 102015203385 B4) basieren.

[0005] Weiterhin existieren Verfahren, bei denen Aufnahmen nur in bestimmten Atem- bzw. EKG-Zuständen (siehe z.B. US 20110130644 A1) durchgeführt werden. Die Festlegung der Aufnahmezeitpunkte geschieht dabei beispielsweise mittels externer Sensoren oder Navigatoren. Bei einem Navigator werden üblicherweise verschachtelt mit der eigentlichen Bildaufnahme Navigatordaten aus dem MR-Signal extrahiert (z.B. eine niedrig aufgelöste Darstellung des Kopfes).

[0006] Zusätzlich werden oftmals Verfahren verwendet, die inhärent robust gegenüber Bewegungen sind (beispielsweise radiale, insbesondere PROPELLER-Bildgebungs-Sequenzen) und/oder eine möglichst kurze Messzeit aufweisen und/oder mehrere Mittelungen umfassen, um den Einfluss von Bewegung zu reduzieren.

[0007] KÜSTNER, Thomas et al. Automated reference-free detection of motion artifact in magnetic resonance images. In: Magn Reson Mater Phys, 2017. DOI 10.1007/s10334-017-0650-z, beschreibt ein bildbasiertes Deep-Learning-Verfahren, welches ermöglicht, retrospektiv aufgenommene Bilder hinsichtlich der aufgetretenen Bewegung zu beurteilen. Da das Verfahren jedoch bildbasiert arbeitet, steht das Ergebnis erst nach erfolgter Aufnahme fest, wodurch das Problem von Neuaufnahmen nicht vermieden wird.

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, eine Pulssequenz so einzustellen, dass etwaige daraus resultierende MR-Abbildungen eine höhere Qualität aufweisen. Idealerweise sollen dadurch Neuaufnahmen

vermieden werden.

[0009] Die Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den abhängigen Ansprüchen beschrieben.

[0010] Demnach wird ein Verfahren zur Einstellung einer Pulssequenz einer MR-Untersuchung eines Patienten mit folgenden Schritten vorgeschlagen: Es wird ein Untersuchungs-Bewegungssignal erfasst, das abhängig von der Bewegung des Patienten ist. Anhand des Untersuchungs-Bewegungssignals und einer Bestimmungsinformation wird eine Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation, insbesondere eine Maßzahl, bestimmt. Die Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation umfasst eine Wahrscheinlichkeitsangabe, insbesondere eine Vorhersage, zukünftiger Bewegung des Patienten. Unter einer zukünftigen Bewegung ist vorzugsweise eine Bewegung im weiteren Verlauf der MR-Untersuchung (z.B. innerhalb der folgenden 5 bis 50 Minuten), insbesondere während einer Erfassung von MR-Signalen, zu verstehen. Anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation wird die Pulssequenz eingestellt.

[0011] Vorteilhafterweise wird die Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation durch eine Recheneinheit ermittelt. Vorteilhafterweise wird die Pulssequenz durch eine Recheneinheit eingestellt.

[0012] Vorzugsweise ist das Untersuchungs-Bewegungssignal ein Signal, dass die Bewegung des Patienten während zumindest eines Teils einer MR-Untersuchung beschreibt. Unter MR-Untersuchung ist hier vorzugsweise nicht nur der Zeitraum der Erfassung von MR-Signalen zu verstehen. Beispielsweise kann die MR-Untersuchung einen Zeitraum vor der Erfassung von MR-Signalen umfassen, insbesondere einen Zeitraum, in dem der Patient auf die Erfassung von MR-Signalen vorbereitet wird. Ein Teil einer MR-Untersuchung kann also beispielsweise auch der Zeitraum sein, in dem der Patient auf einer Lagerungsvorrichtung einer MR-Vorrichtung positioniert wird und/oder auch ein Zeitraum sein, in dem der Patient auf der Lagerungsvorrichtung verfahren wird.

[0013] Ein Teil der MR-Untersuchung kann auch eine Justagemessung sein. Die Justagemessung ist vorzugsweise eine Messung, die vor einer klinischen Messung, insbesondere vor einer Erfassung von MR-Signalen zur klinischen Diagnostik, stattfindet. Die Justagemessung umfasst vorzugsweise eine Adjustment-Prozedur. Die Justagemessung wird vorzugsweise ohne Zutun des Bedienpersonals ausgeführt. Als Justagemessung eignen sich insbesondere Messungen, die auf die Abbildung der relevanten Bewegung hin optimiert sind, z.B. Messungen mit hoher Bildwiederholrate, die die sich bewegenden Bereiche aufnehmen.

[0014] Das Untersuchungs-Bewegungssignal ist abhängig von der Bewegung des Patienten. Das Untersuchungs-Bewegungssignal kann insbesondere ein physiologisches Untersuchungs-Bewegungssignal sein. Insbesondere umfasst das Untersuchungs-Bewegungssig-

nal Informationen über die Bewegung des Patienten, beispielsweise Bewegungen des Kopfes, der Arme, der Beine, des Bauches und/oder der Brust des Patienten. Weitere mögliche Bewegungen sind Bewegungen innerer Organe, z.B. des Herzens und/oder peristaltische Bewegungen. Vorzugsweise beschreibt das Untersuchungs-Bewegungssignal eine Bewegung des Patienten, insbesondere eines Teils des Patienten. Vorzugsweise können aus dem Untersuchungs-Bewegungssignal Rückschlüsse über die Bewegung des Patienten gezogen werden.

[0015] Die Bestimmungsinformation umfasst vorzugsweise eine Information, die zur Bestimmung der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation aus dem Untersuchungs-Bewegungssignal verwendet werden kann. Vorzugsweise wird die Bestimmungsinformation abgeleitet aus zuvor erfassten MR-Signalen, insbesondere aus einer Bewertung zuvor erfasster MR-Signale. Vorzugsweise können aus einer Kombination und/oder Verknüpfung, insbesondere einem Vergleich, des Untersuchungs-Bewegungssignals mit zuvor erfassten weiteren Bewegungssignalen die Bestimmungsinformation abgeleitet werden. Dabei sind die weiteren Bewegungssignale vorteilhafterweise den zuvor erfassten, insbesondere bewerteten, MR-Signalen zugeordnet. Somit kann vorteilhafterweise aus einer Bewertung des zuvor erfassten MR-Signals eine Relation zwischen einem Bewegungssignal und einer Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation hergestellt werden.

[0016] Durch die Bestimmung der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation kann eine Vorhersage über die Wahrscheinlichkeit von Patientenbewegung getroffen werden. Diese Vorhersage kann bereits vor der Erfassung etwaiger MR-Signale, aus denen MR-Abbildungen erzeugt werden können, getroffen werden. Die Erfinder haben erkannt, dass bereits ein relativ kurzer Zeitraum der MR-Untersuchung ausreicht, den Patienten hinsichtlich seines Vermögens, etwaige Bewegungen zu unterdrücken, abzuschätzen.

[0017] Anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation kann somit vorteilhafterweise eine Pulssequenz eingestellt werden, die optimal zu dem Vermögen des Patienten, etwaige Bewegungen zu unterdrücken, passt. Für eine T2-gewichtete MR-Untersuchung wären beispielsweise je nach Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation eine Entscheidung zwischen einer SPACE-, TSE-, PROPELLER- oder HASTE-Pulssequenz und/oder eine Entscheidung zwischen einer 3D- oder 2D-Multislice-Pulssequenz denkbar. Hier stehen SPACE für "Sampling Perfection with Application optimized Contrasts using different flip angle Evolutions", TSE für "Turbo Spin-Echo", PROPELLER für "Periodically Rotated Overlapping Parallel Lines with Enhanced Reconstruction" und HASTE für "Half-Fourier Acquisition Single-shot Turbo Spin-Echo".

[0018] Vorzugsweise wird mit der eingestellten Pulssequenz ein MR-Signal erfasst. Ein daraus resultierender Vorteil kann insbesondere darin bestehen, dass die

erfassten MR-Signale von hoher Qualität sind.

[0019] Vorzugsweise wird anhand des erfassten MR-Signals eine MR-Abbildung erzeugt. Ein daraus resultierender Vorteil kann insbesondere darin bestehen, dass die erzeugte MR-Abbildung keine oder weniger Bewegungsartefakte aufweist.

[0020] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass die Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation eine Stärke und/oder Art zukünftiger Bewegung des Patienten umfasst. Ein daraus resultierender Vorteil liegt insbesondere darin, dass aus diesen Informationen die Pulssequenz noch präziser eingestellt werden kann.

[0021] Die Stärke der Bewegung kann beispielsweise eine Geschwindigkeit und/oder eine Amplitude einer Bewegung des Patienten umfassen. Die Art der Bewegung kann beispielsweise die Information umfassen, welcher Körperteil des Patienten die Bewegung ausführt oder in welche Richtung die Bewegung ausführt wird oder ob die Bewegung ein bestimmtes Muster (z.B. Kopfnicken) aufweist und/oder abrupt ist.

[0022] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass das Untersuchungs-Bewegungssignal während einer Verweilzeit des Patienten auf einer Patientenlagerungsvorrichtung einer MR-Vorrichtung permanent erfasst wird. Vorzugsweise wird das Untersuchungs-Bewegungssignal während der gesamten Verweilzeit des Patienten auf einer Patientenlagerungsvorrichtung der MR-Vorrichtung permanent erfasst. Beispielsweise wird das Untersuchungs-Bewegungssignal fortwährend aufgezeichnet, solange der Patient auf der Patientenlagerungsvorrichtung liegt.

[0023] Unter einer permanenten Erfassung kann hier eine Erfassung verstanden werden, bei der im Rahmen der technischen Möglichkeiten der Einheit, mit der das Untersuchungs-Bewegungssignal erfasst wird, das Untersuchungs-Bewegungssignal ununterbrochen erfasst wird. Ein daraus resultierender Vorteil liegt beispielsweise darin, dass dadurch eine große Datenmenge erzeugt wird, die wirkungsvoll zur Bestimmung der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation verwendet werden kann. Außerdem ist eine durchgehende Datenerfassung einfacher umzusetzen als beispielsweise eine irgendwie getriggerte Datenerfassung.

[0024] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass die Bestimmung der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation und die Einstellung der Pulssequenz anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation während der MR-Untersuchung, insbesondere während einer Erfassung von MR-Signalen, wiederholt ausgeführt werden. Beispielsweise wird die Pulssequenz während ihres Ablaufs anhand einer wiederholt ermittelten Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation neu eingestellt. So kann vorteilhafterweise die Pulssequenz dynamisch angepasst werden.

[0025] Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn der Patient im Laufe der MR-Untersuchung sein Bewegungsverhalten ändert.

[0026] Wenn beispielsweise der Patient unruhiger wird, so dass er sich stärker bewegt, kann eine bewegungsrobustere Pulssequenz eingestellt werden. Wenn beispielsweise der Patient ruhiger wird, so dass er sich weniger stark bewegt, kann eine Pulssequenz mit höherer räumlicher Auflösung eingestellt werden.

[0027] Vorzugsweise wird bei einer wiederholten Einstellung der Pulssequenz ein Mittelungsverfahren angepasst, insbesondere eine Mittelungszahl geändert, und/oder ein Teil der Pulssequenz neu aufgenommen. Dadurch können Bewegungsartefakte vermieden werden.

[0028] Unter einem Mittelungsverfahren kann hier insbesondere ein Verfahren verstanden werden, bei dem mehrere Messdaten, insbesondere eines zu erfassenden MR-Signals, gemittelt werden. Unter einer Mittelungszahl kann hier insbesondere eine Anzahl an Messdaten an einer gleichen k-Raum-Position verstanden werden, die gemittelt werden.

[0029] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass das Untersuchungs-Bewegungssignal während einer Positionierung des Patienten auf einer Patientenlagerungsvorrichtung einer MR-Vorrichtung und/oder während einer Verschiebung der Patientenlagerungsvorrichtung erfasst wird. Die Untersuchungszeit kann damit optimal genutzt werden, so dass beispielsweise die MR-Untersuchung schneller durchgeführt werden kann.

[0030] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass die Einstellung der Pulssequenz anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation automatisiert und/oder manuell erfolgt.

[0031] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation zumindest eine Pulssequenz vorgeschlagen wird, wobei aus der zumindest einen vorgeschlagenen Pulssequenz eine Pulssequenz ausgewählt und/oder bearbeitet wird.

[0032] Der Vorschlag wird vorteilhafterweise automatisch, insbesondere ohne Einwirkung des Bedienpersonals, durch eine Recheneinheit ermittelt. Vorzugsweise wird die zumindest eine Pulssequenz einem Bedienpersonal vorgeschlagen.

[0033] Insbesondere können die vorgeschlagene Pulssequenz oder die vorgeschlagenen Pulssequenzen auf einem Monitor angezeigt werden. Das Bedienpersonal kann beispielsweise den Vorschlag bestätigen und/oder korrigieren. Insbesondere kann das Bedienpersonal die zumindest eine vorgeschlagene Pulssequenz bestätigen oder ablehnen oder aus mehreren vorgeschlagenen Pulssequenzen eine Pulssequenz auswählen.

[0034] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass ein bekannter Anteil des Untersuchungs-Bewegungssignals aus dem Untersuchungs-Bewegungssignal abgetrennt wird und die Ermittlung der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation anhand des verbleibenden Untersuchungs-Bewegungssignals er-

folgt. Ein bekannter Anteil kann insbesondere ein Anteil einer inneren Organbewegung, insbesondere eines Herzschlags und/oder einer peristaltischen Bewegung, und/oder einer Atmung sein. Beispielsweise kann bei einem Herzschlag nach Abtrennung eines regelmäßigen Anteils ein arrhythmischer Anteil als verbleibender Anteil extrahiert werden. Dies ermöglicht insbesondere eine besonders genaue Auswertung.

[0035] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass die Bestimmungsinformation mit folgenden Schritten ermittelt wird: Ein Trainings-Bewegungssignal wird erfasst, das abhängig von der Bewegung des Patienten ist. Während der Erfassung des Trainings-Bewegungssignals wird ein Trainings-MR-Signal erfasst. Die Bestimmungsinformation wird durch Bewertung des Trainings-MR-Signals, insbesondere durch Bewertung einer aus dem Trainings-MR-Signal erzeugten Trainings-MR-Abbildung, ermittelt. Die Bestimmungsinformation wird vorzugsweise vor der Erfassung des Untersuchungs-Bewegungssignals ermittelt.

[0036] Dabei ist vorteilhafterweise die Bestimmungsinformation mit dem Trainings-Bewegungssignal verknüpft. Durch die Bewertung des Trainings-MR-Signals wird vorzugsweise auch das zugeordnete Trainings-Bewegungssignal bewertet, das während des Trainings-MR-Signals erfasst wurde. Somit kann eine Relation hergestellt werden zwischen der Bestimmungsinformation und dem Trainings-Bewegungssignal.

[0037] Vorzugsweise ist das Trainings-Bewegungssignal abhängig von der Bewegung des Patienten. Das Trainings-Bewegungssignal ist insbesondere ein physiologisches Untersuchungs-Bewegungssignal. Insbesondere umfasst das Trainings-Bewegungssignal Informationen über die Bewegung des Patienten. Vorzugsweise beschreibt das Trainings-Bewegungssignal eine Bewegung des Patienten, insbesondere eines Teils des Patienten. Vorzugsweise können aus dem Trainings-Bewegungssignal Rückschlüsse über die Bewegung des Patienten gezogen werden.

[0038] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass das Trainings-Bewegungssignal in der gleichen Weise wie das Untersuchungs-Bewegungssignal erfasst wird. Insbesondere werden die gleiche Methode und/oder die gleichen Mittel, insbesondere ein gleicher Sensortyp, verwendet. Daraus kann insbesondere der Vorteil resultieren, dass das Trainings-Bewegungssignal und das Untersuchungs-Bewegungssignal leicht miteinander in Beziehung gesetzt, insbesondere verglichen, werden können.

[0039] Eine weitere Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass das Trainings-Bewegungssignal von dem Trainings-MR-Signal verschieden ist. Insbesondere ist die Erfassungsweise des Trainings-Bewegungssignals von der Erfassungsweise des Trainings-MR-Signals verschieden. Insbesondere ist der Typ des Trainings-Bewegungssignals verschieden vom Typ des Trainings-MR-Signals. Insbesondere werden die verschiedenen Methoden und/oder verschiedene Mittel verwendet. Insbeson-

dere können spezielle physiologische Sensoren und/oder Verfahren, die geeignet sind die Bewegung des Patienten zu erfassen, zur Erfassung des Trainings-Bewegungssignals verwendet werden. Insbesondere kann das Untersuchungs-Bewegungssignal ungeeignet zur Erzeugung einer MR-Abbildung sein.

[0040] Hingegen ist das Trainings-MR-Signal vorzugsweise geeignet, daraus eine MR-Bildung zu erzeugen. Insbesondere wird das Trainings-MR-Signal durch eine MR-Spule erfasst, insbesondere durch eine MR-Lokal-spule (engl. local coil) und/oder eine MR-Ganzkörperspule (engl. body coil).

[0041] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass das Untersuchungs-Bewegungssignal und/oder das Trainings-Bewegungssignal mit zumindest einem Atemsensor und/oder einer Kamera und/oder zumindest einer Magnetfeldsonde und/oder mit einem Pilotton-Verfahren erfasst werden.

[0042] Der Atemsensor kann beispielsweise ein Atemgurt und/oder einer Spule sein, deren Beladung abhängig von einer Atembewegung ist.

[0043] Die Magnetfeldsonde misst vorzugsweise das Magnetfeld in einem Patientenaufnahmebereich, insbesondere einem Messbereich, insbesondere einem Sichtfeld (engl. field of view, FOV), der MR-Vorrichtung. Vorzugsweise sind als Magnetfeldsonden mehrere kleine Spulenelemente in MR-Spulen, insbesondere MR-Lokalspulen, verteilt. Sie können vorteilhafterweise zeitgleich und unabhängig von MR-Signalen angeregt und ausgelesen werden und liefern die Phase an ihrem jeweiligen Ort.

[0044] Bei dem Pilotton-Verfahren wird vorzugsweise ein schwaches und/oder kontinuierliches und/oder monofrequentes HF-Signal eingestrahlt. Das HF-Signal ist vorteilhafterweise abseits der Resonanzfrequenz der anzuregenden Substanz, deren Resonanz das MR-Signal auslöst. Das HF-Signal wird vorzugsweise in Amplitude und Phase durch Bewegung des Patienten in unterschiedlichen Elementen zumindest einer MR-Spule abhängig von deren Ort mit dem MR-Signal zusammen aufgenommen. Die Frequenz des HF-Signals ist vorteilhafterweise so gewählt, dass sie nicht mit dem MR-Signal überlappt, so dass es durch Frequenzanalyse von diesem separiert werden kann.

[0045] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass die Ermittlung der Bestimmungsinformation anhand eines Ablaufs einer Trainings-MR-Untersuchung erfolgt, d.h. in die Ermittlung der Bestimmungsinformation geht der Ablauf der Trainings-MR-Untersuchung ein.

[0046] Insbesondere kann die Ermittlung der Bestimmungsinformation anhand von Messwiederholungen während der Trainings-MR-Untersuchung erfolgen. So kann beispielsweise aus einer Messwiederholung darauf geschlossen werden, dass die vorangehende Messung, insbesondere die vorangehend erfassten Trainings-MR-Signale, ungenügend war und das zugehörige Trainings-Bewegungssignal mit einer entsprechenden Information

verknüpft werden. Mit einem derartigen Lernprozess kann die Bestimmungsinformation verbessert werden.

[0047] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass alternativ zur Ermittlung der Bestimmungsinformation anhand eines Ablaufs einer Trainings-MR-Untersuchung oder damit kombiniert die Ermittlung der Bestimmungsinformation anhand einer visuellen Inspektion von aus den Trainings-MR-Signalen erzeugten Trainings-MR-Abbildungen erfolgt.

[0048] Beispielsweise kann ein Bedienpersonal einer MR-Vorrichtung aus Trainings-MR-Signalen erzeugte Trainings-MR-Abbildungen betrachten und diese bewerten. Weist eine Trainings-MR-Abbildung beispielsweise Artefakte auf, dann kann der Bediener die Trainings-MR-Abbildung entsprechend niedrig bewerten. Die niedrige Bewertung kann in Beziehung gesetzt werden zu dem Trainings-Bewegungssignal, das während der Erfassung des Trainings-MR-Signals erfasst wurde. Dieser Zusammenhang geht vorteilhafterweise in die Bestimmungsinformation ein. Bei einer MR-Untersuchung kann dann beispielsweise bei einem ähnlichen Untersuchungs-Bewegungssignal darauf geschlossen werden, dass eine erhöhte Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass sich der Patient im weiteren Verlauf der MR-Untersuchung in ungünstiger Weise bewegt. Die Pulssequenz kann somit anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation eingestellt werden, um Artefakte zu reduzieren.

[0049] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass die Bestimmung einer Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation und/oder die Ermittlung der Bestimmungsinformation anhand eines Algorithmus erfolgt, welcher auf maschinellem Lernen (engl. machine learning) und/oder einem künstlichen neuronalem Netz, insbesondere einem Convolutional Neural Network (CNN), basiert.

[0050] Insbesondere kann die Ermittlung der Bestimmungsinformation durch mit Hilfe eines automatisierten Bildbewertungsverfahrens erfolgen, insbesondere mit Verknüpfung einer daraus abgeleiteten Maßzahl. Ein solches automatisiertes Bildbewertungsverfahren ist beispielhaft in KÜSTNER, Thomas et al. Automated reference-free detection of motion artifact in magnetic resonance images. In: Magn Reson Mater Phys, 2017. DOI 10.1007/s10334-017-0650-z beschrieben. Eine Bewertung von Trainings-MR-Abbildungen, die aus den Trainings-MR-Signalen erzeugt wurden, erfolgt hier vorteilhafterweise automatisiert. Die weitere Verarbeitung der Bewertung kann insbesondere in gleicher Weise erfolgen, wie oben beschrieben bei einer visuellen Inspektion von aus den Trainings-MR-Signalen erzeugten Trainings-MR-Abbildungen.

[0051] Ein möglicher Vorteil eines automatisierten Verfahrens kann insbesondere darin bestehen, dass die Bestimmungsinformation ohne Benutzerinteraktion kontinuierlich verbessert werden kann. Somit kann die Bestimmungsinformation kontinuierlich trainiert werden.

[0052] Eine bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens sieht vor, dass der Algorithmus, welcher auf ma-

schinellem Lernen (engl. machine learning) und/oder einem künstlichen neuronalem Netz basiert, durch Trainings-MR-Signale und Trainings-Bewegungssignale verbessert wird, welche durch mehrere MR-Vorrichtungen erfasst werden. Somit können beispielsweise Trainingsdaten von dezentral, insbesondere weltweit, installierten MR-Vorrichtungen genutzt werden, um die Vorhersage der Bewegungswahrscheinlichkeit zu optimieren. Dazu sind die MR-Vorrichtungen vorteilhafterweise über ein Daten-Netzwerk miteinander und/oder mit einer Zentraleinheit verbunden.

[0053] Ferner wird eine MR-Vorrichtung vorgeschlagen, die ausgebildet ist, ein vorab beschriebenes Verfahren auszuführen. Die MR-Vorrichtung umfasst vorzugsweise Mittel zur Erfassung eines Untersuchungs- und/oder Trainings-Bewegungssignals, zur Bestimmung einer Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation und zur Einstellung der Pulssequenz.

[0054] Mittel zur Erfassung eines Untersuchungs- und/oder Trainings-Bewegungssignals können - wie vorab bereits erläutert - beispielsweise physiologische Sensoren, insbesondere ein Atemsensor, insbesondere ein Atemgurt, und/oder eine Kamera und/oder ein Magnetfeldsensor sein. Mittel zur Bestimmung einer Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation und zur Einstellung der Pulssequenz können beispielsweise eine programmierbare Recheneinheit (z.B. mit Prozessoren, und/oder eine Speichereinheit) sein, die geeignet ist, ein Computerprogramm auszuführen.

[0055] Die Vorteile der erfindungsgemäßen MR-Vorrichtung entsprechen im Wesentlichen den Vorteilen des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Einstellung einer Pulssequenz einer MR-Untersuchung, welche vorab im Detail ausgeführt sind. Hierbei erwähnte Merkmale, Vorteile oder alternative Ausführungsformen können ebenso auch auf die anderen beanspruchten Gegenstände übertragen werden und umgekehrt.

[0056] Ferner wird ein Computerprogrammprodukt vorgeschlagen, das ein Programm umfasst und direkt in einen Speicher einer programmierbaren Recheneinheit einer MR-Vorrichtung ladbar ist und Programmmittel, z.B. Bibliotheken und Hilfsfunktionen, aufweist, um ein vorab beschriebenes Verfahren zur Einstellung einer Pulssequenz auszuführen, wenn das Computerprogrammprodukt in der Recheneinheit ausgeführt wird. Das Computerprogrammprodukt kann dabei eine Software mit einem Quellcode, der noch kompiliert und gebunden oder der nur interpretiert werden muss, oder einen ausführbaren Softwarecode umfassen, der zur Ausführung nur noch in die Überprüfungs- und/oder Ausführungseinheit zu laden ist. Durch das Computerprogrammprodukt kann das Verfahren zur Einstellung einer Pulssequenz schnell, identisch wiederholbar und robust ausgeführt werden. Das Computerprogrammprodukt ist so konfiguriert, dass es mittels der Recheneinheit die erfindungsgemäßen Verfahrensschritte ausführen kann. Die Recheneinheit muss dabei jeweils die Voraussetzungen wie beispielsweise einen entsprechenden Arbeitsspeicher, eine entsprechende

Grafikkarte oder eine entsprechende Logikeinheit aufweisen, so dass die jeweiligen Verfahrensschritte effizient ausgeführt werden können.

[0057] Das Computerprogrammprodukt ist beispielsweise auf einem computerlesbaren Medium gespeichert oder auf einem Netzwerk oder Server hinterlegt, von wo es in den Prozessor einer lokalen Recheneinheit geladen werden kann. Weiterhin können Steuerinformationen des Computerprogrammprodukts auf einem elektronisch lesbaren Datenträger gespeichert sein. Die Steuerinformationen des elektronisch lesbaren Datenträgers können derart ausgestaltet sein, dass sie bei Verwendung des Datenträgers in einer Recheneinheit ein erfindungsgemäßes Verfahren durchführen. Beispiele für elektronisch lesbare Datenträger sind eine DVD, ein Magnetband oder einen USB-Stick, auf welchem elektronisch lesbare Steuerinformationen, insbesondere Software, gespeichert ist. Wenn diese Steuerinformationen von dem Datenträger gelesen und in eine Recheneinheit gespeichert werden, können alle erfindungsgemäßen Ausführungsformen der vorab beschriebenen Verfahren durchgeführt werden. So kann die Erfindung auch von dem besagten computerlesbaren Medium und/oder dem besagten elektronisch lesbaren Datenträger ausgehen.

[0058] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand der Zeichnungen. Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0059] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den im Folgenden beschriebenen Ausführungsbeispielen sowie anhand der Zeichnungen. Einander entsprechende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0060] Es zeigen:

Fig. 1 eine MR-Vorrichtung mit physiologischen Sensoren und einer Recheneinheit zur Einstellung einer Pulssequenz,

Fig. 2 ein Verfahren zur Einstellung einer Pulssequenz,

Fig. 3-4 erweiterte Verfahren zur Einstellung einer Pulssequenz,

Fig. 5-6 beispielhafte Verläufe von Bewegungssignalen,

Fig. 7 ein Ablauf einer MR-Untersuchung,

Fig. 8 mehrere MR-Vorrichtungen, die über ein Daten-Netzwerk direkt miteinander verbunden sind,

Fig. 9 mehrere MR-Vorrichtungen, die über ein Daten-Netzwerk mit einer Zentraleinheit miteinander verbunden sind.

[0061] In Fig. 1 ist eine MR-Vorrichtung 10 schematisch dargestellt. Die MR-Vorrichtung 10 umfasst eine Magneteinheit 11, die einen Hauptmagneten 12 zu einem Erzeugen eines starken und insbesondere zeitlich konstanten Hauptmagnetfelds 13 aufweist. Zudem umfasst die MR-Vorrichtung 10 einen Patientenaufnahmebereich 14 zu einer Aufnahme eines Patienten 15. Der Patientenaufnahmebereich 14 im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist zylinderförmig ausgebildet und in einer Umfangsrichtung von der Magneteinheit 11 zylinderförmig umgeben. Grundsätzlich ist jedoch eine davon abweichende Ausbildung des Patientenaufnahmebereichs 14 jederzeit denkbar. Der Patient 15 kann mittels einer Patientenlagerungsvorrichtung 16 der MR-Vorrichtung 10 in den Patientenaufnahmebereich 14 geschoben werden. Die Patientenlagerungsvorrichtung 16 weist hierzu einen innerhalb des Patientenaufnahmebereichs 14 bewegbar ausgestalteten Patiententisch 17 auf.

[0062] Die Magneteinheit 11 weist weiterhin eine Gradientenspuleneinheit 18 zu einer Erzeugung von Magnetfeldgradienten auf, die für eine Ortskodierung während einer Bildgebung verwendet werden. Die Gradientenspuleneinheit 18 wird mittels einer Gradientensteereinheit 19 der MR-Vorrichtung 10 gesteuert. Die Magneteinheit 11 umfasst weiterhin eine Antenneneinheit 20, welche im vorliegenden Ausführungsbeispiel als fest in die MR-Vorrichtung 10 integrierte MR-Ganzkörperspule ausgebildet ist. Die Antenneneinheit 20 ist zu einer Anregung von Atomkernen, die sich in dem von dem Hauptmagneten 12 erzeugten Hauptmagnetfeld 13 einstellt, ausgelegt. Die Antenneneinheit 20 wird von einer Antennensteereinheit 21 der MR-Vorrichtung 10 gesteuert und strahlt eine Pulssequenz in einen Untersuchungsraum ein, der im Wesentlichen von einem Patientenaufnahmebereich 14 der MR-Vorrichtung 10 gebildet ist. Die Antenneneinheit 20 ist weiterhin zum Empfang von MR-Signalen ausgebildet.

[0063] Zu einer Steuerung des Hauptmagneten 12, der Gradientensteereinheit 19 und zur Steuerung der Antennensteereinheit 21 weist die MR-Vorrichtung 10 eine Systemsteereinheit 22 auf. Die Systemsteereinheit 22 steuert zentral die MR-Vorrichtung 10, wie beispielsweise das Durchführen einer bildgebenden Pulssequenz. Zudem umfasst die Systemsteereinheit 22 eine nicht näher dargestellte Auswerteeinheit zu einer Auswertung von MR-Signalen, die während der MR-Untersuchung erfasst werden. Des Weiteren umfasst die MR-Vorrichtung 10 eine Benutzerschnittstelle 23, die mit der Systemsteereinheit 22 verbunden ist. Steuerinformationen wie beispielsweise Bildgebungsparameter, sowie erzeugte MR-Abbildungen können auf einer Anzeigeeinheit 24, beispielsweise auf zumindest einem Monitor, der Benutzerschnittstelle 23 für ein medizinisches Bedienpersonal angezeigt werden. Weiterhin weist die Benutzerschnittstelle 23 eine Eingabeeinheit 25 auf, mittels der Informationen und/oder Parameter während eines Messvorgangs von dem medizinischen Bedienpersonal eingegeben werden können.

[0064] Ferner umfasst die MR-Vorrichtung 10 beispielhaft mehrere physiologische Sensoren wie einem Atemgurt 27, eine Magnetfeldsonde 28 und eine Kamera 29, die mit der Systemsteereinheit verbunden sind. Mit den Sensoren 27, 28, 29 können Bewegungssignale, insbesondere ein Untersuchungs-Bewegungssignal und/oder ein Trainings-Bewegungssignal, erfasst werden.

[0065] Eine solche Vielzahl an Sensoren 27, 28, 29, wie hier dargestellt, ist jedoch nicht notwendig, d.h. auch beispielsweise nur ein Sensor kann ausreichend sein. Möglicherweise kann auch ganz auf spezielle Sensoren verzichtet werden, solange es in irgendeiner Weise möglich ist, ein Bewegungssignal des Patienten 15 zu erfassen.

[0066] Ferner kann die MR-Vorrichtung 10 einen oder mehrere hier nicht dargestellte Sender zur Erzeugung eines HF-Signals umfassen, mit dem ein Pilotton-Verfahren ausgeführt werden kann. Mit dem Pilotton-Verfahren können auch Bewegungssignale des Patienten 15 erfasst werden.

[0067] Ferner umfasst die Systemsteereinheit 22 eine programmierbare Recheneinheit 26 mit einem Speicher, in das ein Computerprogrammprodukt geladen werden kann, um ein in Fig. 2-4 dargestelltes Verfahren auszuführen.

[0068] Gemäß Fig. 2 wird in einem Schritt 110 ein Untersuchungs-Bewegungssignal erfasst, das abhängig von der Bewegung des Patienten ist. Diese können beispielsweise mit den bereits beschriebenen Sensoren 27, 28, 29 und/oder mit einem Pilotton-Verfahren erfasst werden. Ferner ist z.B. auch eine kontinuierliche Sequenz-Navigator-Aufnahme oder/oder eine Bewegungserfassung während einer Justagemessung denkbar.

[0069] Eine Justagemessung ist vorzugsweise eine Messung, die ohne Zutun des Bedienpersonals als Teil einer der klinischen Messung vorgeschalteten Adjustement-Prozedur gestartet wird. Als Justagemessung eignen sich insbesondere Messungen, die auf die Abbildung der relevanten Bewegung hin optimiert sind, z.B. Messungen mit hoher Bildwiederholrate, die die sich bewegenden Bereiche aufnehmen.

[0070] In Fig. 5-6 sind beispielhafte Verläufe von Bewegungssignalen dargestellt, bei denen eine Signalamplitude A über die Zeit t aufgetragen sind. In Fig. 5 wird ein Atemsignal und in Fig. 6 eine Handbewegung dargestellt. Man erkennt, dass aus den Bewegungssignalen Informationen über die Bewegung, insbesondere über die Art und Stärke der Bewegung abgeleitet werden können.

[0071] Die Bewegungssignale werden bevorzugt während der Verweilzeit des Patienten 15 auf dem Patiententisch 17 permanent aufgezeichnet. Je nach Sensortyp kann dies bereits bei der Positionierung des Patienten 15 auf dem Patiententisch 17, während eines Verfahrens des Patiententisches 17 und/oder sobald der Patient 15 in das Isozentrum (üblicherweise die Mitte des Patientenaufnahmebereichs 14) der MR-Vorrichtung 10 gefahren wurde, erfolgen.

[0072] In Schritt 120 der Fig. 2 wird eine Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation anhand des Untersuchungs-Bewegungssignals und einer Bestimmungsinformation erfasst. Dabei umfasst die Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation eine Wahrscheinlichkeitsangabe zukünftiger Bewegung des Patienten 15.

[0073] Beispielsweise wird vor jeder geplanten Bildgebungssequenz eine aktuelle Wahrscheinlichkeitsangabe in Form einer Maßzahl ermittelt. Diese Maßzahl kann dem Bedienpersonal beispielsweise direkt auf der Anzeigeeinheit 24 angezeigt werden oder automatisch für die Wahl einer optimalen Untersuchungsstrategie für die nächste Pulssequenz verwendet werden.

[0074] Alternativ zur Maßzahl kann ein Algorithmus, welcher auf maschinellem Lernen und/oder einem künstlichen neuronalen Netz, insbesondere einem Convolutional Neural Network (CNN), basiert, auch direkt die günstigste Untersuchungsmethode in Form einer Pulssequenz für die jeweils gefundene Bewegungsanfälligkeit zurückliefern. Für eine T2-gewichtete MR-Untersuchung wären beispielsweise je nach Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation eine Entscheidung zwischen einer SPACE-, TSE-, PROPELLER- oder HASTE-Pulssequenz und/oder eine Entscheidung zwischen einer 3D- oder 2D-Multislice-Pulssequenz denkbar. Die Einstellung der Pulssequenz stellt dann Schritt 130 dar.

[0075] Das Verfahren gemäß Fig. 3 ist dahingehend erweitert, dass zusätzlich in Schritt 140 MR-Signale erfasst werden. Das MR-Signal wird mittels der MR-Vorrichtung 10 durch Einstrahlung der eingestellten Pulssequenz wie vorab erklärt aufgenommen.

[0076] In Schritt 150 wird anhand der erfassten MR-Signale eine MR-Abbildung erzeugt. Diese können beispielsweise auf der Anzeigeeinheit 24 angezeigt werden.

[0077] In Fig. 4 wird ferner dargestellt, wie die Bestimmungsinformation ermittelt werden kann, insbesondere der besagte Algorithmus trainiert werden kann. In Schritt 210 wird ein Trainings-Bewegungssignal erfasst, das wie das Untersuchungs-Bewegungssignal abhängig von der Bewegung des Patienten ist. Hier können auch wieder die Sensoren 27, 28, 29 und/oder Verfahren eingesetzt werden, die auch für die Erfassung des Untersuchungs-Bewegungssignals eingesetzt werden. Insbesondere kann das Untersuchungs-Bewegungssignal in der gleichen Weise wie das Trainings-Bewegungssignal erfasst werden.

[0078] Während der Erfassung des Trainings-Bewegungssignals in Schritt 210 erfolgt in Schritt 220 die Erfassung eines Trainings-MR-Signals. Das Trainings-MR-Signal ist ein bildgebendes MR-Signal, wie es bereits vorab beschrieben wurde.

[0079] Vorzugsweise werden für das Training des besagten Algorithmus die Schritte 210 und 220 nicht nur einmal durchgeführt, sondern es wird eine Vielzahl an MR-Aufnahmen durchgeführt.

[0080] In Schritt 230 wird die Bestimmungsinformation durch Bewertung des Trainings-MR-Signals ermittelt. Dies kann manuell und/oder automatisiert erfolgen.

[0081] Ein manuelles Verfahren kann z.B. auf einer manuellen Bewertung nach einer retrospektiven visuellen Inspektion von MR-Abbildungen basieren, die aus den Trainings-MR-Signalen erzeugt wurden. Diese Bewertung und das in Schritt 210 erfasste Trainings-Bewegungssignal gehen in die Ermittlung der Bestimmungsinformation ein, d.h. der besagte Algorithmus wird dadurch trainiert.

[0082] Ein automatisches Training kann beispielsweise anhand eines Algorithmus erfolgen, das auf maschinellem Lernen und/oder einem künstlichen neuronalen Netz, insbesondere einem Convolutional Neural Network (CNN) beruht. Insbesondere kann das Training durch eine Verknüpfung mit einer Bewertung einer MR-Abbildung erfolgen, die mit einem Automatisierungen bildbewertungsverfahren bestimmt wird, wie es beispielhaft in KÜSTNER, Thomas et al. Automated reference-free detection of motion artifact in magnetic resonance images. In: Magn Reson Mater Phys, 2017. DOI 10.1007/s10334-017-0650-z beschrieben ist. Vorteilhaft ist hierbei, dass zum Training keine Interaktion des Bedienpersonals erforderlich ist.

[0083] Bei beiden Verfahren werden die Trainings-Bewegungssignale während der Aufnahme der bildgebenden Trainings-MR-Signale aufgezeichnet, so dass diese Daten miteinander verknüpft werden können. Dadurch kann in beiden Fällen ein retrospektives Training erfolgen, was die Genauigkeit des Verfahrens erhöht.

[0084] Weiterhin kann auf Basis von erkannten Messwiederholungen, die durch das Bedienpersonal durchgeführt wurden, eine Bewertung des Trainings-MR-Signals abgeleitet werden.

[0085] Ferner kann die Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation, insbesondere eine Vorhersage, ob und/oder wie sich der Patient 15 bewegen wird, auch in kürzeren Zeitabständen während der Laufzeit der Pulssequenz erfolgen, um eine dynamische Anpassung der Parameter der Pulssequenz zu ermöglichen, z.B. eine Veränderung einer Mittelungszahl und/oder eine Neuaufnahme einzelner Sequenzteile. Dies wird beispielhaft in Fig. 7 dargestellt.

[0086] Zum einen kann schon während der Positionierung des Patienten 15 auf dem Patiententisch 17 im Zeitraum P1 die Einstellung der Pulssequenz durch die Schritte 110, 120 und 130 erfolgen, so dass zum Zeitpunkt t1 des Beginns der Laufzeit der Pulssequenz im Zeitraum P2 die Pulssequenz eingestellt wird.

[0087] Aber auch während der Laufzeit der Pulssequenz, also wenn bereits Bilddaten aufgenommen werden, kann die Pulssequenz wiederholt eingestellt werden, beispielsweise in den Zeitpunkten t2, t3 und t4. Die Bestimmung der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation und die Einstellung der Pulssequenz anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation während der MR-Untersuchung werden hier also wiederholt ausgeführt.

[0088] In Fig. 8 und 9 sind MR-Vorrichtungen 10 dargestellt, die über ein Daten-Netzwerk miteinander

und/oder mit einer Zentraleinheit 99 verbunden sind. Somit können mehrere MR-Vorrichtungen 10 dazu beitragen, einen Algorithmus zur Bestimmung einer Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation und/oder zur Ermittlung der Bestimmungsinformation zu verbessern. Insbesondere kann ein künstliches neuronales durch Trainings-MR-Signale und Trainings-Bewegungssignale trainiert werden.

[0089] Es wird abschließend noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich bei den vorhergehend detailliert beschriebenen Verfahren sowie bei der dargestellten Erfassungsmustererzeugungseinheit und MR-Vorrichtung lediglich um Ausführungsbeispiele handelt, welche vom Fachmann in verschiedenster Weise modifiziert werden können, ohne den Bereich der Erfindung zu verlassen. Weiterhin schließt die Verwendung der unbestimmten Artikel "ein" bzw. "eine" nicht aus, dass die betreffenden Merkmale auch mehrfach vorhanden sein können. Ebenso schließt der Begriff "Einheit" nicht aus, dass die betreffenden Komponenten aus mehreren zusammenwirkenden Teil-Komponenten bestehen, die gegebenenfalls auch räumlich verteilt sein können. Erfolgt ein Verfahrensschritt "anhand" eines Mittels, so schließt dies nicht aus, dass noch weitere Mittel zum Verfahrensschritt beitragen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Einstellung einer Pulssequenz einer MR-Untersuchung eines Patienten mit folgenden Schritten:

- Erfassung eines Untersuchungs-Bewegungssignal, das abhängig von der Bewegung des Patienten ist,
- Bestimmung einer Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation anhand des Untersuchungs-Bewegungssignals und einer Bestimmungsinformation, wobei die Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation eine Wahrscheinlichkeitsangabe zukünftiger Bewegung des Patienten umfasst,
- Einstellung der Pulssequenz anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation eine Stärke und/oder Art der zukünftigen Bewegung des Patienten umfasst.

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Untersuchungs-Bewegungssignal während einer Verweilzeit des Patienten auf einer Patientenlagerungsvorrichtung einer MR-Vorrichtung permanent erfasst wird.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Bestimmung der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation und die Einstellung der Pulssequenz anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation während der MR-Untersuchung wiederholt ausgeführt werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei bei einer wiederholten Einstellung der Pulssequenz eine Mittelungszahl geändert und/oder ein Teil der Pulssequenz neu aufgenommen wird.

6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Untersuchungs-Bewegungssignal erfasst wird

- während einer Positionierung des Patienten auf einer Patientenlagerungsvorrichtung einer MR-Vorrichtung und/oder
- während einer Verschiebung der Patientenlagerungsvorrichtung und/oder
- sobald sich der Patient in einer Messposition befindet, in der sich der Patient während einer Erfassung von MR-Signalen befindet.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Einstellung der Pulssequenz anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation automatisiert und/oder manuell erfolgt.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation zumindest eine Pulssequenz vorgeschlagen wird, wobei aus der zumindest einen vorgeschlagenen Pulssequenz eine Pulssequenz ausgewählt und/oder bearbeitet wird.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei ein bekannter Anteil des Untersuchungs-Bewegungssignals aus dem Untersuchungs-Bewegungssignal abgetrennt wird und die Ermittlung der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation anhand des verbleibenden Untersuchungs-Bewegungssignals erfolgt.

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Bestimmungsinformation mit folgenden Schritten ermittelt wird:

- Erfassung eines Trainings-Bewegungssignals, das abhängig von der Bewegung des Pa-

- tienten ist,
 - Erfassung eines Trainings-MR-Signals während der Erfassung des Trainings-Bewegungssignals,
 - Ermittlung der Bestimmungsinformation durch Bewertung des Trainings-MR-Signal.
11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei das Untersuchungs-Bewegungssignal in einer gleichen Weise wie das Trainings-Bewegungssignal erfasst wird. 10
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11, wobei die Erfassungsweise des Trainings-Bewegungssignals von der des Trainings-MR-Signals verschieden ist. 15
13. Verfahren nach einem vorangehenden Ansprüche, wobei das Untersuchungs-Bewegungssignal und/oder das Trainings-Bewegungssignal mit zumindest einem Atemsensor und/oder einer Kamera und/oder zumindest einem Magnetfeldsensor und/oder mit einem Pilotton-Verfahren erfasst werden. 20
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei die Ermittlung der Bestimmungsinformation anhand einer visuellen Inspektion von aus den Trainings-MR-Signalen erzeugten Trainings-MR-Abbildungen und/oder anhand eines Ablaufs einer Trainings-MR-Untersuchung erfolgt. 25
15. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Bestimmung einer Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation und/oder die Ermittlung der Bestimmungsinformation anhand eines Algorithmus erfolgt, welcher auf maschinellem Lernen (engl. machine learning) und/oder einem künstlichen neuronalen Netz, insbesondere einem Convolutional Neural Network (CNN), basiert. 30
16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei der Algorithmus durch Trainings-MR-Signale und/oder Trainings-Bewegungssignale verbessert wird, welche durch mehrere MR-Vorrichtungen erfasst werden. 35
17. MR-Vorrichtung, welche ausgebildet ist, ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16 durchzuführen. 40
18. Computerprogrammprodukt, welches ein Programm umfasst und direkt in einen Speicher einer programmierbaren Recheneinheit einer MR-Vorrichtung ladbar ist, mit Programmmitteln, um ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16 auszuführen, wenn das Programm in der Recheneinheit

ausgeführt wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2) EPÜ.

1. Verfahren zur Einstellung einer Pulssequenz zur Bildgebung einer MR-Untersuchung eines Patienten mit folgenden Schritten:
- Erfassung eines Untersuchungs-Bewegungssignals, das abhängig von der Bewegung des Patienten ist, in einem Zeitraum vor einer Erfassung von MR-Signalen während der MR-Untersuchung,
 - Bestimmung einer Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation anhand des Untersuchungs-Bewegungssignals und einer Bestimmungsinformation, wobei die Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation eine Wahrscheinlichkeitsangabe zukünftiger Bewegung des Patienten umfasst,
 wobei die Bestimmungsinformation aus einer Kombination und/oder Verknüpfung des Untersuchungs-Bewegungssignals mit zuvor erfassten weiteren Bewegungssignalen abgeleitet ist, wobei ein bekannter Anteil einer inneren Organbewegung und/oder einer Atmung des Untersuchungs-Bewegungssignals aus dem Untersuchungs-Bewegungssignal abgetrennt wird und die Ermittlung der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation anhand des verbleibenden Untersuchungs-Bewegungssignals erfolgt,
 - Einstellung der Pulssequenz, die optimal zu dem Vermögen des Patienten passt, etwaige Bewegungen zu unterdrücken, anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation eine Stärke und/oder Art der zukünftigen Bewegung des Patienten umfasst.
3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Untersuchungs-Bewegungssignal während einer Verweilzeit des Patienten auf einer Patientenlagerungsvorrichtung einer MR-Vorrichtung permanent erfasst wird.
4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Bestimmung der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation und die Einstellung der Pulssequenz anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation während der MR-Untersuchung wiederholt ausgeführt werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei bei einer wiederholten Einstellung der Pulssequenz eine Mittelungszahl geändert und/oder ein Teil der Pulssequenz neu aufgenommen wird.
6. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Untersuchungs-Bewegungssignal erfasst wird
- während einer Positionierung des Patienten auf einer Patientenlagerungsvorrichtung einer MR-Vorrichtung und/oder
 - während einer Verschiebung der Patientenlagerungsvorrichtung und/oder
 - sobald sich der Patient in einer Messposition befindet, in der sich der Patient während einer Erfassung von MR-Signalen befindet.
7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Einstellung der Pulssequenz anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation automatisiert und/oder manuell erfolgt.
8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei anhand der Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation zumindest eine Pulssequenz automatisch vorgeschlagen wird, wobei durch ein Bedienpersonal aus der zumindest einen vorgeschlagenen Pulssequenz eine Pulssequenz ausgewählt und/oder bearbeitet wird.
9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei das Untersuchungs-Bewegungssignal mit zumindest einem Atemsensor und/oder einer Kamera und/oder zumindest einem Magnetfeldsensor und/oder mit einem Pilotton-Verfahren erfasst werden.
10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Bestimmungsinformation mit folgenden Schritten ermittelt wird:
- Erfassung eines Trainings-Bewegungssignals, das abhängig von der Bewegung des Patienten ist,
 - Erfassung eines Trainings-MR-Signals während der Erfassung des Trainings-Bewegungssignals,
 - Ermittlung der Bestimmungsinformation durch Bewertung des Trainings-MR-Signals mit dem Trainings-Bewegungssignal, so dass eine Relation zwischen der Bestimmungsinformation und dem Trainings-Bewegungssignal hergestellt wird.
11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei das Untersuchungs-Bewegungssignal in einer gleichen Weise wie das Trainings-Bewegungssignal erfasst wird.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11, wobei die Erfassungsweise des Trainings-Bewegungssignals von der des Trainings-MR-Signals verschieden ist.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei das Trainings-Bewegungssignal mit zumindest einem Atemsensor und/oder einer Kamera und/oder zumindest einem Magnetfeldsensor und/oder mit einem Pilotton-Verfahren erfasst werden.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wobei die Ermittlung der Bestimmungsinformation anhand einer visuellen Inspektion von aus den Trainings-MR-Signalen erzeugten Trainings-MR-Abbildungen durch ein Bedienpersonal und/oder anhand eines Ablaufs einer Trainings-MR-Untersuchung erfolgt, während der das Trainings-MR-Signal erfasst wurde.
15. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Bestimmung einer Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation und/oder die Ermittlung der Bestimmungsinformation anhand eines Algorithmus erfolgt, welcher auf maschinellem Lernen (engl. machine learning) und/oder einem künstlichen neuronalen Netz, insbesondere einem Convolutional Neural Network (CNN), basiert.
16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei der Algorithmus durch Trainings-MR-Signale und/oder Trainings-Bewegungssignale verbessert wird, welche durch mehrere MR-Vorrichtungen erfasst werden.
17. MR-Vorrichtung, welche ausgebildet ist, ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16 durchzuführen, wobei die MR-Vorrichtung Mittel zur Erfassung eines Untersuchungs- und/oder Trainings-Bewegungssignals, zur Bestimmung einer Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation und zur Einstellung der Pulssequenz umfasst.
18. Computerprogrammprodukt, welches ein Programm umfasst und direkt in einen Speicher einer programmierbaren Recheneinheit einer MR-Vorrichtung ladbar ist, mit Programmmitteln, um ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 16 auszuführen.

führen, wenn das Programm in der Recheneinheit ausgeführt wird, wobei die MR-Vorrichtung Mittel zur Erfassung eines Untersuchungs- und/oder Trainings-Bewegungssignals, zur Bestimmung einer Bewegungswahrscheinlichkeitsinformation und zur Einstellung der Pulssequenz umfasst.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

FIG 1

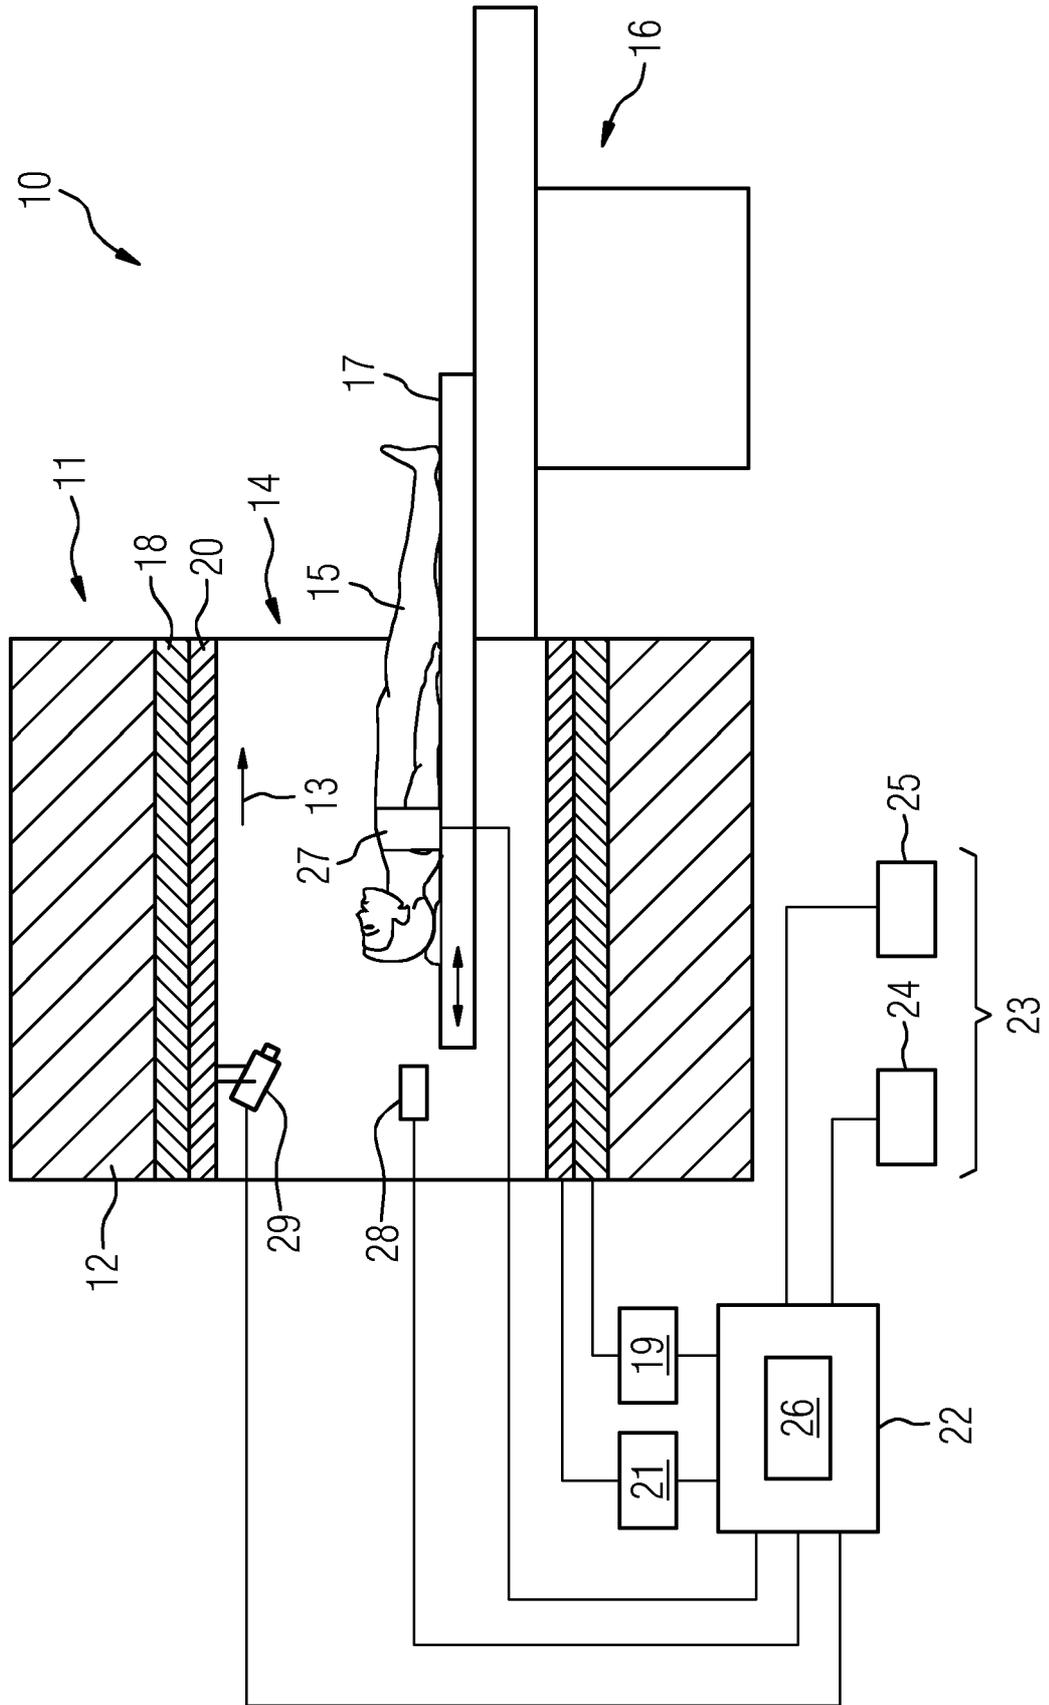


FIG 2

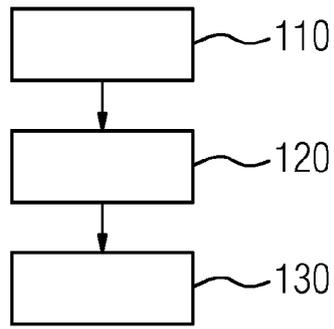


FIG 3

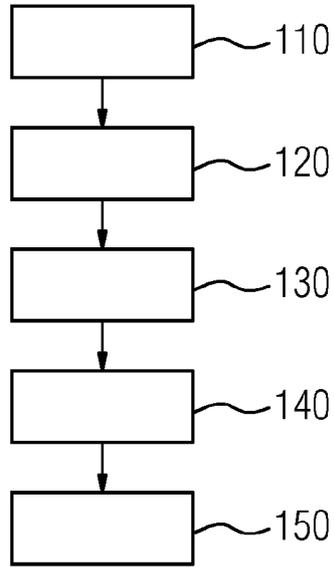


FIG 4

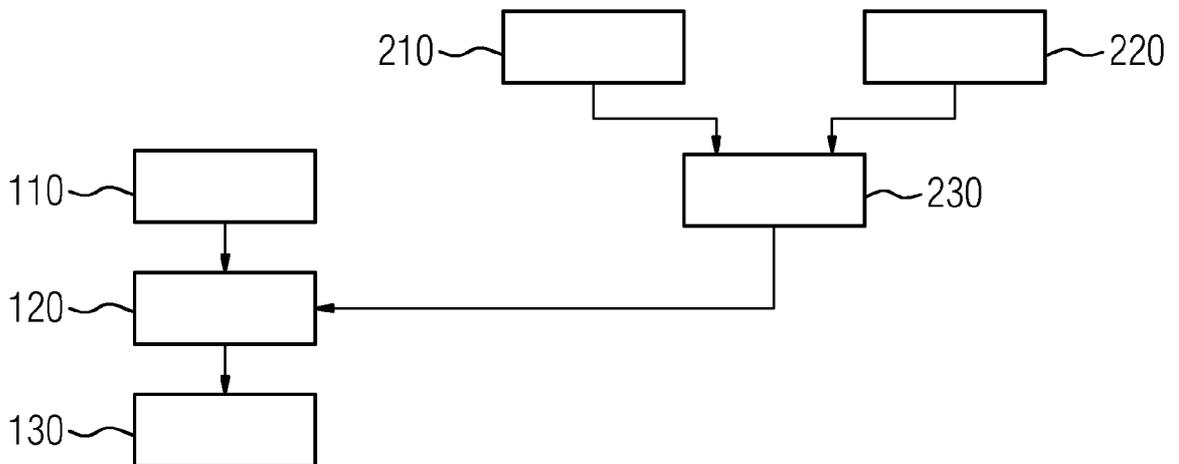


FIG 5

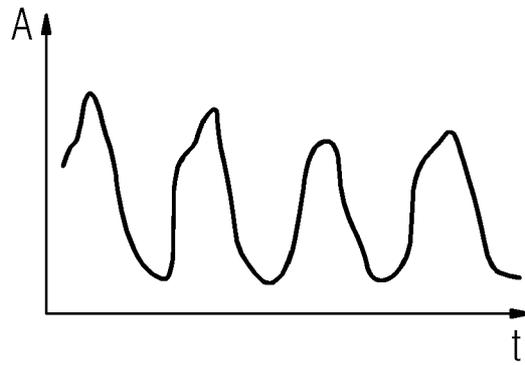


FIG 6

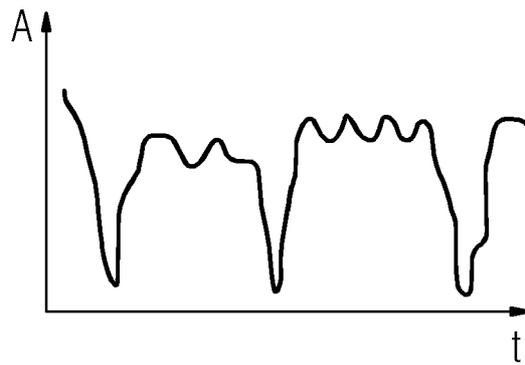


FIG 7

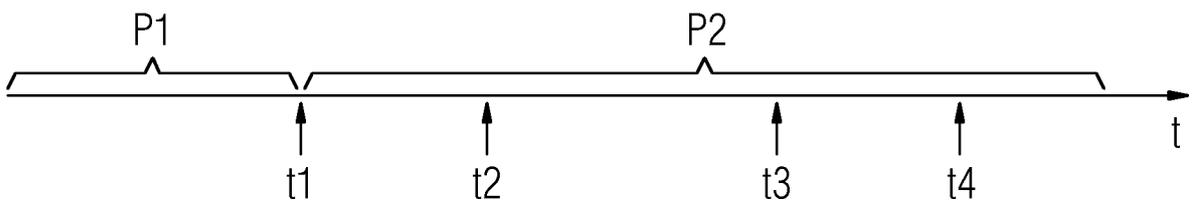


FIG 8


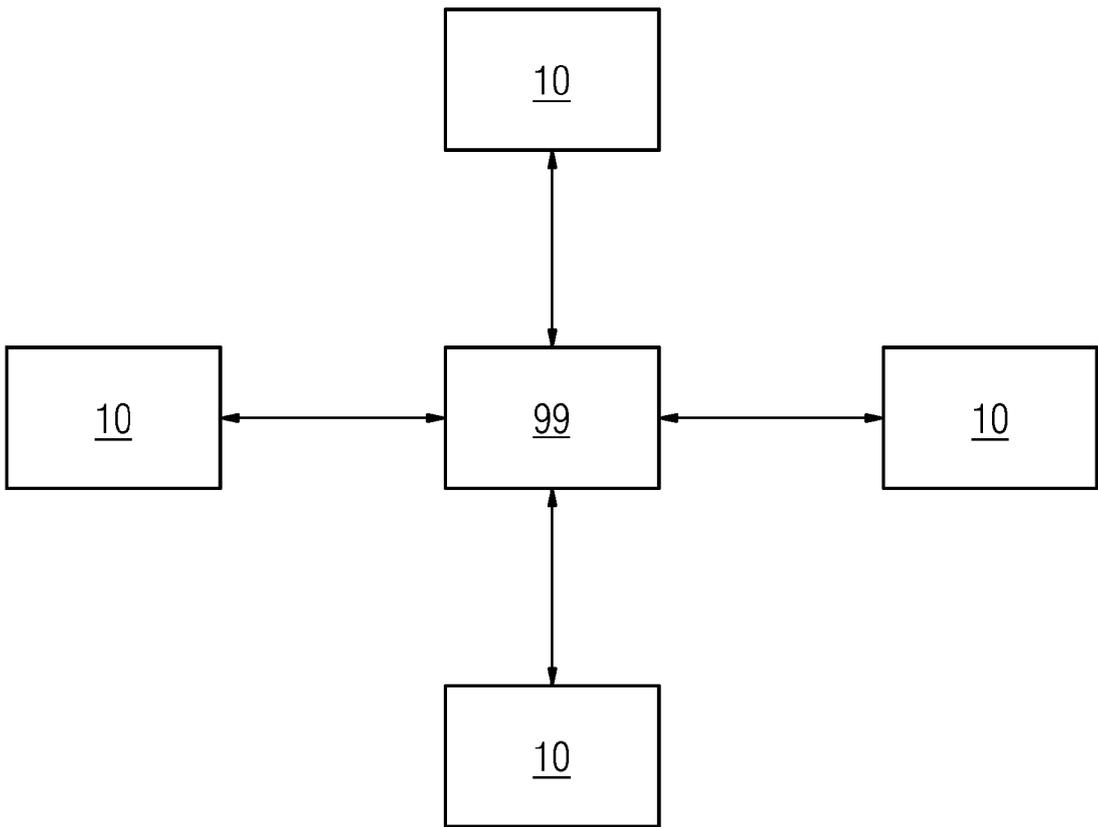


FIG 9



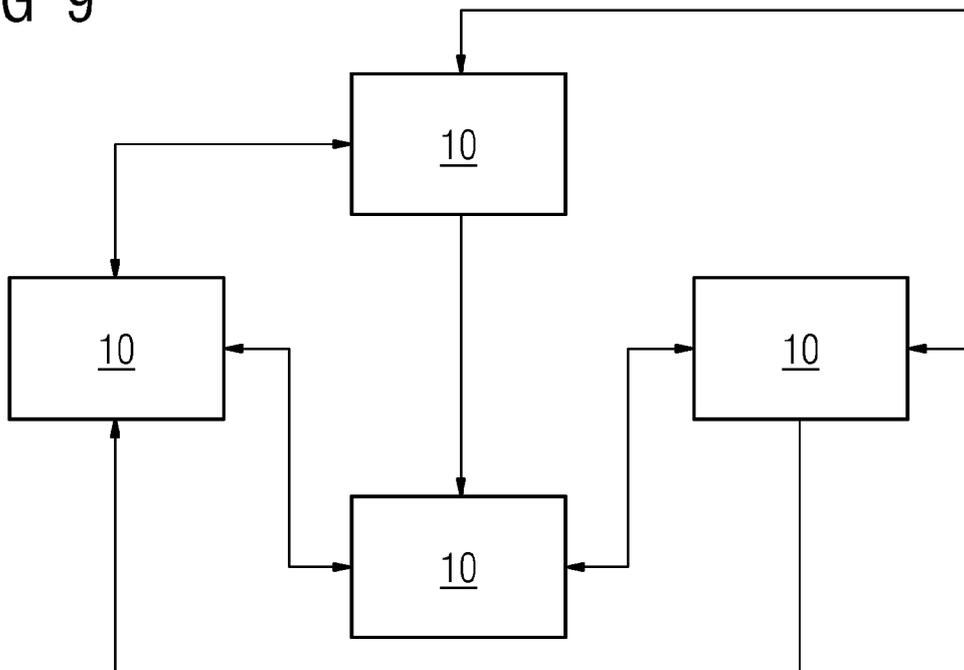

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 18 16 7310

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	US 2015/212182 A1 (NIELSEN TIM [DE] ET AL) 30. Juli 2015 (2015-07-30) * Abbildungen 1,2,3,18,19 * * Absatz [0023] - Absatz [0044] * * Absatz [0073] * * Absatz [0079] * * Absatz [0106] * * Absatz [0113] * * Absatz [0119] - Absatz [0126] * -----	1-18	INV. G01R33/54 G01R33/565 A61B5/00 G05B13/02 A61B5/055
X	US 2016/000383 A1 (LEE MICHAEL CHUN-CHIEH [US] ET AL) 7. Januar 2016 (2016-01-07) * Abbildungen 2,3 * * Absatz [0010] - Absatz [0020] * * Ansprüche 1,5,6 * -----	1-18	
X	US 2010/145182 A1 (SCHMIDT MICHAELA [DE] ET AL) 10. Juni 2010 (2010-06-10) * Abbildung 1 * * Absatz [0013] - Absatz [0023] * * Absatz [0033] - Absatz [0046] * -----	1-4,6-18	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) G01R A61B G05B
2 Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlussdatum der Recherche 16. Oktober 2018	Prüfer Durst, Markus
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 18 16 7310

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

16-10-2018

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2015212182 A1	30-07-2015	BR 112015004651 A2	04-07-2017
		CN 104603630 A	06-05-2015
		EP 2893364 A1	15-07-2015
		JP 5992624 B2	14-09-2016
		JP 2015532610 A	12-11-2015
		RU 2015112295 A	27-10-2016
		US 2015212182 A1	30-07-2015
		WO 2014037868 A1	13-03-2014

US 2016000383 A1	07-01-2016	CN 105142503 A	09-12-2015
		EP 2976000 A1	27-01-2016
		JP 2016514508 A	23-05-2016
		RU 2015144892 A	26-04-2017
		US 2016000383 A1	07-01-2016
		WO 2014147519 A1	25-09-2014

US 2010145182 A1	10-06-2010	DE 102008060719 A1	08-07-2010
		US 2010145182 A1	10-06-2010

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- DE 102006055933 B4 [0004]
- US 9714998 B2 [0004]
- DE 102015203385 B4 [0004]
- US 20110130644 A1 [0005]

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

- **KÜSTNER, THOMAS et al.** Automated reference-free detection of motion artifact in magnetic resonance image. *Magn Reson Mater Phys*, 2017 [0007]
- **KÜSTNER, THOMAS et al.** Automated reference-free detection of motion artifact in magnetic resonance images. *Magn Reson Mater Phys*, 2017 [0050] [0082]

专利名称(译)	使用运动预测调整磁共振脉冲序列		
公开(公告)号	EP3553548A1	公开(公告)日	2019-10-16
申请号	EP2018167310	申请日	2018-04-13
[标]申请(专利权)人(译)	西门子保健有限责任公司		
申请(专利权)人(译)	西门子医疗GMBH		
当前申请(专利权)人(译)	西门子医疗GMBH		
[标]发明人	SPEIER PETER ZELLER MARIO		
发明人	SPEIER, PETER ZELLER, MARIO		
IPC分类号	G01R33/54 G01R33/565 A61B5/00 G05B13/02 A61B5/055		
CPC分类号	A61B5/055 A61B5/113 A61B5/7285 G01R33/543 G01R33/546 G01R33/56509		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及一种用于设置患者的磁共振 (MR) 检查的脉冲序列的方法，一种MR设备 (10) 以及一种计算机程序产品。该方法包括以下步骤：检测取决于患者运动的检查运动信号。基于检查运动信号和确定信息，确定运动概率信息。运动概率信息包括患者未来运动的概率指示。基于运动概率信息，设置脉冲序列。

FIG 1

