

(19)



Europäisches
Patentamt
European
Patent Office
Office européen
des brevets



(11)

EP 1 929 938 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

11.06.2008 Patentblatt 2008/24

(51) Int Cl.:

A61B 5/00 (2006.01)**G01N 27/36** (2006.01)**G01N 27/403** (2006.01)**G01N 33/00** (2006.01)(21) Anmeldenummer: **06125337.3**(22) Anmeldetag: **04.12.2006**

(84) Benannte Vertragsstaaten:


**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI
SK TR**

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL BA HR MK RS(71) Anmelder: **SENTEC AG****4106 Therwil (CH)**(72) Erfinder: **Kleinleugenmors, Adrianus****4144, Hofstetten (CH)**(74) Vertreter: **Dr. Graf & Partner****Intellectual Property,****Postfach 518****8200 Schaffhausen (CH)****(54) Vorrichtung zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid**

(57) Die Vorrichtung (2) zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid, umfassend ein Gehäuse (3) mit einer pH-Glaselektrode (4) sowie einer Referenzelektrode (6), wobei die Referenzelektrode (6) ein mit einem Diaphragma (6d) verschlossenes Schaftglas (6b) umfasst, wobei die pH-Glaselektrode (4) und die Referenz-

elektrode (6) einen Innenelektrolyt (4c, 6c) aufweisen, wobei die pH-Glaselektrode (4) und die Referenzelektrode (6) Elektrodenkontaktierungen (4a, 6a) aufweisen, die das Potential der Elektroden einer Messvorrichtung (13) zuführen, und wobei die Elektrodenkontaktierung (6a) im Innern der Referenzelektrode (6) aus einem mit Silberchlorid beschichteten Silberdraht besteht.

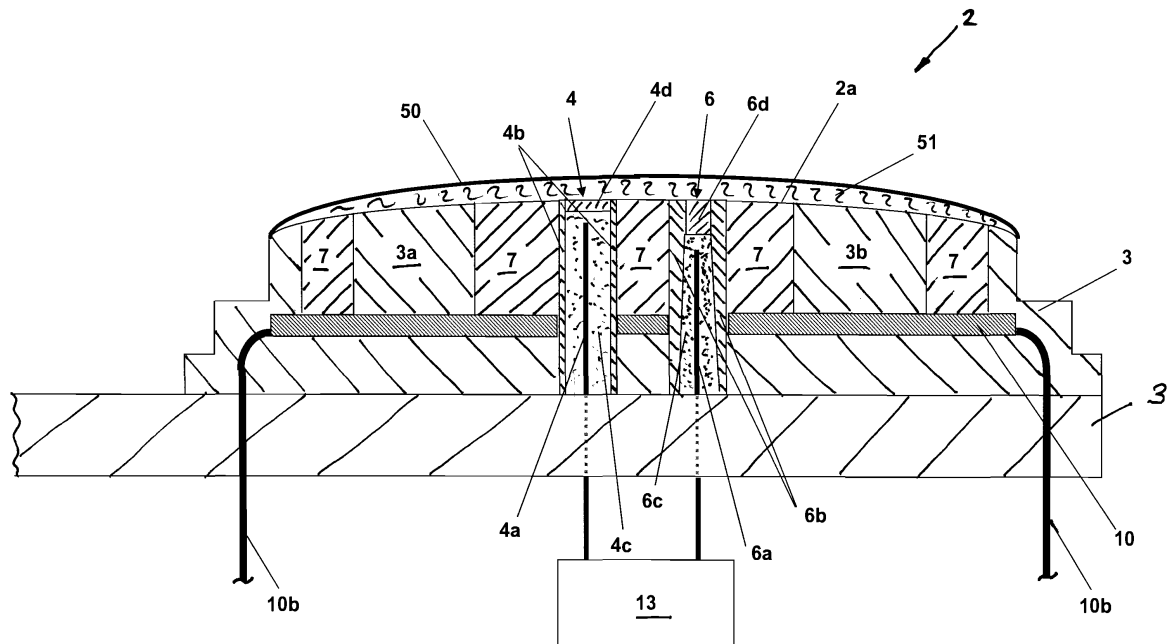**Fig. 2****EP 1 929 938 A1**

Beschreibung


[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid gemäss dem Oberbegriff von Anspruch 1.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt den CO₂-Gehalt des Bluts im menschlichen oder tierischen Körper zu bestimmen, indem mit einem Sensor an der Hautoberfläche der Partialdruck von Kohlendioxid gemessen wird. Grundlegende Arbeiten zu diesem Sensortyp wurden von J.W. Severinghaus geleistet, weshalb ein derartiger Sensor auch als "transkutane CO₂-Sensor nach Severinghaus" bezeichnet wird. Dieser Sensortyp ist beispielsweise im folgenden Artikel im Detail beschrieben: "The current Status of Transcutaneous Blood Gas Analysis and Monitoring", J.W. Severinghaus, BLOOD GAS NEWS, 1998, Vol. 7, No. 2.

[0003] Ein besonderer Vorteil des transkutaten CO₂-Sensors nach Severinghaus ist darin zu sehen, dass die beim Ausatmen auftretenden CO₂-Schwankungen ausgemittelt werden, und dass die Messung wenig stör anfällig ist, weshalb dieser transkutane CO₂-Sensor beispielsweise häufig zur Überwachung von Patienten in Spitälern verwendet wird, um den CO₂-Gehalt im Blut kontinuierlich zu überwachen.

[0004] Der transkutane CO₂-Sensor nach Severinghaus misst die Leitfähigkeitsänderung von Wasser, die sich beim Lösen von Kohlendioxid ergibt. Entsprechend der Gleichung



entstehen beim Lösen von CO₂ in Wasser Ionen, die eine Leitfähigkeitsänderung und eine pH-Änderung des Wassers bewirken. Die Leitfähigkeitsänderung korreliert mit dem jeweiligen Partialdruck von CO₂, so dass die Leitfähigkeitsänderung als Messgrösse für den vorliegenden CO₂-Partialdruck dient. Die Hydrolyse von Kohlendioxid in wässriger Lösung führt, entsprechend der Henderson-Hasselbalch'schen Gleichung

$$\text{pH} = \text{pK} + \log[\text{HCO}_3^- / [\text{CO}_2]] \quad (\text{Gleichung 2})$$

zu einer partialdruckabhängigen pH-Änderung des Elektrolyten.

[0005] Der transkutane CO₂-Partialdruck wird auch als tcpCO₂ bezeichnet.

Darstellung der Erfindung

[0006] Es hat sich gezeigt, dass transkutane CO₂-Sensoren nach Severinghaus ein instabiles Verhalten beziehungsweise ein Driftverhalten aufweisen, was den gemessenen tcpCO₂ -Wert und natürlich auch den daraus abgeleiteten arteriellen CO₂-Wert verfälscht. Beispielsweise hat sich gezeigt, dass transkutane CO₂-Sensoren nach Severinghaus innerhalb eines Zeitintervalls von beispielsweise 8 Stunden ein erhebliches Driftverhalten aufweisen.

[0007] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Vorrichtung zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid zu bilden, welche ein genaueres Messen des Kohlendioxidpartialdrucks erlaubt. Es ist insbesondere Aufgabe der vorliegenden Erfindung einen verbesserten Sensor zur Messung des CO₂-Gehaltes im Blut des menschlichen oder tierischen Körpers vorzuschlagen.

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst mit einer Vorrichtung zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid aufweisend die Merkmale von Anspruch 1. Die Unteransprüche 2 bis 5 betreffen weitere, vorteilhafte Ausgestaltungen.

[0009] Die Aufgabe wird insbesondere gelöst mit einer Vorrichtung zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid, umfassend ein Gehäuse mit einer pH-Glaselektrode sowie einer Referenzelektrode, wobei die Referenzelektrode ein mit einem Diaphragma verschlossenes Schaftglas umfasst, wobei die pH-Glaselektrode und die Referenzelektrode einen Innenelektrolyt aufweisen, wobei die pH-Glaselektrode und die Referenzelektrode Elektrodenkontaktierungen aufweisen, die das Potential der Elektroden einer Messvorrichtung zuführen, und wobei die Elektrodenkontaktierung im Innern der Referenzelektrode und vorzugsweise auch die Elektrodenkontaktierung der pH-Glaselektrode aus einem mit Silberchlorid beschichteten Silberdraht besteht.

[0010] Die erfindungsgemässe Vorrichtung zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid weist den Vorteil auf, dass diese bezüglich störender Einflüsse wesentlich stabiler ist. Wird diese Vorrichtung zur Messung des transkutaten CO₂-Gehaltes verwendet, so ist damit auch ein langfristig genaues Messen des tcpCO₂ -Wertes und des daraus abgeleiteten CO₂-Gehaltes im Blut möglich.

[0011] Die erfindungsgemässe Vorrichtung verzichtet auf die bei einem transkutanen CO₂-Sensor nach Severinghaus übliche Ag/AgCl-Referenzelektrode, welche an der Stirnseite des Sensors angeordnet ist, und üblicherweise als Silberblock ausgestaltet ist. Die erfindungsgemässe Vorrichtung verwendet als Referenzelektrode eine mit einem Diaphragma

versehene Elektrode aus Glas, wobei sich im Inneren der Referenzelektrode ein mit Silberchlorid beschichteter Silberdraht befindet. Diese Anordnung bewirkt, wie in der nachfolgenden Figur 2 im Detail beschrieben, eine wesentliche Verbesserung des Driftverhaltens.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0012] Die zur Erläuterung der Ausführungsbeispiele verwendeten Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen bekannten transkutanen CO₂-Sensor;

Fig. 2 einen Längsschnitt durch ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemässen transkutanen CO₂-Sensors.

Grundsätzlich sind in den Zeichnungen gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Wege zur Ausführung der Erfindung


[0013] Der aus der Druckschrift WO 02/41770 bekannte, in Figur 1 dargestellte Sensor 1 erlaubt eine kombinierte Messung der arteriellen Sauerstoffsättigung SpO₂ und des transkutanen Kohlendioxidpartialdrucks tcpCO₂. Zur Messung der Sauerstoffsättigung weist der Sensor 1 ein Pulsoximetrie-Messsystem auf, welches eine zweifarbige Leuchtdiode 3a sowie einen Fotodetektor 3b umfasst. Der Sensor 1 umfasst zudem einen transkutanen CO₂-Sensor 2 nach Severinghaus zur Messung des transkutanen Kohlendioxidpartialdrucks tcpCO₂. Diese Vorrichtung 2 zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid umfasst, wie für einen transkutanen CO₂-Sensor nach Severinghaus üblich, eine Mikro-pH-Elektrode 4 sowie eine Ag/AgCl-Referenzelektrode 5, wobei diese Referenzelektrode 5 als Silberblock ausgestaltet ist, welcher die Mikro-pH-Elektrode 4 umgibt, und welche zusammen mit der Mikro-pH-Elektrode 4 eine gegen die Elektrolytlösung 51 hin ausgerichtete Stirnfläche 1b bildet. Der transkutane Kohlendioxidpartialdruck wird potentiometrisch gemessen, indem der pH-Wert der Elektrolytlösung 51 gemessen wird, welche über die gut gasdurchlässige, hydrophobe Membran 50 mit der Haut in Verbindung steht. Eine Änderung des CO₂-Wertes an der Hautoberfläche bewirkt, wie mit Gleichung 1 und 2 dargelegt, eine pH-Änderung der Elektrolytlösung 51. Der pH-Wert wird ermittelt indem das Potential zwischen der Mikro-pH-Elektrode 4 und der Ag/AgCl-Referenzelektrode 5 gemessen wird. Die Mikro-pH-Elektrode 4 ist über den elektrischen Innenableiter 4a Signal leitend mit einer Signalmessvorrichtung 13 verbunden.

[0014] Im Zentrum einer kreisförmigen Leiterplatte 10 ist eine als rundes Loch ausgestaltete Durchbrechung 10c ausgespart, durch welche die Vorrichtung 2 zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid, umfassend die Mikro-pH-Elektrode 4 sowie die Ag/AgCl-Bezugselektrode 5, verläuft. Die Mikro-pH-Elektrode 4 ist als Glaselektrode ausgestaltet, und weist einen Innenelektrolyt 4c auf, welcher von einem Schaftglas 4b sowie einem Membranglas 4d umgeben ist. Zwischen der Mikro-pH-Elektrode 4 und der Referenzelektrode 5 ist ein Isolator 45 angeordnet.


[0015] Die Vorrichtung 2 zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid umfasst somit eine pH-Elektrode 4, welche die Messelektrode bildet, sowie eine Silberhülse, einen Silberring oder einen Silberblock, welche die Referenzelektrode 5 bildet. Das Silber ist mit Silberchlorid beschichtet, und die Elektrolytlösung 51 mit einer bekannten Menge Chlorid versehen. Bisher wurde angenommen, dass die Referenzelektrode 5 ein stabiles Verhalten aufweist und somit ein stabiles Referenzsystem bildet. Es hat sich jedoch gezeigt, dass zwischen dem Silberchlorid und dem gemessenen CO₂ eine störende Reaktion auftritt.

[0016] Das CO₂ befindet sich in der Elektrolytlösung 51 in einem Gleichgewichtszustand mit Bikarbonat (HCO₃⁻), wie mit Gleichung 1 dargelegt.

[0017] Da in der Elektrolytlösung 51 Bikarbonat (HCO₃⁻) vorhanden ist, bildet sich mit Wasser eine kleine Menge Karbonat (CO₃²⁻) gemäss folgender Gleichung:



[0018] Das auf der Oberfläche der Referenzelektrode vorhandene Silberchlorid reagiert mit dem Karbonat gemäss der Gleichung



insbesondere da Silberkarbonat unlöslicher ist als Silberchlorid. Das Potential der Ag/AgCl-Referenzelektrode 5 bleibt daher nicht konstant, weshalb eine Änderung der Potentialdifferenz zwischen pH-Elektrode 4 und Referenzelektrode 5 nicht ausschliesslich einer Änderung des Kohlendioxid-Partialdruckes zuzuschreiben ist. Der mit Gleichung 4 dargelegte Zusammenhang stört somit die Stabilität der Referenzelektrode 5, was zu einer Verfälschung der CO₂-Messung führt. Diese Zerstörung des Referenzsystems beziehungsweise des Referenzpotentials wird mit höherer CO₂ Konzentration

zudem noch grösser.

[0019] Das Silberkarbonat ist zudem eine sehr lichtempfindliche Substanz, was bei Lichteinfall zur Folge hat, dass das Silberkarbonat wieder zerfällt, was wiederum eine Verschiebung des Referenzpotentials bewirkt und somit einen instabilen Messwert verursacht.

[0020] Da die Gleichung (4) ein Gleichgewicht darstellt, ist die Bildung von Silberkarbonat abhängig von der CO_2 Konzentration beziehungsweise vom CO_2 Partialdruck. Wird der CO_2 Partialdruck erhöht, wird Silberkarbonat gebildet. Wird daraufhin der CO_2 Partialdruck zu einem tieferen Wert reduziert, so verschiebt sich das Gleichgewicht in die Richtung von Silberchlorid, was bedeutet, dass Silberkarbonat in Silberchlorid umgewandelt wird. In beiden Fällen, das heisst Erhöhung oder Reduzierung der CO_2 Konzentration beziehungsweise des CO_2 Partialdrucks, ist das Potential des Referenzsystems nicht stabil und konstant, was zur Folge hat, dass die CO_2 Konzentration beziehungsweise der CO_2 Partialdruck nicht stabil gemessen werden kann.

[0021] Das Problem des sich verschiebenden Potentials des Referenzsystems wurde erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass in der Vorrichtung 2 zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid eine mit einem Diaphragma versehene Referenzelektrode verwendet wird.

[0022] Figur 2 zeigt in einem Längsschnitt ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemässen Vorrichtung 2 zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid. Die Vorrichtung 2 umfassend, angeordnet in einem Gehäuse 3 und in Kunststoff 7, eine miniaturisierte pH-Glaselektrode 4 mit Innenableiter 4a, Schaftglas 4b, Innenelektrolyt 4c und Membranglas 4d sowie eine separate Referenzelektrode 6 mit Innenableiter 6a, Schaftglas 6b, Innenelektrolyt 6c und Diaphragma 6d. Die Stirnseiten beider Elektroden 4, 6 sind zur Stirnseite 2a des Sensor 2 hin ausgerichtet, sodass die Stirnseiten der Elektroden 4, 6 einen Kontakt zur Elektrolytlösung 51 aufweisen, welche vor dem Gebrauch des Sensors 2 auf die Stirnseite 2a des Sensors 2 aufgetragen wird. Als Diaphragma wird in der Elektrochemie die Trennwand zweier Halbelemente bezeichnet. In der in Figur 2 dargestellten Anordnung trennt das Diaphragma 6d die Elektrolytlösung 51 vom Innenraum der Bezugselektrode 6. Das Diaphragma 6d besteht vorteilhafterweise aus einem keramischen Werkstoff und ist flüssigkeitsdurchlässig. Der Innenableiter 6a ist ein mit Silberchlorid beschichteter Silberdraht. Das Schaftglas 6b ist ein Borosilikatglas, welches für Luft und andere Gase undurchlässig ist. In einer bevorzugten Ausgestaltung wird als Kunststoff 7 ein Werkstoff enthaltend oder bestehend aus einer gut wärmeleitenden Substanz verwendet, was insbesondere dann von Vorteil ist, wenn der Sensor 2 eine Heizung, beispielsweise eine elektrische Heizung, zur Erwärmung aufweist.

[0023] Als Elektrolyt 6c der Bezugselektrode 6 wird vorzugsweise eine Kaliumchloridlösung gewählt. Um ein Verflüchtigen und Auslaufen des Elektrolyts 6c der Bezugselektrode 6 zu verhindern ist der Elektrolyt 6c vorteilhafterweise in ein Polymer eingebettet, beispielsweise in ein Polymerisat oder ein Polyakrylat, so dass ein leitfähiges Gel entsteht. Die Bezugselektrode 6 kann sehr klein ausgestaltet sein, und einen Aussendurchmesser von weniger als 5 mm und vorzugsweise von weniger als 2 mm aufweisen.

[0024] Während der Verwendung der Vorrichtung 2 zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid wird dessen Stirnseite, wie in Figur 2 dargestellt, mit einer Elektrolytlösung 51 versehen, welche von einer gasdurchlässigen, und vorzugsweise wasserundurchlässigen Membran 50 bedeckt ist. Ausserhalb der Membran 50 befindet sich das Messgut. Die Membran 50 trennt somit die Elektrolytlösung 51 vom Messgut. Eine ideale Membran 50 wäre nur CO_2 -durchlässig.

[0025] Idealerweise wird die Elektrolytlösung 51 durch das Messgut nicht verändert. Als gasdurchlässige Membran 50 eignen sich Materialien wie beispielsweise Polyäthylen (PE), Polypropylen (PP) oder Polytetrafluoräthylen (PTFE).

[0026] Im Unterschied zu dem in Figur 1 dargestellten Sensor 1 weist der in Figur 2 dargestellte, erfindungsgemässe Sensor 2 kein Silberteil beziehungsweise keine Referenzelektrode aus Silber, beschichtet mit Silberchlorid auf, sodass die Kontaktfläche 2a des Sensor 2 kein Silberchlorid aufweist, welches direkt mit der Elektrolytlösung 51 in Kontakt treten könnte. Die beiden Elektroden 4, 6 sind vorzugsweise, wie in Figur 2 dargestellt, in einem Kunststoff 7 eingebettet, und durch diesen vorzugsweise auch gegenseitig gehalten.

[0027] Der in Figur 2 dargestellte, erfindungsgemässe Sensor 2 wird vorzugsweise zum Messen des CO_2 -Gehaltes im Blut des menschlichen Körpers verwendet, indem der Sensor 2 auf die Haut aufgelegt wird, und derart nichtinvasiv und vorzugsweise kontinuierlich der CO_2 -Gehalt im Blut gemessen wird. Dieser Sensor 2 weist vorzugsweise eine Heizung auf, um die Hautoberfläche zu erwärmen, wobei vorzugsweise ein Wärme leitender Kunststoff 7 verwendet wird, in welchem die Elektroden 4, 6 angeordnet sind.


[0028] Die Innenableiter 4a, 6a können beispielsweise mit einer analogen oder einer digitalen Signalmessvorrichtung 13 verbunden sein. Der erfindungsgemässe CO_2 -Sensor könnte beispielsweise in einem wie in Figur 1 dargestellten Multifunktionsensor angeordnet sein, welcher noch weitere Sensoren umfasst, wie den in Figur 1 dargestellten Sensor zum Erfassen der arteriellen Sauerstoffsättigung des Blutes beziehungsweise den transkutanen O_2 -Gehalt.

[0029] Der erfindungsgemässe CO_2 -Sensor erlaubt den CO_2 -Gehalt von einer Vielzahl von Messgütern zu bestimmen, indem das Messgut mit der Membran 50 in Kontakt gebracht wird. Beispielsweise könnte der CO_2 -Gehalt des Blutes auch ausserhalb des Körpers derart gemessen werden, indem ein Blutstrom an der Membran 50 vorbeigeleitet wird, zum Beispiel der Blutstrom einer Herz-Kreislaufmaschine, sodass der CO_2 -Gehalt dieses extrakorporalen Blutstromes messbar ist. Anstelle von Blut könnte an der Membran 50 auch ein anderes Fluid, beispielsweise eine Flüssigkeit wie

Bier, oder ein gasförmiger Stoff wie Luft, vorbeigeleitet werden, um den CO₂-Gehalt dieses Medium zu messen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (2) zur Messung des Partialdrucks von Kohlendioxid, umfassend ein Gehäuse (3) mit einer pH-Glaselektrode (4) sowie einer Referenzelektrode (6), wobei die Referenzelektrode (6) ein mit einem Diaphragma (6d) verschlossenes Schaftglas (6b) umfasst, wobei die pH-Glaselektrode (4) und die Referenzelektrode (6) einen Innenelektrolyt (4c, 6c) aufweisen, wobei die pH-Glaselektrode (4) und die Referenzelektrode (6) Elektrodenkontaktierungen (4a, 6a) aufweisen, die das Potential der Elektroden einer Messvorrichtung (13) zuführen, und wobei die Elektrodenkontaktierung (6a) im Innern der Referenzelektrode (6) und vorzugsweise auch die Elektrodenkontaktierung (4a) der pH-Glaselektrode (4) aus einem mit Silberchlorid beschichteten Silberdraht besteht.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** diese eine Kontaktfläche (2a) ohne Silber oder Silberchlorid aufweist.
3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** das Diaphragma (6d) aus einem keramischen Werkstoff besteht.
4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Innenelektrolyt (6c) der Referenzelektrode (6) Kaliumchlorid enthält.
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Innenelektrolyt (6c) in einem Polymer eingebettet ist.
6. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Messung des transkutanen Kohlendioxidpartialdrucks tcpCO₂.
7. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 zur Messung des Kohlendioxidpartialdruck in einem extrakorporalen Blutstrom.
8. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 in einem Sensor zur Messung einer Mehrzahl physiologischer Parameter.

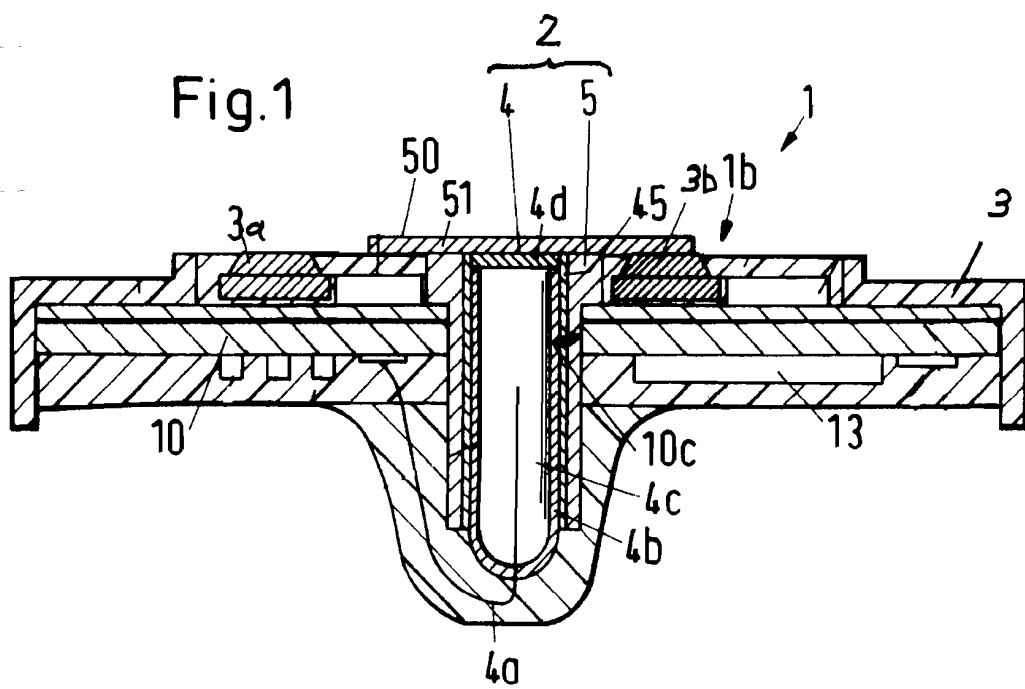

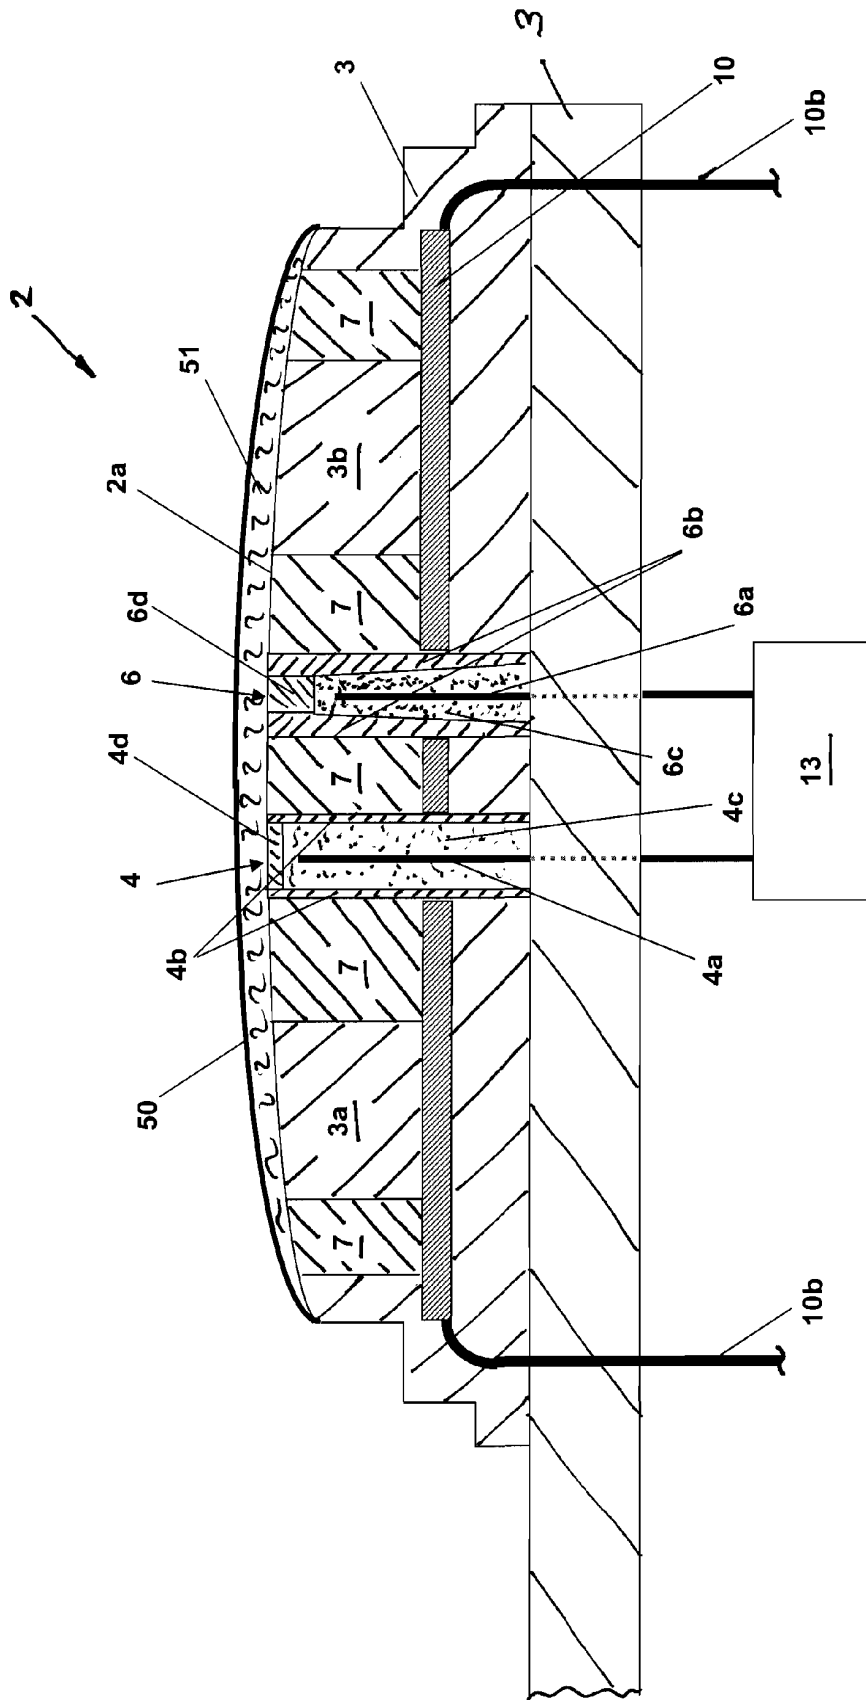


Fig. 2



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 06 12 5337

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	WO 85/04482 A (UNIV STRATHCLYDE [GB]) 10. Oktober 1985 (1985-10-10) * Seite 4, Zeile 14 - Seite 6, Zeile 6 *	1-5	INV. A61B5/00 G01N27/36 G01N27/403 G01N33/00
X	EP 1 164 372 A (SENS INC I [KR]) 19. Dezember 2001 (2001-12-19) * Zusammenfassung; Abbildung 3a *	1	
A	-----	2-8	
X	INGHAM ET AL: "Measurement of pO ₂ , pCO ₂ , pH, pulse oximetry and capnography" ANESTHESIA AND INTENSIVE CARE MEDICINE, Bd. 6, Nr. 12, 1. Dezember 2005 (2005-12-01), Seiten 413-415, XP005770399 * Seiten 413,414; Abbildung 2 *	1-8	
D,Y	WO 02/41770 A (SENTEC AG [CH]; TSCHUPP ANDRES [CH]; LANG JOSEPH [FR]; ROOST MATTHIAS) 30. Mai 2002 (2002-05-30) * Seite 8, Zeile 24 - Seite 12, Zeile 10; Abbildung 1 *	1-8	
Y	US 5 071 537 A (YAMAGUCHI SHUICHIRO [JP] ET AL) 10. Dezember 1991 (1991-12-10) * Spalte 1, Zeilen 22-42 * * Spalte 1, Zeile 58 - Spalte 2, Zeile 16 * * Spalte 4, Zeile 19 - Spalte 5, Zeile 6 *	1-8	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
A	US 2002/070112 A1 (LEE DONG KWON [KR] ET AL) 13. Juni 2002 (2002-06-13) * das ganze Dokument *	1-8	A61B G01N
A	CH 690 061 A5 (LINDE MEDICAL SENSORS AG [CH]) 14. April 2000 (2000-04-14) * Zusammenfassung; Abbildung 1B *	1-8	
		-/--	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 4. Mai 2007	Prüfer Stussi, Elisa
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

 2
EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 06 12 5337

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
A	DE 30 24 203 A1 (HELLIGE GMBH [DE]) 28. Januar 1982 (1982-01-28) * das ganze Dokument *	1-8	
A	WO 90/04777 A (HARNONCOURT KARL [AT]) 3. Mai 1990 (1990-05-03) * Seite 9; Abbildung 4 *	1-8	
D,A	J. W. SEVERINGHAUS: "The current status of transcutaneous blood gas analysis and monitoring" BLOOD GAS NEWS, Bd. 7, Nr. 2, 1998, Seiten 4-9, XP009083178 * das ganze Dokument *	1-8	
			RECHERCHIerte SACHGEBIETE (IPC)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 4. Mai 2007	Prüfer Stussi, Elisa
KATEGORIE DER GENANNTE DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mchtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

2
EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 06 12 5337

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

04-05-2007

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 8504482 A	10-10-1985	EP 0175732 A1	02-04-1986
EP 1164372 A	19-12-2001	US 2002011408 A1	31-01-2002
WO 0241770 A	30-05-2002	AU 2335202 A	03-06-2002
		CA 2466105 A1	30-05-2002
		EP 1335666 A1	20-08-2003
		JP 2004515274 T	27-05-2004
US 5071537 A	10-12-1991	AU 596860 B2	17-05-1990
		AU 7690987 A	10-02-1988
		CA 1324418 C	16-11-1993
		DE 3789898 D1	30-06-1994
		DE 3789898 T2	08-09-1994
		DK 126388 A	10-05-1988
		EP 0313657 A1	03-05-1989
		ES 2005903 A6	01-04-1989
		FI 890099 A	09-01-1989
		WO 8800700 A1	28-01-1988
US 2002070112 A1	13-06-2002	KR 20020030638 A	25-04-2002
CH 690061 A5	14-04-2000	CA 2290083 A1	19-05-2001
		US 6654622 B1	25-11-2003
DE 3024203 A1	28-01-1982	CH 653236 A5	31-12-1985
		JP 1415789 C	10-12-1987
		JP 57031845 A	20-02-1982
		JP 62020813 B	08-05-1987
WO 9004777 A	03-05-1990	AT 392848 B	25-06-1991
		AT 264988 A	15-11-1990
		EP 0394411 A1	31-10-1990

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- WO 0241770 A [0013]

In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur

- **J.W. SEVERINGHAUS.** The current Status of Transcutaneous Blood Gas Analysis and Monitoring. *BLOOD GAS NEWS*, 1998, vol. 7 (2 [0002]

专利名称(译)	用于测量二氧化碳分压的装置		
公开(公告)号	EP1929938A1	公开(公告)日	2008-06-11
申请号	EP2006125337	申请日	2006-12-04
[标]申请(专利权)人(译)	森泰克有限公司		
申请(专利权)人(译)	SENTEC AG		
当前申请(专利权)人(译)	SENTEC AG		
[标]发明人	KLEINLEUGENMORS ADRIANUS		
发明人	KLEINLEUGENMORS, ADRIANUS		
IPC分类号	A61B5/00 G01N27/36 G01N27/403 G01N33/00		
CPC分类号	A61B5/14542 A61B5/14539 A61B5/1477 G01N27/4035		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

装置 (2) 具有壳体 (3)，壳体 (3) 具有玻璃pH电极 (4) 和参比电极 (6)。电极 (6) 具有柄玻璃 (6b)，其由隔膜 (6d) 封闭。电极 (4,6) 具有内部电解质 (4c, 6c)。电极 (4,6) 具有电极触点 (4a, 6a)，其将电极的电位提供给测量装置。参比电极内部的电极触点 (6a) 由涂有氯化银的银线组成。

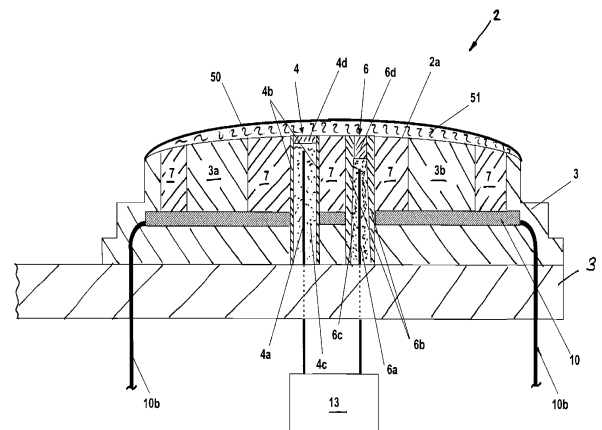


Fig. 2