



(11)

**EP 2 762 061 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
**06.08.2014 Patentblatt 2014/32**

(51) Int Cl.:  
**A61B 5/00 (2006.01)** **A61B 5/053 (2006.01)**  
**A61B 5/08 (2006.01)**

(21) Anmeldenummer: **14151412.5**

(22) Anmeldetag: **16.01.2014**

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**BA ME**

(30) Priorität: **05.02.2013 DE 102013201804**  
**10.07.2013 DE 102013213526**

(71) Anmelder: **Dräger Medical GmbH**  
**23558 Lübeck (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Gärber, Yvo**  
**23881 Breitenfelde (DE)**  
• **Stenqvist, Ola**  
**26040 Viken (SE)**

(74) Vertreter: **UEXKÜLL & STOLBERG**  
**Patentanwälte**  
**Beselerstrasse 4**  
**22607 Hamburg (DE)**

(54) **Elektroimpedanztomographie-Gerät und -Verfahren**

(57) Elektroimpedanztomographie-Gerät mit einer Mehrzahl von Thorax-Elektroden, einer Steuer- und Auswerteeinheit, die dazu eingerichtet ist, Wechselstrom oder -spannung über mindestens ein Elektrodenpaar einzuspeisen und mit mehreren der übrigen Elektrodenpaaren jeweils ein Spannungs- oder Stromsignal als Messsignal aufzunehmen und daraus eine Matrix aus Bildelementen zu rekonstruieren, wobei die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet ist, eine Zeitreihe des globalen Ventilationsverlaufs aus der Folge der rekonstruierten Matrizen als Zeitreihe der mittleren Impedanzänderung oder als eine Zeitreihe eines gemessenen Beatmungsvolumens zu bestimmen, eine Inspirations- oder Expirationsphase im globalen Ventilationsverlauf in eine Anzahl ( $1, 2, \dots, M_{steps}$ ) von Schritten gleicher Volumenänderung zu unterteilen, die diesen Schritten entsprechenden Zeitpunkte in der Inspirations- oder Expirationsphase zu bestimmen, für jedes Bildelement die Änderung der lokalen Impedanz zwischen diesen Zeitpunkten zu bestimmen und jeweils das Verhältnis von dieser lokalen Änderung der Impedanz zur globalen gleichen Volumenänderung zu bestimmen, um so eine lokale Folge von relativen Impedanzänderungen des Bildelements als Funktion der Schritte gleicher Volumenänderung zu bilden, für jede lokale Folge ein für deren Verlauf als Funktion der Schritte gleicher Volumenänderung charakteristisches skalares Maß zu bestimmen und jedes Bildelement in von dem skalaren Maß abhängiger Weise auf der Anzeigeeinrichtung zur Anzeige zu bringen.

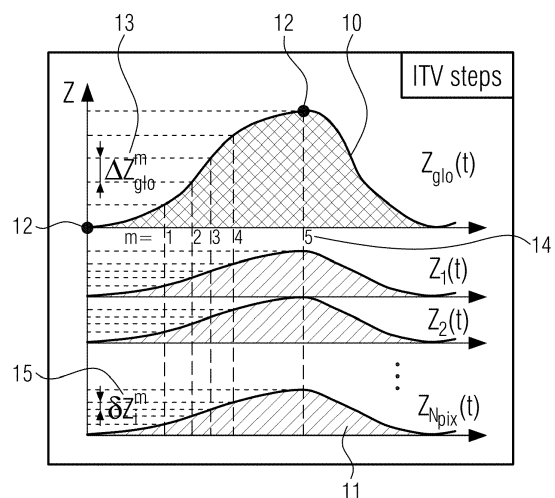


FIG. 2

**Beschreibung**

**[0001]** Die vorliegende Erfindung betrifft ein Elektroimpedanztomographie-Gerät mit: einer Mehrzahl von um den Thorax eines Patienten anbringbaren Elektroden, einer Steuer- und Auswerteeinheit, die durch Programmierung dazu eingerichtet ist, mindestens ein Elektrodenpaar als einspeisendes Elektrodenpaar mit einem Wechselstrom oder mit einer Wechselspannung zu versorgen, mit mehreren der übrigen Elektrodenpaare jeweils ein Spannungssignal oder Stromsignal als Messsignal aufzunehmen, sukzessive andere Elektrodenpaare als einspeisende Elektrodenpaare fungieren zu lassen, um aus den Messsignalen mit einem Rekonstruktionsalgorithmus eine Matrix aus Bildelementen zu rekonstruieren, die die Verteilung der Impedanzänderungen in der Elektrodenebene repräsentiert, und über einen Atemzug wiederholt Messsignale aufzunehmen und Matrizen zu rekonstruieren.

**[0002]** Ein derartiges Elektroimpedanztomographie-Gerät (EIT-Gerät) ist zum Beispiel aus EP 1 000 580 A1 bekannt, das zur Aufnahme eines "Elektroimpedanztomographiebildes" eines Thoraxquerschnitts eines Patienten dient.

**[0003]** Die elektrische Impedanztomographie ist ein Verfahren zur Rekonstruktion von Impedanzverteilungen, genauer gesagt von Impedanzänderungen bezüglich einer Referenzverteilung, in elektrisch leitfähigen Körpern. Hierzu wird an der Oberfläche des zu untersuchenden Körpers eine Vielzahl von Elektroden angebracht. In typischen Fällen wird eine ringförmige äquidistante Anordnung von 16 Elektroden verwendet, die mit einem Gurt um den Thorax eines Patienten gelegt werden können. Die Steuer- und Auswerteeinheit verfügt auch über analoge elektrische Schaltungen für die Signalverstärkung und für die Wechselstromeinspeisung und über elektronische Schaltungen zur Digitalisierung und Vorverarbeitung der Spannungssignale und über einen digitalen Signalprozessor zum Steuern des Gerätes und zur Verarbeitung der aufgenommenen Daten zur Rekonstruktion der Impedanzverteilung. Die Steuer- und Auswerteeinheit sorgt dafür, dass aufeinanderfolgend jeweils ein Paar (vorzugsweise) benachbarter Elektroden mit einem elektrischen Wechselstrom versorgt wird (z.B. 5 mA bei 50 kHz) und die elektrischen Spannungen an mehreren verbleibenden Elektrodenpaaren von der Steuer- und Auswerteeinheit erfasst werden (Grundsätzlich kann auch umgekehrt eine Wechselspannung an ein Elektrodenpaar eingespeist und die Wechselströme über mehrere verbleibende Elektrodenpaare gemessen werden); typischerweise werden die Spannungen aller verbleibenden Paare von benachbarten Elektroden erfasst, grundsätzlich ist es aber auch möglich, einzelne Elektroden auszulassen, wodurch allerdings Informationen verloren gehen. Aus der Gesamtheit aller Messsignale bei den aufeinanderfolgenden Stromeinspeisungen, bei denen Position des einspeisenden Elektrodenpaars Schritt für Schritt um den Elektrodenring wandert, kann mit Algorithmen die Impedanzverteilung, genauer gesagt deren Änderung der Impedanz gegenüber einer Referenzverteilung (z.B. die Impedanzverteilung bei der ersten Aufnahme), rekonstruiert werden. Die bekannten Algorithmen liefern als Rekonstruktionsergebnis eine Matrix aus 32x32 Bildelementen, wobei die Matrix für jedes Bildelement die rekonstruierte Impedanzänderung für dieses Bildelement enthält. Es wird während jedes Atemzugs eine Vielzahl von solchen Matrizen in vorgegebenen zeitlichen Abständen aufgenommen. Diese werden aufeinanderfolgend auf einer Anzeige zur Anzeige gebracht, wodurch der intratidale zeitliche Verlauf der Impedanzverteilung praktisch als Film sichtbar gemacht wird.

**[0004]** Die Thorax-Elektroimpedanztomographie zur Messung der regionalen Lungenventilation findet zunehmende Verbreitung in der forschungsinteressierten Intensivmedizin. Theoretische Modelle und experimentelle Vergleiche von EIT- mit CT-Aufnahmen des Thorax zeigen eine nahezu vollständige Proportionalität von Luftgehalt des Lungengewebes und dessen Impedanz. Die Atemzüge werden räumlich mit etwa 20% des Thoraxdurchmessers und zeitlich typischerweise mit etwa 20 bis etwa 40 Matrizen pro Sekunde aufgelöst, was ein bettseitiges Monitoring der regionalen Lungenventilation ermöglicht. Die Matrizen werden gelegentlich auch als Bilder der Impedanzverteilung (mit 32x32 = 1024 Bildelementen) oder als Frames bezeichnet.

**[0005]** Es wird also für jedes Bildelement über eine Inspirations- oder Expirationsphase eine Folge von Impedanzänderungen bestimmt, die hier auch als Zeitreihe von Impedanzänderungswerten für dieses Bildelement bezeichnet wird. Im Folgenden werden die Begriffe Zeitreihen von Impedanzänderungswerten und Impedanzänderungskurven mit gleicher Bedeutung verwendet, obwohl eine Zeitreihe aus diskreten Punkten im strengen Sinne keine Kurve ist. Auch in den Darstellungen werden die Zeitreihen aus Darstellungsgründen in Kurvenform als Funktionen der Zeit dargestellt.

**[0006]** Ein wesentlicher Vorteil der hohen Frame-Rate besteht darin, dass die Atemzüge, insbesondere deren Inspirations- und Expirationsphase, zeitlich aufgelöst werden können. Es ist daher nicht nur möglich, die regionale Verteilung der ventilierten Luft am end-inspiratorischen Zustand (Tidal-Bild) zu analysieren, sondern auch das zeitliche Verhalten während der Inspiration und Expiration zu untersuchen, um daraus Rückschlüsse über regionale lungenmechanische Abläufe zu gewinnen. So werden zum Beispiel in dem Artikel "Regional ventilation delay index: detection of tidal recruitment using electric impedance tomography", T. Muders et al, Vincent JL, editor, Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine, lokale Inspirationskurven bestimmt und für jede lokale Inspirationskurve jeweils die Zeit, zu der sie 40% ihres Maximalwertes erreicht hat, ins Verhältnis zur globalen Inspirationszeit gesetzt und daraus ein Bild von schnelleren oder langsameren Regionen mit kleineren oder größeren Zeitkonstanten als im Durchschnitt generiert. Daraus wird ein "Regional ventilation delay-index (RVD) als Maß für die zeitliche Inhomogenität definiert.

**[0007]** In EP 2 228 009 A1 wird einen Schritt weitergegangen und die globale Inspirations- oder Expirationsphase in mehrere äquidistante Volumenschritte unterteilt und die intratidalen Variationen (ITV), also die Umverteilung der

ventilierten Teilvolumina pro Volumenschritt, in sogenannten "regions of interest" (ROI) bestimmt, die eine definierte Anzahl von Bildelementen umfassen. Das Ergebnis wird dann in für die ROIs spezifischen Kurven über die äquidistanten Volumenschritte oder daran gekoppelte Größen dargestellt. So wird ermittelt, welche Lungengebiete zu welchem Zeitpunkt der In- oder Expiration mehr oder weniger Luft erhalten als die anderen Gebiete. Im idealen zeitlich homogenen Fall bleibt alles konstant. Bei zeitlich inhomogenen Lungen kommt es dagegen zu Umverteilungen. Der Vorteil der höheren Unterteilung der Respirationsflanken des ITV im Vergleich zum Betrachten des einen 40% Schwellenwertes beim RVD wird dadurch bezahlt, dass man Kurven über räumlich gröbere ROIs betrachtet und kein visuell einfach zugängliches Bild wie beim RVD zur Verfügung hat, sondern Kurven. Zudem können durch ungünstige Wahl der ROIs unter Umständen zeitliche Inhomogenitäten übersehen werden. Des Weiteren wird kein globaler ITV-Parameter analog dem RVD-Index definiert, der auf einen Blick verrät, ob Umverteilungen vorliegen.

**[0008]** Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Elektroimpedanztomographie-Gerät und ein entsprechendes Verfahren anzugeben, mit denen intratidale Umverteilungen lokal erfasst und ein als Bild kodiertes Umverteilungsmaß zur schnellen visuellen Erfassbarkeit der lokalen intratidalen Umverteilungen angezeigt werden können.

**[0009]** Zur Lösung dieser Aufgabe dient das Elektroimpedanztomographie-Gerät mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 sowie das Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 11. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen aufgeführt.

**[0010]** Erfindungsgemäß ist die Steuer- und Auswerteeinheit des EIT-Geräts dazu eingerichtet, eine Zeitreihe des globalen Ventilationsverlaufs aus der Folge der rekonstruierten Matrizen als Zeitreihe der mittleren Impedanzänderung oder als eine Zeitreihe eines gemessenen Beatmungsvolumens zu bestimmen und darin eine Inspirations- oder Expirationsphase zu bestimmen. Es ist weiter vorgesehen, die Inspirations- oder Expirationsphase in dem globalen Ventilationsverlauf in eine Anzahl ( $1, 2, \dots, M_{\text{steps}}$ ) von Schritten gleicher Volumenänderung zu unterteilen und die diesen Schritten gleicher Volumenänderung entsprechenden Zeitpunkte in der Inspirations- oder Expirationsphase zu bestimmen. Die Steuer- und Auswerteeinheit ist weiter dazu eingerichtet, für jedes Bildelement zu den bestimmten Zeitpunkten jeweils das Verhältnis aus Impedanzänderung des Bildelements zum globalen Ventilationsverlauf zu bestimmen, um so eine lokale Folge der relativen Impedanzänderung des Bildelements als Funktion der Schritte gleicher Volumenänderung zu bilden. Es ist ferner vorgesehen, für jede lokale Folge der relativen Impedanzänderung des Bildelements als Funktion der Schritte gleicher Volumenänderung ein für deren Verlauf über die Inspirations- oder Expirationsphase charakteristisches skalares Maß zu bestimmen und jedes Bildelement in von dem jeweiligen skalaren Maß abhängiger Weise auf der Anzeigeeinrichtung zur Anzeige zu bringen.

**[0011]** Die Inspirations- oder Expirationsphase in dem globalen Ventilationsverlauf wird in eine Anzahl von Schritten ( $1, 2, \dots, M_{\text{steps}}$ ) gleicher Volumenänderung  $\Delta V$  unterteilt, die diesen Schritten gleicher Volumenänderung entsprechenden Zeitpunkte in der Inspirations- oder Expirationsphase werden bestimmt und dann für jedes Bildelement zu den bestimmten Zeitpunkten jeweils das Verhältnis aus lokaler Impedanzänderung des Bildelements zum globalen Ventilationsverlauf bestimmt. Diese Folge von Verhältniswerten wird dann als Funktion der Volumenänderungsschritte ( $1, 2, \dots, M_{\text{steps}}$ ) aufgefasst und ausgewertet, um das skalare Maß für den lokalen Verlauf der Ventilation in jedem Bildelement über die Inspirations- oder Expirationsphase zu bestimmen. Praktisch wird diese Volumenänderung  $\Delta V$  pro Schritt bestimmt, indem die gesamte Volumenänderung über die Inspirations- oder Expirationsphase durch die vorgegebene Anzahl von Schritten  $M_{\text{steps}}$  geteilt wird. In den Ausführungsbeispielen werden z.B. 8 Schritte verwendet. Das Auswerten der lokalen Zeitreihen bei gleichen Volumenänderungsschritten  $\Delta V$  des globalen Ventilationsverlaufs bedeutet praktisch, dass man den lokalen Verlauf der Ventilationsänderung als Funktion des globalen Ventilationsverlaufs aufträgt, d.h. die x-Achse mit den Schritten ( $1, 2, \dots, M_{\text{steps}}$ ) entspricht den äquidistanten  $\Delta V$ -Schritten des ansteigenden globalen Ventilationsvolumens bis zum gesamten Inspirationsvolumen und die y-Achse dem Verhältnis aus lokalem variablen Ventilationsänderungsverlauf zur globalen Ventilationsänderung  $\Delta V$ .

**[0012]** Im weiteren werden folgende Begriffe als Abkürzung verwendet:

- Die relative Änderung zwischen den Schritten  $m$  und  $m+1$  der Zeitreihe der lokalen Impedanzänderung eines Bildelementes zum globalen Volumen bzw. Impedanzänderungsschritt  $\Delta V$  bzw.  $\Delta Z_{\text{glo}}$  für einen der  $m=1, 2, \dots, M_{\text{steps}}$  Schritte wird als ( $m$ -ter) lokaler ITV-Wert des Bildelementes bezeichnet (ITV: intratidale-Verteilung).
- Die von  $m=1$  bis  $M_{\text{steps}}$  geordneten Wertepaare ( $m=1$ , erster ITV-Wert) ... ( $m=M_{\text{steps}}$ ,  $M_{\text{steps}}$ -ter ITV-Wert) aller lokaler ITV-Werte wird als lokale ITV-Kurve des Bildelementes bezeichnet. Die ITV-Kurven sind somit eine Funktion der ITV-Werte in Abhängigkeit der  $m=1 \dots M_{\text{steps}}$  Schritte.
- Das skalare Maß der lokalen ITV-Kurve eines Bildelementes wird auch als lokaler ITU-Wert des Bildelementes bezeichnet (ITU: intratidale Umverteilung).

**[0013]** In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die Steuer- und Auswerteeinheit dazu eingerichtet, als skalares Maß der ITV-Kurven der Inspirations- oder Expirationsphase deren mittlere gegebenenfalls mit der Anzahl der Schritte  $M_{\text{steps}}$  multiplizierten Steigung, deren Standardabweichung, Maximalwerte der Beträge der lokalen ITV-Werte innerhalb der Inspirations- oder Expirationsphase oder die maximale Änderung der lokalen ITV-Werte innerhalb der Inspirations-

oder Expirationsphase oder Nullstellen zu bestimmen. Es ist ohne weiteres ersichtlich, dass zum Beispiel die mittlere Steigung oder die Standardabweichung der ITV-Kurven über die Inspirations- oder Expirationsphase wesentliche Informationen über den zeitlichen Verlauf der Ventilation in dem lokalen Lungenelement geben. Maximalwerte der Beträge der ITV-Werte innerhalb der Inspirations- oder Expirationsphase enthalten Informationen, ob in dem zeitlichen Verlauf Sprünge in der Ventilationskurve vorhanden sind, die sich nämlich in dem Betrag nach hohen (positiven oder negativen) lokalen Steigungen im Bereich eines Sprungs zeigen. Die maximale Änderung der ITV-Werte innerhalb der Inspirations- oder Expirationsphase enthält Informationen darüber, ob es im lokalen Ventilationsverlauf zu plötzlichen sehr großen Änderungen kommt. Nullstellen der interpolierten ITV-Kurve im Bereich des tidalen Hubes zwischen Expiration und Inspiration können auf tidales Recruitment oder Überdehnung hinweisen.

**[0014]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet, in einer Inspirations- oder Expirationsphase für jedes Bildelement an die ITV-Kurven eine Gerade anzupassen und neben deren Anstieg auch deren Nullstelle zu bestimmen, dieser Nullstelle einen Zeitpunkt innerhalb der Inspirations- oder Expirationsphase zuzuordnen, diesem Zeitpunkt eine Ventilationsgröße zu diesem Zeitpunkt zuzuordnen und das Bildelement in Abhängigkeit von der so bestimmten Ventilationsgröße durch Grauwert- oder Farbkodierung auf der Anzeigeeinrichtung zur Anzeige zu bringen. Die hinter dieser Vorgehensweise stehende Überlegung besteht darin, dass bei Auftragen des lokalen Impedanzänderungsverlaufs als Funktion der Schrittnummer gleicher globaler Impedanz- oder Volumenänderungsschritte gewissermaßen eine Auftragung als Funktion des globalen Impedanzverlaufs von  $0, \Delta Z_{\text{glo}}, 2 \cdot \Delta Z_{\text{glo}}, \dots, M_{\text{steps}} \cdot \Delta Z_{\text{glo}}$  oder des globalen Volumenverlaufs erfolgt. Idealerweise verhält sich der lokale Ventilationsverlauf genauso wie der globale und es ergibt sich eine Gerade parallel zur x-Achse, was bedeutet, daß es keine Unterschiede im zeitlichen Verhalten der lokalen zur globalen Ventilation gibt: kurz zeitlich homogen. Praktisch bedeutet diese Auftragung als Funktion des globalen Ventilationsverlaufs eine Differenzierung der lokalen Kurve nach dem ventilierten globalen Volumen. Durch Aufsuchen der Nullstelle wird damit praktisch ein Extremwert im lokalen Impedanzverlauf als Funktion des Volumens erfasst. Da bei typischer Ventilation das ventilierte Volumen in der Inspirationsphase monoton mit der Zeit steigt bzw. in der Expirationsphase monoton fällt, entspricht dieses Extremum im Volumen ebenfalls einem in der Zeit. Bei einem positiven Anstieg der angepaßten Geraden in der Inspirationsphase entspricht dieser Extremwert einem Minimum und daher dem Zeitpunkt, an dem sich die Alveolen zu öffnen beginnen, in der Expirationsphase dem Zeitpunkt, zu dem sich die Alveolen schließen. Vorzugsweise verbindet die Steuer- und Auswerteeinheit mit diesem Zeitpunkt eine Ventilationsgröße, z.B. die globale Zeitreihe der Impedanzänderung oder eine anderweitig bestimmte Zeitreihe des Beatmungsdrucks, des Volumens, des Flows oder des aus ihnen mit einem Lungenmechanik-Modell ermittelten Alveolardrucks. Wenn ein Bild angezeigt wird, in dem jedes Bildelement in Abhängigkeit von der Ventilationsgröße, zu der sich die Alveolen öffnen oder schließen, in entsprechender Kodierung (Farbkodierung oder Grauwertkodierung) angezeigt wird, kann dies dem Arzt oder Personal wichtige Hinweise darauf geben, wie das Beatmungsgerät einzustellen ist, zum Beispiel welcher PEEP-Wert einzustellen ist.

**[0015]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet, für die bestimmten Zeitpunkte gleicher Volumenänderungsschritte jedes Bildelement in Abhängigkeit von der lokalen Impedanzänderung des Bildelements durch Grauwert- oder Farbkodierung auf der Anzeigeeinrichtung zur Anzeige zu bringen. Hier wird also die kumulative Verteilung der Ventilation in mehreren Schritten nach jeweils gleicher Volumenänderung über die Inspirations- oder Expirationsphase angezeigt. Wenn zum Beispiel acht Schritte gleicher Volumenänderung über die Inspirations- oder Expirationsphase gewählt, so werden acht Bilder mit den lokalen Impedanzänderungen vom Beginn der Inspiration bis zu deren Ende oder vom Beginn der Expiration bis zu deren Ende als Folge von EIT-Bildern erzeugt.

**[0016]** In einer alternativen Ausführungsform ist die Steuer- und Auswerteeinheit dazu eingerichtet, ab dem zweiten aus der Anzahl der bestimmten Zeitpunkte für die bestimmten Zeitpunkte gleicher Volumenänderungsschritte jedes Bildelement in Abhängigkeit von der Differenz der lokalen Impedanzänderung und Impedanzänderung zum vorhergehenden Zeitpunkt durch Grauwert- oder Farbkodierung auf der Anzeigeeinrichtung zur Anzeige zu bringen. Dies ergibt dann eine Folge von differentiellen EIT-Bildern, intratidale Verteilungs-Bilder genannt, d.h. für jedes Bildelement jeweils die Veränderung der kumulativen Ventilationsverteilung zum vorhergehenden Schritt.

**[0017]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet, die Rekonstruktion der Matrizen, die Bestimmung der Zeitreihen, der ITV-Kurven und der ITU-Werte (skalaren Maße) für jedes Bildelement in Echtzeit durchzuführen. Alternativ ist die Steuer- und Auswerteeinheit dazu eingerichtet, die Messsignale zu speichern und die Rekonstruktion der Matrizen, die Bestimmung der Zeitreihen für den globalen Ventilationsverlauf und die Bestimmung der lokalen Zeitreihen, der ITV-Kurven und der ITU-Werte für jedes Bildelement zeitverzögert durchzuführen oder die Rekonstruktion der Matrizen in Echtzeit durchzuführen und diese zu speichern und die Bestimmung der Zeitreihen, der ITV-Kurven und ITU-Werte zeitverzögert durchzuführen.

**[0018]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet, die ITU-Werte in einen Farbcode umzusetzen und die Bildelemente farbcodiert auf der Anzeigeeinrichtung zur Anzeige zu bringen.

**[0019]** In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Steuer- und Auswerteeinheit dazu eingerichtet, die ITU-Werte in

den Bildelementen zu einem globalen Parameter zusammenzufassen und alphanumerisch und/oder graphisch auf der Anzeigeeinrichtung darzustellen. Falls als ITU-Wert eines Bildelementes die gegebenenfalls mit der Anzahl der Schritte  $M_{steps}$  multiplizierte mittlere Steigung verwendet wird, kann als globaler Parameter die Summe über alle positiven oder negativen gegebenenfalls mit der Anzahl der Schritte  $M_{steps}$  multiplizierten Anstiege oder die halbierte Summe über die Beträge der gegebenenfalls mit der Anzahl der Schritte  $M_{steps}$  multiplizierten Steigungen verwendet werden. In dem Fall, in dem die Standardabweichung als ITU-Wert eines Bildelementes verwendet wird, kann als globaler Parameter die über alle Bildelemente aufsummierte Standardabweichung oder die gemittelte Standardabweichung verwendet werden. Bei Verwendung der Maximalwerte der Beträge der gegebenenfalls mit der Anzahl der Schritte  $M_{steps}$  multiplizierten lokalen Steigungen als lokaler ITU-Wert kann die Summe über alle Maximalwerte der Beträge der gegebenenfalls mit der Anzahl der Schritte  $M_{steps}$  multiplizierten lokalen Steigungen verwendet werden. Falls die maximale Steigungsänderung innerhalb der Inspirations- oder Expirationsphase als ITU-Wert verwendet wird, kann die Summe über alle maximalen gegebenenfalls mit der Anzahl der Schritte  $M_{steps}$  multiplizierten Steigungsänderungen als globaler Parameter verwendet werden.

**[0020]** Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen in den Zeichnungen beschrieben, in denen:

Fig. 1 bis 3 schematische Darstellungen von Komponenten oder Modulen des Elektroimpedanztomographie-Gerätes zur Erläuterung von deren Funktionen zeigen, und

Fig. 4 die lokale Impedanzänderung relativ zum Volumenschritt eines Bildelements als Funktion der Schrittnummer einer vorgegebenen Anzahl von Schritten gleicher Volumenschritte zeigt.

**[0021]** In dem in Fig. 1 gezeigten Ausschnitt aus dem EIT-Gerät wird in diesem Beispiel ein 16-Elektroden-System verwendet, wobei die Elektroden 4 ringförmig um den Thorax angebracht sind. Über die Datenakquisitionseinheit 5 des EIT-Geräts erfolgen Stromeinspeisung über ein Paar (vorzugsweise) benachbarter Elektroden, Spannungsmessungen über mehrere der übrigen benachbarten Elektrodenpaare, dann Stromeinspeisung über ein anderes Paar benachbarter Elektroden, etc. bis mehrere oder alle benachbarten Elektrodenpaare einmal einspeisendes Elektrodenpaar waren; die dabei erhaltenen Messspannungen werden auch als Frame bezeichnet. Ein Frame von Messspannungen besteht hier aus 208 Spannungen, die mit Frame-Raten zwischen 10 Hz und 50 Hz aufgenommen werden können. Die Anzahl von 208 Messspannungen ergibt sich bei einem 16 Elektroden-System dann, wenn jedes der 16 Paare benachbarter Elektroden einmal als einspeisendes Elektrodenpaar verwendet wird, wobei es jeweils unter den verbleibenden 14 Elektroden 13 unterschiedliche Paare benachbarter Elektroden gibt, zwischen denen eine Messspannung erfasst wird, so dass insgesamt bei einem Durchlauf  $16 \times 13 = 208$  Messspannungen erfasst werden. Dies ist eine typische Ansteuerungsweise für ein EIT-Gerät mit einem 16 Elektroden-System. Es ist aber in technischen Umsetzungen von EIT-Geräten auch vorstellbar, dass nicht alle der vorhandenen Elektroden zur Einspeisung von Strom oder Spannung genutzt werden, sondern einzelne Elektroden oder Elektrodenpaare bei der Einspeisung übersprungen werden. Ebenso ist es vorstellbar, dass Spannungsmessungen oder Strommessungen nicht an allen der vorhandenen Elektroden vorgenommen werden, sondern einzelne Elektroden oder Elektrodenpaare übersprungen und bei den Messungen ausgelassen werden.

**[0022]** Im vorliegenden Ausführungsbeispiel werden die 208 Zeitreihen der Spannungen über ein Bussystem 6 zur Speichereinheit 7 des EIT-Geräts oder einer externen Speichereinheit transportiert. Aus den gemessenen Spannungen werden 1024 (relative) Impedanzänderungen  $Z_1, Z_2, \dots, Z_{1024}$  rekonstruiert, die auf ein Bild mit  $32 \times 32$  Bildelementen abgebildet werden. Die Rekonstruktion und weitere Analysen können sowohl online als auch zeitlich und räumlich versetzt offline erfolgen. Die im Folgenden entstehenden Daten können daher intern im EIT-System über ein Bussystem oder in einen externen Speicher abgelegt werden. Es wird im Folgenden nicht mehr zwischen beiden Möglichkeiten unterschieden.

**[0023]** Ein Rechenmodul rekonstruiert aus den 208 Zeitreihen der Spannungen  $U_1(t), U_2(t), \dots, U_{208}(t)$  die 1024 Zeitreihen der relativen Impedanzänderungen ( $Z_1(t), Z_2(t), \dots, Z_{1024}(t)$ ) und stellt sie in einem lokalen Impedanzmodul 8 bereit. Mit einer vorgegebenen oder aus den Daten bestimmten Bildelement-Maske 9 werden nur die informations-tragenden "ventilierten" Bildelemente (Pixel)  $i=[1,2,\dots,N_{pix}]$  ausgewählt, d.h. die in Fig. 1 angedeuteten Randbereiche 9 außerhalb der Lunge werden ausgeblendet.

**[0024]** In Fig. 2 ist schematisch ein Analysemodul der Steuer- und Auswerteeinheit gezeigt. In Fig. 2 ist oben schematisch die globale (relative) Impedanzänderungszeitreihen  $Z_{glo}(t)$  10, kurz globale Impedanzkurve, gezeigt, die durch Aufsummierung der lokalen (relativen) Impedanzänderungszeitreihen  $Z_i(t)$  bestimmt und gegebenenfalls geeignet normiert wird. Diese globale Impedanzkurve  $Z_{glo}(t)$  repräsentiert die globale Impedanzänderung im Unterschied zu der lokalen Impedanzänderung  $Z_i(t)$  der einzelnen Bildelemente. Die globale Impedanzänderungszeitreihe oder Impedanzänderungskurve ist aufgrund der nahezu vollständigen Proportionalität zwischen Atemluftvolumenänderung und Impedanzänderung hochgradig mit der Ventilationsvolumenkurve korreliert; im Fall eines den Patienten beatmenden Beatmungsgerätes kann die Impedanzänderungskurve auch auf die Volumenkurve des Beatmungsgerätes normiert wer-

den.

**[0025]** Aufgrund der hohen Korrelation der globalen Impedanzkurve, die in Fig. 2 oben dargestellt ist, mit der Volumenkurve der Atmung kann die globale Impedanzkurve  $Z_{glo}(t)$  zur Bestimmung der Inspirations- und Expirationsphase verwendet werden, d.h. Beginn und Ende der Inspirationsflanke und Beginn und Ende der Expirationsflanke können durch die Steuer- und Auswerteeinheit in der globalen Impedanzkurve bestimmt werden. Fig. 2 zeigt schematisch das Analysemodul der Steuer- und Auswerteeinheit, in dem die globale Impedanzkurve  $Z_{glo}(t)$  und die lokalen Impedanzkurven  $Z_1(t), Z_2(t), \dots, Z_{Npix}(t)$  aufgenommen und analysiert werden. In der globalen Impedanzkurve  $Z_{glo}(t)$  ist die Inspirationsphase bestimmt und durch die Anfangs- und Endpunkte 12 markiert.

**[0026]** In dem Ausführungsbeispiel wird für die Inspirationsphase die mit der Anzahl der ITV-Schritte  $M_{steps}$  multiplizierte mittlere Steigung als skalares Maß (ITU-Wert) der ITV-Kurven gewählt.

**[0027]** Dieser Parameter gibt trotz der Informationsreduktion der Kurvenpunkte auf nur einen Wert eine grundlegende Information wieder: welche Lungengebiete am Anfang der Inspiration weniger und am Ende mehr der eingeatmeten Luft erhalten oder umgekehrt und wie groß die Umverteilung der respirierten Luftteilvolumina bei einem Atemzug ist. Die Darstellung der Bildelemente in Abhängigkeit von diesem Parameter wird im folgenden als ITU-Map (intratidale Umverteilungs-Map) bezeichnet. Als globale Größe wird die halbe Summe der Beträge der Werte der ITU-Map gewählt, da dieser eine einfache Interpretation als relativer Anteil der umverteilten Menge der respirierten Luftteilvolumina darstellt.

**[0028]** Die Inspirationsflanke zwischen Anfangs- und Endzeitpunkt der Inspiration der globalen Impedanzkurve wird gemäß dem in EP 2 228 009 A1 beschriebenen ITV-Verfahren in  $M_{steps}$  äquidistante globale Impedanzänderungsschritte  $\Delta Z_{glo}^m = \text{const.}, m=1 \dots M_{steps}$ , unterteilt, angedeutet in Fig. 2 durch die waagerechten Punktlinien bei 13, die alle gleichen Abstand haben, d.h. gleichen Volumenänderungsschritten oder Luftteilvolumina der Inspiration entsprechen. In Fig. 2 ist die Anzahl der Schritte mit  $M_{steps} = 5$  gewählt. Die Schrittgröße  $\Delta Z_{glo}^m$  kann als eingeatmetes Luftteilvolumen betrachtet werden, wobei aufgrund der hohen Korrelation der Impedanzänderungskurve mit der Volumenkurve der Atmung die Unterteilung in  $M_{steps}$  Impedanzänderungsschritte einer Unterteilung der Volumenkurve der Inspirationsphase in  $M_{steps}$  gleiche Volumenänderungsschritte  $\Delta V$  entspricht. Im Zeitbereich liegen die entsprechenden Schritte i.A. nicht äquidistant auseinander, angedeutet durch die senkrechten Strichlinien bei den Schritten 1, 2, 3, 4 und 5 aufgrund i.A. nicht konstanten Flows  $dV/dt$ . Die Zeitpunkte, die den gleichen Volumenschritten entsprechen und in Figur 2 durch die vertikalen gestrichelten Linien angedeutet sind, werden als die Zeitpunkte oder Stützstellen verwendet, um die lokale Impedanzänderungskurve auszuwerten und deren Zeitreihen aufzustellen. Das Auswerten der lokalen Impedanzänderungskurven nach gleich Volumenänderungsschritten  $\Delta V$  kann praktisch so interpretiert werden, das man den lokalen Ventilationsverlauf als Funktion des globalen Ventilationsverlaufs von 0,  $\Delta V$ ,  $2 \cdot \Delta V$ , ...  $M_{steps} \cdot \Delta V$  aufträgt.

**[0029]** Für jedes Bildelement  $i$  und jeden Schritt  $m$  wird die lokale Impedanzänderung  $\delta Z_i^m$  herangezogen, die mit der globalen Impedanzänderung  $\Delta Z_{glo}^m$  zu diesem Schritt zum lokalen ITV-Wert  $\zeta_i^m$  normiert wird:

$$\zeta_i^m = \frac{\delta Z_i^m}{\Delta Z_{glo}^m} \cdot 100,$$

wobei wegen  $\sum_{i=1}^{Npix} \delta Z_i^m = \Delta Z_{glo}^m$  für alle Schritte  $m = 1, \dots, M_{steps}$   $\sum_{i=1}^{Npix} \zeta_i^m = 100\%$  gilt.

**[0030]** Für jedes Bildelement  $i$  wird für die  $m = 1, \dots, M_{steps}$  ITV-Werte  $\zeta_i^m$  die Steigung  $S_i$  einer an die  $\zeta_i^m$  Werte angepassten Gerade durch quadratische Fehlerminimierung bestimmt und mit der Anzahl der ITV-Schritte  $M_{steps}$  multipliziert:

$$S_i = \frac{\sum_{m=1}^{M_{steps}} \zeta_i^m \sum_{m=1}^{M_{steps}} m - M_{steps} \sum_{m=1}^{M_{steps}} \zeta_i^m m}{\left( \sum_{m=1}^{M_{steps}} m \right)^2 - M_{steps} \sum_{m=1}^{M_{steps}} m^2} \cdot M_{steps}$$

**[0031]** Die Multiplikation mit der Anzahl der ITV-Schritte  $M_{steps}$  bewirkt zum einen Unabhängigkeit der Werte  $S_i$  von

der Anzahl der ITV-Schritte bis auf statistische Schwankungen und zum anderen eine einfache Interpretierbarkeit der Größe als mittlere lokale intratidale Umverteilung der eingeatmeten Inspirationsteilvolumina von Anfang bis Ende der Inspiration (oder der ausgeatmeten Luftteilvolumina über die Expiration). Daher wird dieser Wert  $S_i$  als lokaler oder regionaler ITU-Wert (intratidaler Umverteilungswert) bezeichnet.

**[0032]** So bedeutet beispielsweise ein lokaler ITU-Wert von  $S_i=1.5\%$ , dass während der Inspiration im Mittel von Anfang bis Ende der Anteil der eingeatmeten Luft für diesen Pixel um 1.5% anstieg. Das bedeutet, dass am Anfang also weniger Luft in die Region des Bildelements ging als am Ende, was auf Veränderung der lokalen Zeitkonstanten des Kompartimentes während des Atemzuges, im Extremfall sogar auf tidales Recruitment hindeuten kann.

**[0033]** Lokale ITU-Werte (für ein Bildelement) über 1% sind bereits als recht groß einzustufen. Für ITU-Werte größerer Regionen (ROI's) werden die lokalen ITU-Werte, die in dieser ROI liegen, aufsummiert. Eine ROI (Region of Interest), die z.B. 50 Bildelemente einer z.B. 300 Bildelemente umfassenden Bildelementmaske eines EIT-Bildes mit 32x32 Bildelementen enthält, hätte dann einen regionalen ITU-Wert von mehr als 50%, wenn die einzelnen Bildelemente lokale ITU-Werte von 1% hätten. Das bedeutet, dass in dieser ROI alleine 50% der eingeatmeten Luftteilvolumina umverteilt werden, also dass diese Region z.B. am Ende 50% mehr (oder weniger) Anteil am eingeatmeten Luftteillvolumen als am Anfang erhält, was auf tidales Recruitment oder tidale Überdehnung oder in dieser Lungenregion auf sich stark voneinander unterscheidende Zeitkonstanten in verschiedenen Lungengebieten aufgrund z.B. einer COPD-Erkrankung hindeuten würde.

**[0034]** Die ITU-Werte  $S_i$ ,  $i=1\dots N_{pix}$  werden mittels einer Farbkodierung als Bild (ITU-Map) von gleicher Größe als Bild mit 32x32 Bildelementen angezeigt, wie in Fig. 3 schematisch in der Anzeigeeinrichtung 18 angedeutet.

**[0035]** Aufgrund der obiger Definition von  $\zeta_i^m$  gilt:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{N_{pix}} \left( \sum_{m=1}^{M_{steps}} \zeta_i^m \sum_{m=1}^{M_{steps}} m - M_{steps} \sum_{m=1}^{M_{steps}} \zeta_i^m m \right) &= \sum_{m=1}^{M_{steps}} m \sum_{m=1}^{M_{steps}} \sum_i^{N_{pix}} \zeta_i^m - M_{steps} \sum_{m=1}^{M_{steps}} m \sum_i^{N_{pix}} \zeta_i^m \\ &= \left( \sum_{m=1}^{M_{steps}} m \right) \cdot M_{steps} \cdot 100 - M_{steps} \left( \sum_{m=1}^{M_{steps}} m \right) \cdot 100 = 0 \end{aligned}$$

und somit folgt  $\sum_{i=1}^{N_{pix}} S_i = 0$ , was auch anschaulich klar ist, denn wenn in ein Lungengebiet ein relativ höherer Anteil des (konstanten) eingeatmeten Luftteillvolumens eingeht, muss in einem anderen Lungengebiet zwangsläufig ein geringerer Anteil des Luftteillvolumens einfließen, wenn die Gesamtsumme eine konstante, nämlich  $\Delta V$ , ist.

**[0036]** Als globaler ITU-Wert oder kurz ITU wird daher die Hälfte der Betragssumme definiert:

$$ITU = \frac{\sum_{i=1}^{N_{pix}} |S_i|}{2}, \quad [ITU] = \%$$

**[0037]** Dieser Wert ist relative intratidale Umverteilung der eingeatmeten Luftteilvolumina vom Anfang bis zum Ende der Inspiration (oder Expiration). Der Wertebereich liegt zwischen  $0\% \leq ITU \leq 100\%$ . Die untere Grenze bezeichnet zeitlich (nicht notwendigerweise räumlich) vollkommen homogene Ventilation, was bedeutet, dass überall in der Lunge gleiche Zeitkonstanten vorliegen. Das heißt zu jeder Phase während der Inspiration (Expiration) erhalten die verschiedenen ventilierten Lungenregionen stets den gleichen Anteil des ventilierten Luftteillvolumens. Die obere Grenze kennzeichnet maximale Umverteilung. Das heißt zu Anfang der Inspiration geht alles in ein Gebiet der Lunge, das andere erhält nichts, am Ende alles in das andere Gebiet, das erste erhält nichts: Während der Inspiration (Expiration) werden die ventilierten (differentiellen) Luftteilvolumina also regional vollkommen umverteilt.

**[0038]** Eine Autoskalierung der ITU-Maps ist nicht empfehlenswert, da Bilder mit kleinen lokalen ITU-Werten von etwa  $S_i < 0.1\%$  gleich dargestellt würden wie ITU-Maps mit großen lokalen ITU-Werten von  $S_i > 1.0\%$ . Es ist daher ratsam einen gemeinsamen unteren Bereich einer Minimalskalierung zu definieren. Dies erfordert Untersuchung von Patienten und Probanden um den Wertebereich der ITU-Werte näher zu spezifizieren. Aus empirischen Untersuchungen ergab

sich das lokale ITU-Werte von  $S_j > 0.75\%$  bereits sehr groß und selten sind, so dass zu empfehlen ist, eine gemeinsame untere ITU-Map-Skala von einem Bereich von etwa  $-0.75\% < S_j < +0.75\%$  (oder größer) zu verwenden.

[0039] Aus den lokalen  $S_j$ -Werten, die der ITU-Map zugrunde liegen, kann eine weitere für die Beatmung interessante Größe abgeleitet werden. In Fig. 3 ist beispielhaft der  $\zeta^m$ -Graph des ersten, zweiten und N-ten Bildelements dargestellt. Betrachtet man die unterste der drei  $\zeta^m$ -Graphen in Box 16 in Figur 3, so findet man, dass die an die Daten angepasste Kurve steigend ist. Da in diesem Ausführungsbeispiel ein Geraden-Fit als Anpassung verwendet wird, handelt es sich um eine positive Steigung ( $S/M_{\text{step}}$ ). In Fig. 4 ist dies für einen realen Datensatz aus einem Fallbeispiel verdeutlicht. Im Folgenden wird auf die Figur 4 Bezug genommen.

[0040] Aus der angepassten Geraden 29 wird die Nullstelle  $m_i^0$  30 des Bildelements  $i=(20,11) = 20 \cdot 32 + 11 = 651$  bestimmt, das mit 31 bezeichnet ist. In diesem Datensatz lagen die Beatmungsdruckkurven vor. Mittels eines Ein-Kompartiment-Modells, welches die Druckabfälle durch Turbulenzen am Mundstück und durch Reibung in den oberen Atemwegen berücksichtigt, wurde aus der Beatmungsdruckkurve die Alveolardruckkurve bestimmt. Der Nullstelle  $m_i^0=2.3$  entspricht ein Alveolardruck für den Lungenbereich des Bildelements  $i=(20,11)$  von  $p_i^0=15.5$  mbar. Dieser Druck kann im Zusammenhang mit dem bekannten Lungenschaden in diesem Fallbeispiel als Öffnungsdruck dieser Lungenregion interpretiert werden und wird im folgenden auch so bezeichnet. Das Verfahren wird für alle Pixel mit positiven ITU-Werten durchgeführt, wobei sinnlose Öffnungsdruckwerte mit  $p_i^0 < 0$  auf 0 gesetzt werden. Wenn der Nulldurchgang innerhalb des Tidalhubes wie in diesem Beispiel ( $\min(p_{\text{alv}})=12$  mbar  $< p_i^0=15.5$  mbar  $< \max(p_{\text{alv}})=31$  mbar) erfolgt, ist dies ein starkes Indiz auf tidales Recruitment, also dass sich die Alveolen zyklisch während der Inspiration öffnen und am Ende der Expiration wieder kollabieren - ein Prozess der aufgrund hoher Spannungskräfte zur Zerstörung der Alveolen führt und vermieden werden muss. Dieser Fall kann auch ohne Vorliegen der Druckinformation bestimmt werden, weil dies nur eine Nullstelle im Bereich  $1 < m_i^0 < M_{\text{steps}}$  erfordert. Die eventuell vorliegende zugehörige Alveolardruckinformation gibt an, ab welchem PEEP die Alveolen offen bleiben.

[0041] Wenn die Nullstelle  $m_i^0 < 1$  ist, also vor dem Beginn des Tidalhubs liegt, kann durch Extrapolation des funktionalen Zusammenhangs zwischen den ITV-Schritten  $m$  und den zugehörigen Alveolardrücken  $p_{\text{alv}}(m)$  immer noch ein Wert  $p_i^0 > 0$  bei PEEP-Werte  $> 0$  existieren (PEEP: "Positive End Expiratory Pressure"). In diesem Fall liegt dann wahrscheinlich kein tidales Recruitment vor, aber der Öffnungsdruckwert gibt an, ab welchen kleineren PEEP-Werten als verwendeten in etwa die entsprechenden Lungengebiete kollabieren würden.

[0042] Die pixelweise bestimmten Öffnungsdrücke  $p_i^0$ ,  $i=1 \dots 1024$ , können als Öffnungsdruckbild 33 kodiert dargestellt werden. Aus dem Öffnungsdruckbild wird aus den  $p_i^0$ -Werten, die größer sind als 0, ein globaler Öffnungsdruckwert 34 abgeleitet, hier aus dem Mittelwert des oberen Quantils.

## Patentansprüche

1. Elektroimpedanztomographie-Gerät mit: einer Mehrzahl von um den Thorax eines Patienten anbringbaren Elektroden, einer Steuer- und Auswerteeinheit, die durch Programmierung dazu eingerichtet ist, mindestens ein Elektrodenpaar als einspeisendes Elektrodenpaar mit einem Wechselstrom oder mit einer Wechselspannung zu versorgen, mit mehreren der übrigen Elektrodenpaare aus der Mehrzahl der Elektroden jeweils ein Spannungssignal oder Stromsignal als Messsignal aufzunehmen und sukzessive andere Elektrodenpaare aus der Mehrzahl von Elektrodenpaaren als einspeisende Elektrodenpaare fungieren zu lassen, um aus den Messsignalen mit einem Rekonstruktionsalgorithmus eine Matrix aus Bildelementen zu rekonstruieren, die die Verteilung der Impedanzänderungen in der Elektrodenebene repräsentiert, und über die Zeit wiederholt Messsignale aufzunehmen und Matrizen zu rekonstruieren, und mit einer Anzeigeeinrichtung, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet ist, eine Zeitreihe des globalen Ventilationsverlaufs aus der Folge der rekonstruierten Matrizen als Zeitreihe der mittleren Impedanzänderung oder als eine Zeitreihe eines gemessenen Beatmungsvolumens zu bestimmen und darin eine Inspirations- oder Expirationsphase zu bestimmen, die Inspirations- oder Expirationsphase in dem globalen Ventilationsverlauf in eine Anzahl ( $1, 2, \dots, M_{\text{steps}}$ ) von Schritten gleicher Volumenänderung zu unterteilen, die diesen Schritten gleicher Volumenänderung entsprechenden Zeitpunkte in der Inspirations- oder Expirationsphase zu bestimmen, für jedes Bildelement die Änderung der lokalen Impedanz zwischen diesen Zeitpunkten zu bestimmen und jeweils das Verhältnis von dieser lokalen Änderung der Impedanz des Bildelements zur globalen gleichen Volumenänderung zu bestimmen, um so eine lokale Folge von relativen Impedanzänderungen des Bildelements als Funktion der Schritte gleicher Volumenänderung zu bilden, für jede lokale Folge ein für deren Verlauf als Funktion der Schritte gleicher Volumenänderung charakteristisches skalares Maß zu bestimmen und jedes Bildelement in von dem jeweiligen skalaren Maß abhängiger Weise auf der Anzeigeeinrichtung zur Anzeige zu bringen.
2. Elektroimpedanztomographie-Gerät nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet ist, als skalares Maß für eine lokale Folge der relativen Impedanzänderungen als

Funktion der Schritte gleicher Volumenänderung eines Bildelements für über die Inspirations- oder Expirationsphase deren mittlere gegebenenfalls mit einer Konstanten multiplizierten Steigung, deren Standardabweichung, Maximalwerte der Beträge von lokalen Steigungen innerhalb der Inspirations- oder Expirationsphase, oder die maximale Steigungsänderung innerhalb der Inspirations- oder Expirationsphase zu bestimmen.

- 5  
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55
3. Elektroimpedanztomographie-Gerät nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet ist, in einer Inspirations- oder Expirationsphase für jedes Bildelement an die lokale Folge der relativen Impedanzänderungen als Funktion der Schrittnummer ( $1, 2, \dots, M_{steps}$ ) der gleichen Volumenänderungen eine Gerade anzupassen und deren Nullstelle zu bestimmen, dieser Nullstelle eine Zeit innerhalb der Inspirations- oder Expirationsphase zuzuordnen und darüber eine Ventilationsgröße zu dieser Zeit zuzuordnen und das Bildelement in Abhängigkeit von der so bestimmten Ventilationsgröße in Grauwert- oder Farbkodierung auf der Anzeigeeinrichtung zur Anzeige zu bringen.
4. Elektroimpedanztomographie-Gerät nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet ist, als Ventilationsgröße die globalen Zeitreihe der Impedanzänderung, Volumen, Flow oder Beatmungsdruck aus einem Beatmungsgerät oder aus diesen Größen über ein Modell berechneten Alveolardruck zu verwenden.
5. Elektroimpedanztomographie-Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet ist, für die bestimmten Zeitpunkte gleicher Volumenänderungsschritte jedes Bildelement in Abhängigkeit von der lokalen Impedanzänderung durch Grauwert- oder Farbkodierung auf der Anzeigeeinrichtung zur Anzeige zu bringen.
6. Elektroimpedanztomographie-Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet ist, ab dem zweiten aus der Anzahl der bestimmten Zeitpunkte für die bestimmten Zeitpunkte gleicher Volumenänderungsschritte jedes Bildelement in Abhängigkeit von der Differenz der lokalen Impedanzänderung des Bildelements und der lokalen Impedanzänderung zum vorhergehenden Zeitpunkt durch Grauwert- oder Farbkodierung auf der Anzeigeeinrichtung zur Anzeige zu bringen.
7. Elektroimpedanztomographie-Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet ist, die Rekonstruktion der Matrizen, die Bestimmung der Zeitreihen und des skalaren Maßes für den Verlauf der lokalen Zeitreihe für jedes Bildelement in Echtzeit durchzuführen.
8. Elektroimpedanztomographie-Gerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet ist, die Messsignale zu speichern und die Rekonstruktion der Matrizen, die Bestimmung der Zeitreihen und des skalaren Maßes für den Verlauf der lokalen Zeitreihe für jedes Bildelement zeitverzögert durchzuführen oder die Rekonstruktion der Matrizen in Echtzeit durchzuführen und diese zu speichern und die Bestimmung der Zeitreihen und des skalaren Maßes für den Verlauf der lokalen Zeitreihe für jedes Bildelement zeitverzögert durchzuführen.
9. Elektroimpedanztomographie-Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet ist, die skalaren Maße für den Verlauf der lokalen Zeitreihen in einen Farbcode umzusetzen und die Bildelemente farbcodiert auf der Anzeigeeinrichtung zur Anzeige zu bringen.
10. Elektroimpedanztomographie-Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Steuer- und Auswerteeinheit weiter dazu eingerichtet ist, die skalaren Maße für den Verlauf der lokalen Impedanzänderung in den Bildelementen zu einem globalen Parameter zusammenzufassen und alphanumerisch und/oder graphisch auf der Anzeigeeinrichtung darzustellen, wobei, falls als skalares Maß die mittlere gegebenenfalls mit einer Konstanten multiplizierten Steigung verwendet wird, als globaler Parameter die Summe über alle positiven oder negative Steigungen oder die halbierte Summe über die Beträge der Steigungen verwendet wird, falls die Standardabweichung als skalares Maß verwendet wird, als globaler Parameter die über alle Bildelemente aufsummierte Standardabweichung oder die gemittelte Standardabweichung verwendet wird, falls die Maximalwerte der lokalen Steigungen als skalares Maß verwendet werden, die Summe über alle Maximalwerte der lokalen gegebenenfalls mit einer Konstanten multiplizierten Steigungen verwendet wird, falls die maximale gegebenenfalls mit einer Konstanten multiplizierten Steigungsänderung als skalares Maß verwendet wird, die Summe über alle maximalen gegebenenfalls mit einer Konstanten multiplizierten Steigungsänderungen als globaler Parameter verwendet wird.

11. Verfahren zur Aufnahme einer Folge von EIT-Bildern einer Querschnittsebene des Thorax eines Patienten durch eine Vielzahl von auf dem Umfang des Thorax verteilte Elektroden, wobei bei dem Verfahren mindestens ein Elektrodenpaar als einspeisendes Elektrodenpaar mit einem Wechselstrom oder einer Wechselspannung versorgt wird, mit mehreren der übrigen Elektrodenpaare aus der Vielzahl der Elektrodenpaare jeweils ein Spannungssignal oder Stromsignal als Messsignal aufgenommen wird und sukzessive andere Elektrodenpaare aus der Vielzahl von Elektrodenpaaren als einspeisende Elektrodenpaare betrieben werden, aus der Gesamtheit der Messsignale mit einem Rekonstruktionsalgorithmus eine Matrix aus Bildelementen rekonstruiert wird, die die Verteilung der Impedanzänderungen in der Elektrodenebene repräsentiert, über die Zeit wiederholt Matrizen der Impedanzänderung rekonstruiert werden,
- dadurch gekennzeichnet, dass**
- eine Zeitreihe des globalen Ventilationsverlaufs aus der Folge der rekonstruierten Matrizen als Zeitreihe der mittleren Impedanzänderung oder als eine Zeitreihe eines gemessenen Beatmungsvolumens bestimmt wird, in dem globalen Ventilationsverlauf eine Inspirations- oder Expirationsphase bestimmt, die Inspirations- oder Expirationsphase in eine Anzahl ( $1, 2, \dots, M_{steps}$ ) von Schritten gleicher Volumenänderung unterteilt wird und die diesen Schritten gleicher Volumenänderung entsprechenden Zeitpunkte in der Inspirations- oder Expirationsphase bestimmt werden,
- für jedes Bildelement zu den bestimmten Zeitpunkten gleicher Volumenänderung das Verhältnis aus Impedanzänderung des Bildelements zwischen diesen Zeitpunkten zur gleichen globalen Volumenänderung gebildet wird und diese Verhältnisse als Folge der lokalen relativen Impedanzänderung in Abhängigkeit von den zugehörigen Schrittnummern des Bildelements bestimmt wird,
- für jedes Bildelement aus dessen Folge der lokalen relativen Impedanzänderung ein für deren Verlauf charakteristisches skalares Maß bestimmt wird und die Bildelemente in von dem jeweiligen skalaren Maß abhängiger Weise auf einer Anzeigeeinrichtung zur Anzeige gebracht werden.

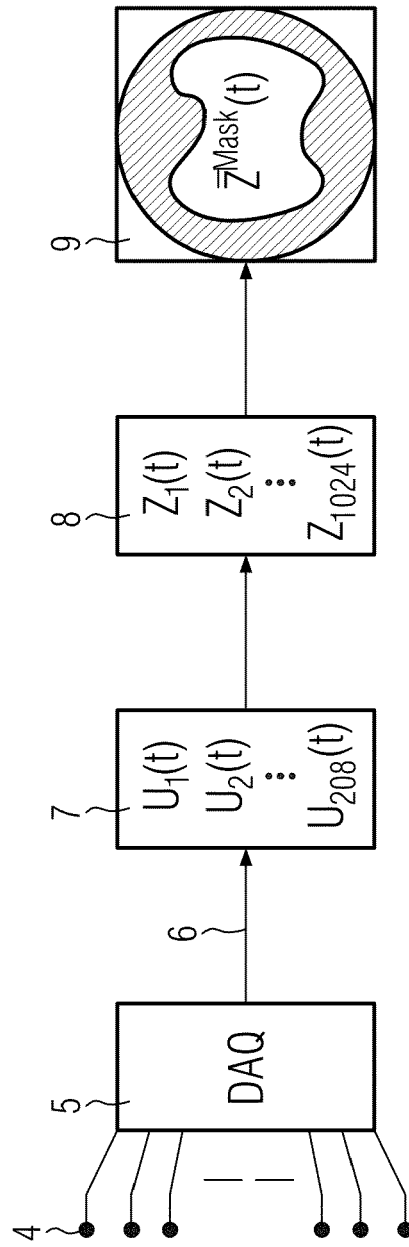


FIG. 1

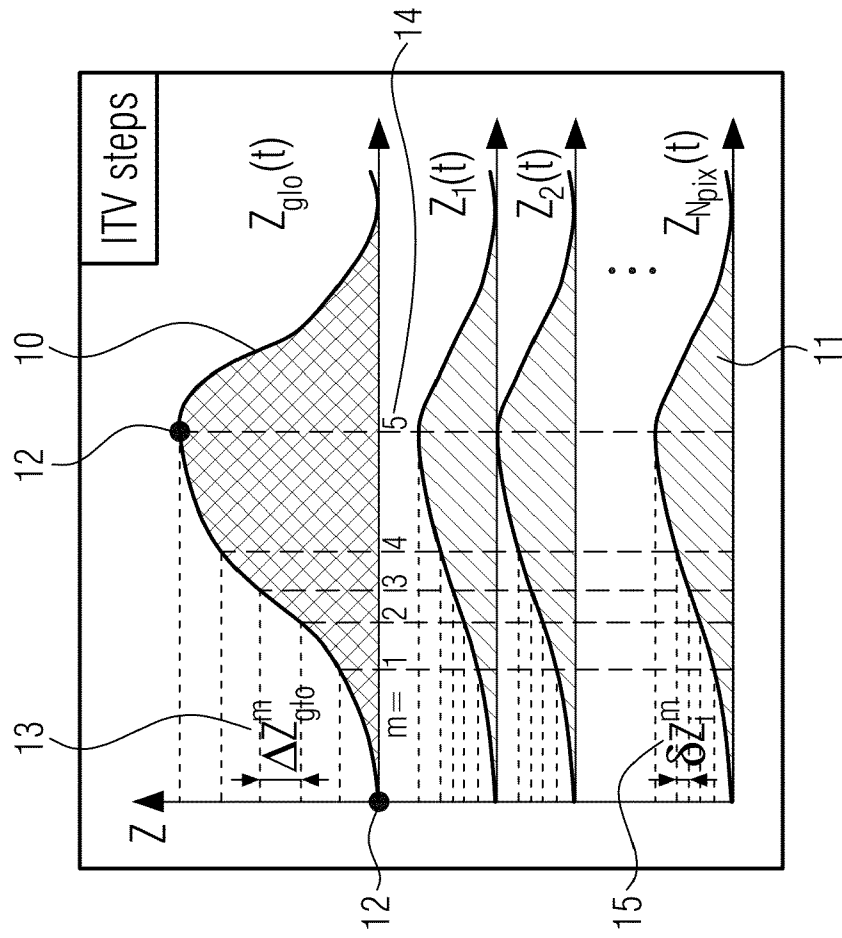


FIG. 2

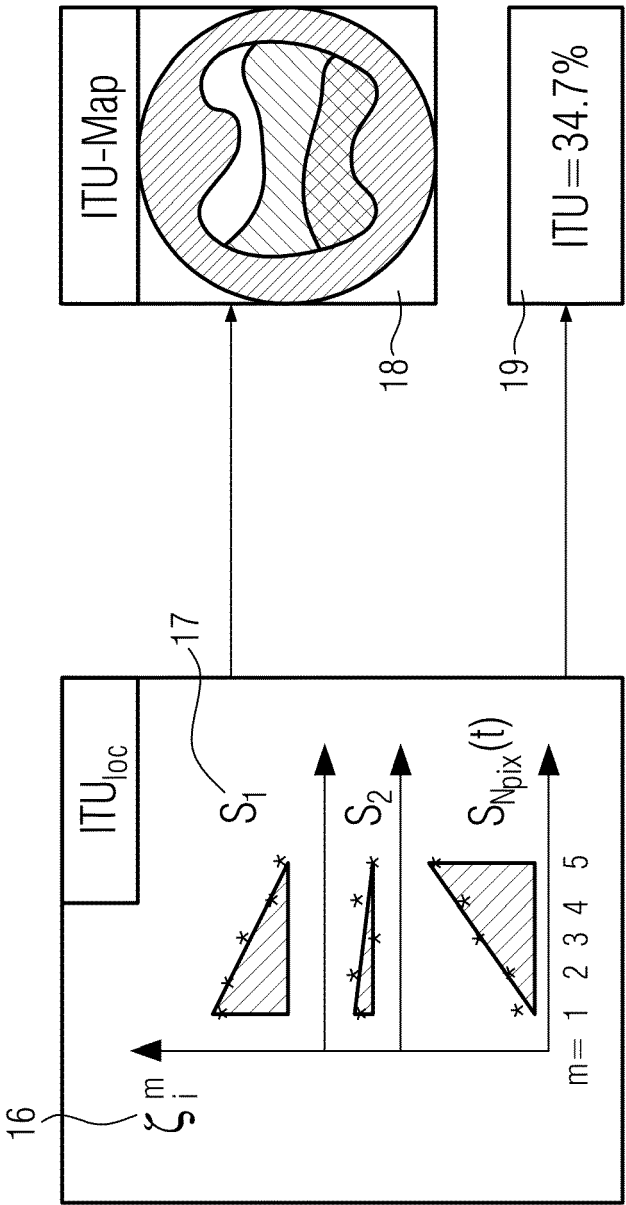


FIG. 3

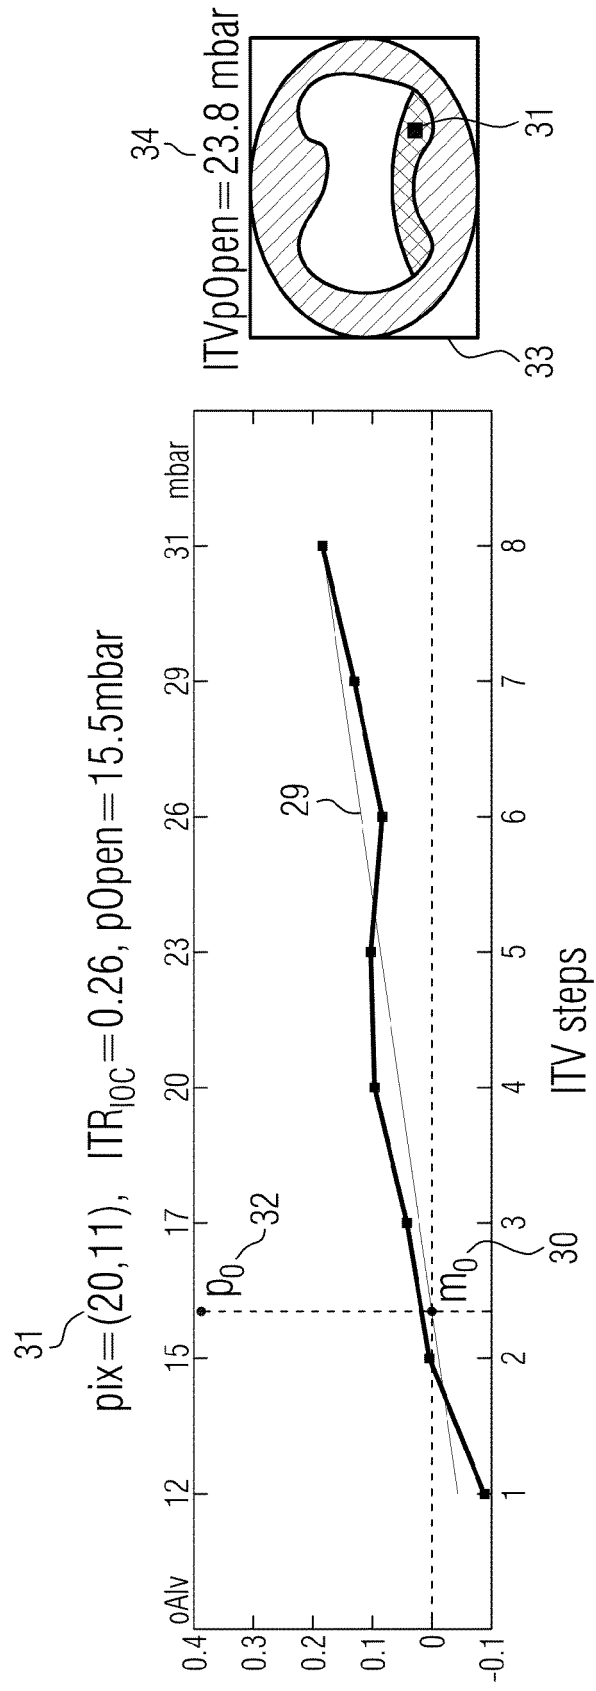


FIG. 4



## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung  
EP 14 15 1412

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kategorie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrifft Anspruch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)                  |
| X,D                                                                                                                                                                                                                                                                               | EP 2 228 009 A1 (DRAEGER MEDICAL AG [DE])<br>15. September 2010 (2010-09-15)<br>* Abbildungen 1,5,6,8,9 *<br>* Absätze [0018] - [0020], [0023] - [0025] *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,5-11<br>2-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INV.<br>A61B5/00<br>A61B5/053<br>A61B5/08           |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----<br>K Lowhagen ET AL: "Regional intratidal gas distribution in acute lung injury and acute respiratory distress syndrome--assessed by electric impedance tomography",<br>Minerva anesthesiologica,<br>1. Dezember 2010 (2010-12-01), Seiten 1024-1035, XP055115067,<br>Italy<br>Gefunden im Internet:<br>URL: <a href="http://gup.ub.gu.se/publication/146903">http://gup.ub.gu.se/publication/146903</a><br>-regional-intratidal-gas-distribution-in-a-cute-lung-injury-and-acute-respiratory-distress-syndrome-as<br>[gefunden am 2014-04-24]<br>* Zusammenfassung *<br>* Kapitel "Electric impedance tomography"<br>*<br>* Abbildung 1 *<br>----- | 1-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)<br><br>A61B<br>A61M |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| Recherchenort<br><b>Den Haag</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abschlußdatum der Recherche<br><b>25. April 2014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prüfer<br><b>Albrecht, Ronald</b>                   |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE<br>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet<br>Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie<br>A : technologischer Hintergrund<br>O : mündliche Offenbarung<br>P : Zwischenliteratur |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze<br>E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist<br>D : in der Anmeldung angeführtes Dokument<br>L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument<br>-----<br>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument |                                                     |

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



**IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE**

*Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.*

**In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente**

- EP 1000580 A1 [0002]
- EP 2228009 A1 [0007] [0028]

**In der Beschreibung aufgeführte Nicht-Patentliteratur**

- Regional ventilation delay index: detection of tidal recruitment using electric impedance tomography. Yearbook of Intensive Care and Emergency Medicine [0006]

电阻抗断层摄影设备具有多个电极（4），其围绕患者的胸部附接，以及控制和评估单元，其被设置为提供一对电极作为施加的电极对，具有交流电或者具有交流电压。提供控制和评估单元以从重建矩阵序列确定全局通气过程的时间序列，作为平均阻抗变化的时间序列或者作为测量的通气量的时间序列。包括用于通过电极接收一系列电阻抗断层摄影 - 患者胸部的横截面的图像的方法的独立权利要求。

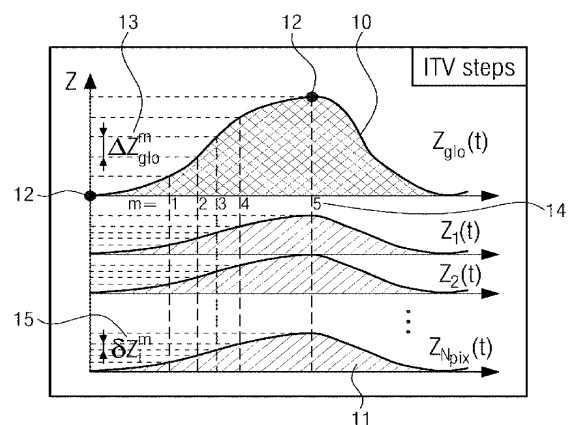


FIG. 2