



(11) **EP 1 785 085 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
16.05.2007 Patentblatt 2007/20

(51) Int Cl.:
A61B 5/00 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **05024760.0**

(22) Anmeldetag: **12.11.2005**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL BA HR MK YU

(72) Erfinder:
• **Staub, Arnulf**
64646 Heppenheim (DE)
• **Gillen, Ralph**
26871 Papenburg (DE)

(71) Anmelder:
• **Roche Diagnostics GmbH**
68305 Mannheim (DE)
Benannte Vertragsstaaten:
DE
• **F. Hoffmann-La Roche Ltd.**
4070 Basel (CH)
Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR

(74) Vertreter: **Mommer, Niels et al**
Twelmeier Mommer & Partner
Westliche 56-58
75172 Pforzheim (DE)

(54) **Implantierbares Elektrodensystem, Verfahren und Vorrichtung zum Messen einer Analytkonzentration in einem menschlichen oder tierischen Körper**

(57) Die Erfindung betrifft ein implantierbares Elektrodensystem zum Messen einer Analytkonzentration in einem menschlichen oder tierischen Körper, umfassend eine erste und eine zweite Meßelektrode (2, 3) zum Ermitteln von Meßsignalen, die jeweils eine Information über die zu messende Analytkonzentration enthalten, wobei die erste Meßelektrode (2) eine erste Meßsensitivität hat, die an einen ersten Konzentrationsbereich des Analyten angepaßt ist, und die zweite Meßelektrode (3) eine zweite Meßsensitivität hat, die von der ersten Meßsensitivität verschieden ist und an einen zweiten Konzentrationsbereich des Analyten angepaßt ist. Die Erfindung betrifft ferner eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Messen einer Analytkonzentration mittels eines derartigen Elektrodensystems.

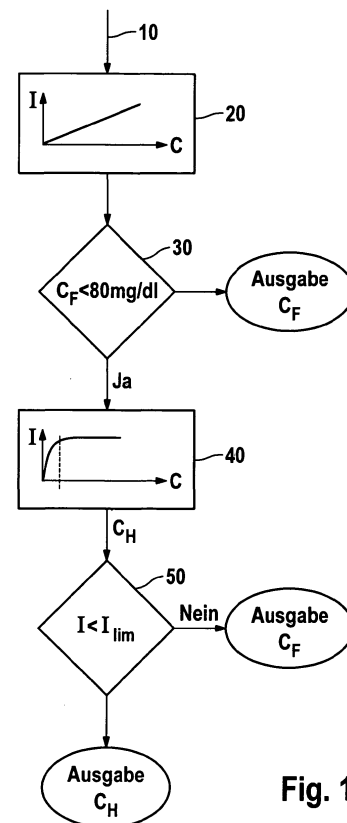


Fig. 1

EP 1 785 085 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein implantierbares Elektrodensystem, eine Vorrichtung mit einem derartigem Elektrodensystem und ein entsprechendes Verfahren zum Messen einer Analytkonzentration in einem menschlichen oder tierischem Körper. Ein derartiges Elektrodensystem ist beispielsweise aus der US 6175752 B1 bekannt.

[0002] Implantierbare Elektrodensysteme ermöglichen Messungen von physiologisch bedeutsamen Analyten wie beispielsweise Laktat oder Glukose in dem Körper eines Patienten. Derartige Messungen in vivo haben gegenüber üblichen Vorgehensweisen, bei denen eine Probe einer Körperflüssigkeit entnommen und außerhalb des Körpers analysiert wird, eine Reihe wichtiger Vorteile, insbesondere die Möglichkeit einer automatischen und kontinuierlichen Erfassung von Meßwerten.

[0003] Bekannte Implantate haben jedoch den Nachteil, daß sich mit ihnen Analytkonzentrationen nur mit einer geringeren Genauigkeit und Zuverlässigkeit bestimmen lassen, als es mit einer herkömmlichen ex-vivo Analyse möglich ist.

[0004] Zur Erhöhung der Meßgenauigkeit wird in der US 2005/0059871 A1 vorgeschlagen, die interessierende Analytkonzentration mit mehreren Elektroden gleichzeitig zu messen und die so erhaltenen Meßsignale durch Mittelwertbildung auszuwerten. Als zusätzliche Maßnahme wird empfohlen, ergänzend mit weiteren Sensoren andere Analytkonzentrationen oder physiologische Parameter zu bestimmen und anhand der ermittelten Konzentration von verschiedenen Analyten eine Plausibilitätsprüfung der einzelnen Resultate durchzuführen.

[0005] Trotz der auf diese Weise erzielten Verbesserungen ist es mit bekannten Elektrodensystemen nicht möglich, die Glukosekonzentration in dem Körper eines Diabetikers mit ausreichender Genauigkeit zu messen, um mit hinreichender Zuverlässigkeit vor sehr tiefen oder sehr hohen Glukosekonzentrationswerten zu warnen, die Gegenmaßnahmen des Patienten erfordern.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, einen Weg aufzuzeigen, wie Analytkonzentrationen mit größerer Genauigkeit in einem menschlichen oder tierischen Körper gemessen werden kann.

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein implantierbares Elektrodensystem zum Messen einer Analytkonzentration in einem menschlichen oder tierischen Körper, umfassend eine erste und eine zweite Meßelektrode zum Ermitteln von Meßsignalen, die jeweils eine Information über die zu messende Analytkonzentration enthalten, wobei die erste Meßelektrode eine erste Meßsensitivität hat, die an einen ersten Konzentrationsbereich des Analyten angepaßt ist, und die zweite Meßelektrode eine zweite Meßsensitivität hat, die von der ersten Meßsensitivität verschieden und an einen zweiten Konzentrationsbereich des Analyten angepaßt ist.

[0008] Die Aufgabe wird ferner gelöst durch eine Vor-

richtung zum Messen einer Analytkonzentration in einem menschlichen oder tierischen Körper, umfassend ein derartiges Elektrodensystem, eine an das Elektrodensystem angeschlossene Auswerteeinheit zum Auswerten von Meßsignalen der ersten und der zweiten Meßelektrode, und einen Speicher, in dem mindestens ein die Meßsensitivität der ersten Meßelektrode charakterisierender erster Sensitivitätsparameter und mindestens ein die Meßsensitivität der zweiten Meßelektrode charakterisierender zweiter Sensitivitätsparameter gespeichert sind, wobei die Auswerteeinheit derart ausgebildet ist, daß durch Auswertung mindestens eines Meßsignals einer der beiden Meßelektroden feststellbar ist, in welchem Konzentrationsbereich die Analytkonzentration liegt, und falls die Analytkonzentration in dem ersten Konzentrationsbereich liegt, das Meßsignal der ersten Meßelektrode mittels des ersten Sensitivitätsparameters zum Bestimmen der Analytkonzentration ausgewertet wird, und falls die Analytkonzentration in dem zweiten Konzentrationsbereich liegt, das Meßsignal der zweiten Meßelektrode mittels des zweiten Sensitivitätsparameters zum Bestimmen der Analytkonzentration ausgewertet wird.

[0009] Bei einer derartigen Vorrichtung können die Konzentrationsbereiche der Meßelektroden überlappen.

Es ist sogar möglich, daß der Konzentrationsbereich einer Meßelektrode als kleiner Teilbereich vollständig in dem wesentlich größeren Konzentrationsbereich einer anderen Meßelektrode enthalten ist. Es ist deshalb möglich, daß beispielsweise das Meßsignal der ersten Meßelektrode stets ausgewertet wird und das Meßsignal der zweiten Meßelektrode nur dann herangezogen wird, wenn die Auswertung des ersten Meßsignals ergibt, daß die Analytkonzentration in dem Konzentrationsbereich der zweiten Meßelektrode liegt.

[0010] Die Aufgabe wird ferner gelöst durch ein Verfahren zum Messen einer Analytkonzentration in einem menschlichen oder tierischen Körper mittels eines implantierten Elektrodensystems, das eine erste Meßelektrode mit einer ersten Meßsensitivität und eine zweite Meßelektrode mit einer zweiten Meßsensitivität, die von der ersten Meßsensitivität verschieden ist, umfaßt, wobei in einem ersten Konzentrationsbereich liegende Analytkonzentrationen durch Auswertung eines Meßsignals der ersten Meßelektrode und in einem zweiten Konzentrationsbereich liegende Analytkonzentrationen durch Auswertung eines Meßsignals der zweiten Meßelektrode ermittelt werden.

[0011] Im Rahmen der Erfindung wurde erkannt, daß sich im menschlichen oder tierischen Körper stark schwankende Analytkonzentrationen nicht ohne Einschränkung der Meßgenauigkeit mit einer einzigen Meßelektrode bestimmen lassen. Je größer nämlich der Meßbereich einer Meßelektrode gewählt wird, desto geringer ist typischerweise die Meßsensitivität bei niedrigen Konzentrationen. Anstatt bei der Konzeption einer Meßelektrode einen optimalen Kompromiß zwischen einem möglichst großen Meßbereich und einer möglichst hohen Meßsensitivität anzustreben, wird erfindungsgemäß ein

großer Meßbereich durch die Verwendung von mehreren Meßelektroden erzielt, die unterschiedliche Meßbereiche abdecken und entsprechend unterschiedliche Meßsensitivitäten haben. Indem die Meßsensitivität der ersten Meßelektrode für einen ersten Konzentrationsbereich optimiert ist und die Meßsensitivität der zweiten Meßelektrode für einen zweiten Konzentrationsbereich optimiert ist, kann ohne Beschränkung der Meßgenauigkeit ein größerer Meßbereich realisiert werden.

[0012] Unabhängig davon, ob die Analytkonzentration in der Umgebung der Meßelektroden in Bezug auf einen physiologischen Normal- oder Durchschnittswert relativ hoch oder niedrig ist, kann deshalb mit einem erfindungsgemäßen Elektrodensystem die Analytkonzentration stets mit einer Meßelektrode gemessen werden, die eine für den betreffenden Konzentrationsbereich günstige Meßsensitivität hat. Auf diese Weise kann für beliebig große Meßbereiche eine deutliche Verbesserung der Meßgenauigkeit erzielt werden.

[0013] Da mit einem erfindungsgemäßen Elektrodensystem ein wesentlich verbesserte Meßgenauigkeit erreicht werden kann, ist eine statistische Auswertung von Meßsignalen verschiedener Meßelektrode, wie sie im Stand der Technik praktiziert wird, nicht erforderlich, so daß erfindungsgemäß mit einfacheren Mitteln eine höhere Meßgenauigkeit erreicht werden kann. Selbstverständlich ist jedoch möglich in einem Elektrodensystem mehrere erste Meßelektroden für einen oberen Konzentrationsbereich und mehrere zweite Meßelektroden für einen unteren Konzentrationsbereich einzusetzen, um die Störanfälligkeit des Systems zu senken oder durch eine statistische Auswertung die Meßgenauigkeit weiter zu verbessern.

[0014] Falls in einem Elektrodensystem mehrere erste oder mehrere zweite Meßelektroden eingesetzt werden, erfordert eine statistische Auswertung zur Verbesserung der Meßgenauigkeit eine getrennte Ansteuerung der einzelnen Meßelektroden. Bei einem erfindungsgemäßen Elektrodensystem können mehrere gleiche Meßelektroden aber auch in Parallelschaltung mit einer gemeinsamen Ansteuerung angeordnet werden, so daß das Stromsignal erhöht und das Signal-Rauschverhältnis auch ohne eine statistische Auswertung verbessert werden kann. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn die betreffenden Meßelektroden an der unteren Grenze des für sie vorgesehenen Meßbereichs messen, da das Signal-Rauschverhältnis generell um so ungünstiger ist, je kleiner die zu messende Analytkonzentration ist.

[0015] Falls aus Gründen des einfachen Aufbaus darauf verzichtet wird, mehrere gleiche Meßelektroden zu verwenden, wird bevorzugt die Fläche der Meßelektrode mit der geringeren Meßsensitivität größer, bevorzugt mindestens 50% größer, als die Fläche der Meßelektrode mit der (nächst) höheren Meßsensitivität gewählt. Auf diese Weise kann auch bei einer geringeren Meßsensitivität ein erhöhtes Stromsignal erhalten und somit das Signal-Rauschverhältnis verbessert werden.

[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in

den Figuren dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Die darin dargestellten Besonderheiten können einzeln oder in Kombination verwendet werden, um bevorzugte Ausgestaltungen zu schaffen. Gleiche oder einander entsprechende Bauteile sind mit übereinstimmenden Bezugszeichen gekennzeichnet. Es zeigen:

5

Fig. 1 ein Ablaufschema für die Ermittlung einer Analytkonzentration mit einem erfindungsgemäßen Elektrodensystem;

10

Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Elektrodensystems;

15

Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Elektrodensystems;

Fig. 4 das in Figur 3 dargestellte Elektrodensystem in einer Querschnittsdarstellung;

20

Fig. 5 ein Beispiel einer Kennlinie einer ersten Meßelektrode eines erfindungsgemäßen Elektrodensystems;

25

Fig. 6 ein Beispiel einer Kennlinie einer zweiten Meßelektrode eines erfindungsgemäßen Elektrodensystems; und

30

Fig. 7 eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Messen einer Analytkonzentration mit einem erfindungsgemäßen Elektrodensystem.

35

[0017] Glukose ist ein wichtiges Beispiel für einen Analyten, dessen Konzentration im Blut und in anderen Körperflüssigkeiten eines Patienten im Tagesverlauf starken Schwankungen zwischen 40 mg/dl und 450 mg/dl unterliegen kann. Im folgendem wird deshalb ohne Beschränkung der Allgemeinheit die Ermittlung von Analytkonzentrationen am Beispiel von Messungen der Glukosekonzentration in Blut oder interstitieller Flüssigkeit erläutert.

40

[0018] In Figur 1 ist ein Ablaufschema für die Ermittlung der Glukosekonzentration mit einem implantierbaren Elektrodensystem dargestellt, das zwei galvanisch getrennte Meßelektroden mit unterschiedlicher Sensitivität umfaßt. Eine erste Meßelektrode hat eine erste Meßsensitivität, die für einen ersten Konzentrationsbereich des Analyten von 80 mg/dl bis 500 mg/dl optimiert ist. Eine zweite Meßelektrode hat eine zweite Meßsensitivität, die für einen zweiten Konzentrationsbereich des Analyten von 20 mg/dl bis 80 mg/dl optimiert ist. Der erste Konzentrationsbereich ist also von dem zweiten Konzentrationsbereich verschieden. Bevorzugt unterscheiden sich die Obergrenzen der Konzentrationsbereiche mindestens um einen Faktor zwei.

55

[0019] Die Meßelektroden liefern jeweils ein Meßsignal in Form eines elektrischen Stroms, dessen Stärke von der Analytkonzentration in der Umgebung der

Meßelectroden abhängt. Für jede Meßelectrode beschreibt eine Kennlinie, die durch ein Sensitivitätsparameter charakterisiert sein kann, den Zusammenhang zwischen dem Strom I als Meßsignal und der dazugehörigen Analytkonzentration C .

[0020] Zur Bestimmung der Analytkonzentration wird in einem ersten Arbeitsschritt 10 das Meßsignal der ersten Meßelectrode mittels einer Kennlinie 20 ausgewertet und ein Wert C_F für die Analytkonzentration bestimmt. In einem anschließenden Schritt 30 wird geprüft, ob der anhand des Meßsignals der ersten Meßelectrode ermittelte Wert C_F in dem Konzentrationsbereich liegt, für den die Meßsensitivität der ersten Meßelectrode optimiert ist. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist die erste Meßelectrode für Analytkonzentrationen von mehr als 80 mg/dl optimiert. Wird festgestellt, daß der ermittelte Wert C_F in dem ersten Konzentrationsbereich liegt, d. h. 80 mg/dl übersteigt, so wird der Wert C_F als Ergebnis ausgegeben.

[0021] Beträgt der anhand der ersten Meßelectrode ermittelte Konzentrationswert C_F weniger als 80 mg/dl, wird anschließend das Meßsignal der zweiten Meßelectrode anhand der Kennlinie 40 der zweiten Meßelectrode ausgewertet.

[0022] Bevorzugt hat die Kennlinie 40 der zweiten Meßelectrode bei kleinen Konzentrationswerten einen möglichst steilen Anstieg, so daß sich für niedrige Konzentrationen ein möglichst hohes Signal-Rauschverhältnis ergibt. Da der maximal als Meßsignal mögliche Strom begrenzt ist, bewirken Sättigungseffekte bei höheren Konzentrationen einen konstanten oder nahezu konstanten Maximalstrom I_{lim} . Im Gegensatz dazu hat die Kennlinie 20 der ersten Meßelectrode einen möglichst linearen Verlauf, so daß sich auch hohe Analytkonzentrationen ohne den Einfluß von Sättigungseffekten zuverlässig bestimmen lassen. Während bei der ersten Kennlinie 20 eine Auswertung von kleinen Meßströmen I , die mit niedrigen Konzentrationen korrespondieren, durch ein ungünstiges Signal-Rauschverhältnis erschwert ist, lassen sich mit der zweiten Kennlinie 40 Meßströme I , die einen Schwellenwert I_{lim} übersteigen, wegen Sättigungseffekten nicht sinnvoll auswerten.

[0023] In einem Arbeitsschritt 50 wird deshalb geprüft, ob der Meßstrom I der zweiten Meßelectrode kleiner als ein vorgegebener Schwellenwert I_{lim} ist. Falls dies der Fall ist, ist ein durch Auswertung des Meßsignals der zweiten Meßelectrode gewonnener Konzentrationswert C_H zuverlässiger als der anhand der ersten Meßelectrode bestimmte Konzentrationswert C_F , so daß der Konzentrationswert C_H als Ergebnis ausgegeben wird. Falls jedoch der Meßstrom der zweiten Meßelectrode größer oder gleich dem Schwellenwert I_{lim} ist, ist der anhand der ersten Meßelectrode bestimmte Konzentrationswert C_F zuverlässiger als der anhand der zweiten Meßelectrode bestimmte Konzentrationswert C_H , so daß der Wert C_F als Konzentrationswert ausgegeben wird.

[0024] Prinzipiell kann auf den Arbeitsschritt 50 verzichtet werden, wenn der in dem Arbeitsschritt 30 geprüf-

te Schwellenwert, der bei dem dargestellten Beispiel 80 mg/dl beträgt, geeignet gewählt wird. Nach der Implantation eines Elektrodensystems kann es jedoch zu Änderungen der Meßsensitivität der einzelnen Meßelectroden kommen, so daß der Sättigungsbereich der zweiten Meßelectrode schon bei kleineren Konzentrationen beginnt. In dem Arbeitsschritt 50 kann dies erkannt werden und gegebenenfalls der Konzentrationsbereich, in dem Analytkonzentrationen mit der ersten Meßelectrode bestimmt werden, etwas zu tieferen Analytkonzentrationen hin ausgedehnt werden. Möglich ist es auch, den Konzentrationsbereich für den die erste Meßelectrode optimiert ist, und den Konzentrationsbereich für den die zweite Meßelectrode optimiert ist, überlappend zu wählen und in einem Überlappungsbereich die Analytkonzentration mittels einer statistischen Auswertung aus einem Auswertergebnis der ersten Meßelectrode und einem Auswertungsergebnis der zweiten Meßelectrode zu ermitteln. Beispielsweise kann der Überlappungsbereich von 70 mg/dl bis 100 mg/dl gewählt werden. Die statistischen Gewichte, mit denen die Ergebnisse der ersten und der zweiten Meßelectrode in dem Überlappungsbereich gewichtet werden, können unter Berücksichtigung des Signal-Rauschverhältnisses des jeweiligen Meßsignals gewählt werden.

[0025] In Figur 2 ist ein Ausführungsbeispiel eines Elektrodensystems 1 dargestellt, mit dem sich das beschriebene Verfahren durchführen läßt. Das Elektrodensystem 1 umfaßt eine erste Meßelectrode 2 und eine zweite Meßelectrode 3, die jeweils unterschiedliche Meßsensitivitäten haben. Den beiden Meßelectroden 2, 3 ist eine gemeinsame Gegenelectrode 4 zugeordnet, die im Betrieb auf Massepotential gelegt wird, so daß zwischen der ersten Meßelectrode 2 und der Gegenelectrode 4 ein erster Meßstrom I_1 und zwischen der zweiten Meßelectrode 3 und der Gegenelectrode 4 ein zweiter Meßstrom I_2 fließt. Das Elektrodensystem 1 umfaßt ferner eine Referenzelectrode 5, die ein Bezugspotential für die Meßelectroden 2, 3 liefert. Das Bezugspotential wird bevorzugt durch die Redoxreaktion Silber/Silberchlorid definiert, wobei selbstverständlich auch andere Redoxreaktionen für die Referenzelectrode genutzt werden können.

[0026] Prinzipiell kann auf eine separate Referenzelectrode 5 verzichtet werden und die Gegenelectrode 4 zugleich als Referenzelectrode genutzt werden. Da durch die Gegenelectrode 4 jedoch die Meßströme I_1 und I_2 fließen, würde dann die das Referenzpotential definierende Redoxreaktion (beispielsweise Silber/Silberchlorid) mit der Zeit zum Erliegen kommen, so daß die Lebensdauer des Elektrodensystems begrenzt wäre. Mit einer separaten Referenzelectrode 5 kann das Referenzpotential stromlos zur Verfügung gestellt werden, so daß sich in dieser Hinsicht keine Beschränkung für die Lebensdauer des Elektrodensystems ergibt.

[0027] In Figur 3 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel eines implantierbaren Elektrodensystems 1 dargestellt, das sich von dem in Figur 2 dargestellten Ausführungs-

beispiel abgesehen von Form und Anordnung der einzelnen Elektroden dadurch unterscheidet, daß insgesamt drei Meßelektroden 2, 3, 7 vorhanden sind. Ähnlich wie bei dem in Figur 2 dargestellten Elektrodensystem 1 dient die zweite Meßelektrode 3 dazu, Glukosekonzentrationen unterhalb von 80 g/dl zu messen. Während bei dem in Figur 2 dargestellten Ausführungsbeispiel die erste Meßelektrode 2 für den gesamten Konzentrationsbereich oberhalb von 80 g/dl verwendet wird, ist bei dem in Figur 3 dargestellten Elektrodensystem 3 eine dritte Meßelektrode für Konzentrationen von mehr als 300 mg/dl vorhanden.

[0028] Insbesondere bei Verwendung von mehr als zwei Meßelektroden ist es günstig, die Meßsensitivitäten der einzelnen Meßelektroden so zu wählen, daß sich überlappende Meßbereiche ergeben. Überlappt beispielsweise der erste Konzentrationsbereich, für den die Meßsensitivität der ersten Meßelektrode 2 optimiert ist, mit dem zweiten Konzentrationsbereich, für den die zweite Meßelektrode 3 optimiert ist, sind in dem Überlappungsbereich Plausibilitätsprüfungen möglich. Ferner können Analytkonzentrationen in dem oder den Überlappungsbereichen mittels einer statistischen Auswertung aus Auswertungsergebnissen von verschiedenen Meßelektroden ermittelt werden.

[0029] In Figur 4 ist das in Figur 3 dargestellte Elektrodensystem in einem Querschnitt dargestellt, wobei die Schnittlinie durch die Meßelektroden 2, 3 und 7 verläuft. Die Elektroden 2, 3, 4, 5 und 7 sind auf einem gemeinsamen Träger 8, der bevorzugt aus Kunststoff, beispielsweise aus Polyimid besteht, angeordnet und durch Leiterbahnen 6 kontaktiert, über die das Elektrodensystem 1 an eine Auswerteeinheit (nicht dargestellt) angeschlossen werden kann. Im Betrieb stellt die Auswerteeinheit das Potential der Meßelektroden 2, 3, 7 auf einen vorgegebenen Wert von beispielsweise 350 mV gegenüber der Referenzelektrode 5 ein. Obwohl die Meßelektroden, beispielsweise durch Anlagerungen von Proteinen nach Implantation gegenüber dem Massepotential der Meßelektrode 4 driften, können auf diese Art und Weise definierte Verhältnisse für eine präzise Auswertung der Meßströme geschaffen werden, da davon ausgegangen werden kann, daß die Meßelektroden 2, 3, 7 in gleicher Weise wie die Referenzelektrode 5 Drifteffekten unterliegen.

[0030] Die Meßelektroden 2, 3, 7 haben jeweils eine Fläche von 0,1 mm² bis 0,5 mm² und bestehen ebenso wie die Leiterbahnen 6 aus Gold. Die Meßelektroden 2, 3, 7 sind jeweils mit einer Enzymschicht 9 belegt, die ein Enzym enthält, das durch katalytische Umwandlung des Analyten Ladungsträger erzeugt, die für das Meßsignal erfaßt werden. Die Ladungsträger können entweder direkt oder durch Umsetzung eines Zwischenprodukts, das von dem Enzym zunächst gebildet wird, erzeugt werden. Ein Beispiel für ein derartiges Zwischenprodukt ist Wasserstoffperoxid. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Enzymschichten 9 als Karbonschichten ausgebildet, die das Enzym Glukoseoxidase immobilisieren.

Die Enzymschichten haben eine Dicke von 3 µm bis 10 µm, bevorzugt 5 µm.

[0031] Die unterschiedlichen Meßsensitivitäten der Meßelektroden 2, 3, 7 werden bevorzugt dadurch erzeugt, daß mindestens eine der beiden Meßelektroden 2, 3, 7 eine Deckschicht 11 aufweist, die dem Analyten einen Diffusionswiderstand entgegensetzt, wobei durch Anpassung des Diffusionswiderstandes ein Unterschied zwischen den Meßsensitivitäten der Meßelektroden 2, 3 und 7 realisiert ist. Da der Diffusionswiderstand einer Deckschicht 11 um so größer ist, je dicker die betreffende Deckschicht 11 ist, lassen sich unterschiedliche Diffusionswiderstände am einfachsten durch unterschiedlich dicke Deckschichten 11 realisieren.

[0032] Beispielsweise kann hierfür auf der ersten Meßelektrode 2 eine 30 µm dicke Deckmembran aus einem schwachquellenden Polymer, beispielsweise Polyurethan und auf der zweiten Meßelektrode 3 eine nur 10 µm starke Deckmembran aus dem selben Material aufgebracht werden. Bedingt durch unterschiedliche Diffusionswiderstände der Deckschichten der Meßelektroden 2, 3 erreichen pro Zeiteinheit unterschiedlich viele Glukosemoleküle, die Enzymschichten der Meßelektroden 2, 3. Von dem in der Enzymschicht gespeichertem Enzym Glukoseoxidase werden Glukosemoleküle abgebaut, so daß Ladungsträger frei werden, die an den Meßelektroden 2, 3 erfaßt werden und auf diese Weise die Meßströme I1 und I2 bilden. Unterschiedliche Diffusionswiderstände können im einfachsten Fall durch eine unterschiedliche Dicke der Deckschichten der Meßelektroden 2, 3 realisiert werden.

[0033] Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Mikrostruktur der Deckschichten, beispielsweise deren Porosität, unterschiedlich zu gestalten oder die Deckschichten aus unterschiedlichen Materialien herzustellen. Beispielsweise kann für die Deckschicht 11 der Meßelektrode 7 für hohe Konzentrationen Silikon verwendet werden, das für Glukosemoleküle relativ undurchlässig ist, für die Deckschicht 11 der Meßelektrode 3 für mittlere Konzentrationen Polyurethan verwendet werden, das für Glukosemoleküle relativ durchlässig ist und für die Meßelektrode 2 auf eine Deckschicht verzichtet werden.

[0034] Für die Deckschicht 11 sind schwachquellende Polymere, wie beispielsweise Polyurethan besonders günstig. Die Dicke der Deckmembran beträgt bevorzugt weniger als 50 µm, besonders bevorzugt 10 µm bis 30 µm.

[0035] Bedingt durch die unterschiedlichen Diffusionswiderstände der Deckschichten 11 der Meßelektroden 2, 3 erreichen pro Zeiteinheit unterschiedlich viele Glukosemoleküle, die Enzymschichten der Meßelektroden 2, 3. Von dem in der Enzymschicht gespeichertem Enzym Glukoseoxidase werden die Glukosemoleküle abgebaut, so daß Ladungsträger frei werden, die an den Meßelektroden 2, 3 erfaßt werden und auf diese Weise unterschiedliche Meßströme bilden.

[0036] Eine weitere Möglichkeit unterschiedliche Meßsensitivitäten der ersten und der zweiten Meßelek-

trode 2, 3 zu realisieren, besteht darin, unterschiedliche Enzymschichten 9 einzusetzen. Beispielsweise kann zur Erhöhung der Meßsensitivität der ersten Meßelektrode 2 die Enzymmenge in der Enzymschicht 9 doppelt so groß gewählt werden, wie für die Enzymschicht 9 der zweiten Meßelektrode 3.

[0037] Die Meßelektroden 2, 3, 7 sind ferner von einer Dialysemembran 12 bedeckt, die sich bevorzugt über die gesamte Oberfläche des Elektrodensystems 1 erstreckt. Unter einer Dialysemembran 12 wird in diesem Zusammenhang eine Membran verstanden, die für Moleküle oberhalb einer Maximalgröße undurchlässig ist. Die Dialysemembran 12 wird in einem separaten Herstellungsprozeß vorgefertigt und als vollständige, bestehende Struktur bei der Fertigung des Elektrodensystems 1 aufgebracht. Diese Maximalgröße der Dialysemembran wird für das dargestellte Elektrodensystem 1 so gewählt, daß Analytmoleküle durch die Dialysemembran 12 hindurch treten können, größere Moleküle jedoch abgehalten werden. Beim dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Dialysemembran 12 als eine poröse Schicht aus einem geeignetem Kunststoff, insbesondere Polyarylethersulfon, ausgebildet. Durch eine Dialysemembran 12 läßt sich die effektive Oberfläche der Meßelektroden 2, 3, 7 vergrößern und folglich das Signal-Rauschverhältnis verbessern. Prinzipiell kann auf eine Dialysemembran jedoch verzichtet werden, sofern alle Meßelektroden mit einer Deckschicht 11 versehen sind.

[0038] Wichtig für ein zuverlässiges Funktionieren des beschriebenen Elektrodensystems 1 ist, daß sämtliche Meßelektroden 2, 3, 7 der selben Analytkonzentration ausgesetzt sind. Bevorzugt sind die einzelnen Meßelektroden 2, 3, 7 deshalb weniger als 1,5 mm, bevorzugt weniger als 1 mm, besonders bevorzugt weniger als 700 µm voneinander entfernt. Werden mehrere Meßelektroden verwendet, ist deshalb darauf zu achten, daß auch zwischen den am weitesten voneinander entfernten Meßelektroden keine zu großen Abstände auftreten. Im Bereich des Elektrodensystems 1 lassen sich homogene Analytkonzentrationen, beispielsweise durch eine ausreichend dicke Dialysemembran bewirken. Bevorzugt hat die Dialysemembran deshalb eine Dicke von 50 µm bis 500 µm, besonders bevorzugt 100 µm bis 300 µm.

[0039] Eine weitere Möglichkeit, die Analytkonzentrationen im Bereich des Elektrodensystems 1 zu homogenisieren besteht darin, die Dialysemembran 12 nicht unmittelbar auf den Meßelektroden 2, 3, 7 anzuordnen, sondern die Meßelektroden 2, 3, 7 in einer kleinen Kammer anzuordnen, die von der Dialysemembran verschlossen ist. Eine derartige Kammer läßt sich beispielsweise dadurch verwirklichen, daß die Meßelektroden 2, 3, 7 in einer geeigneten Vertiefung des Trägers 8 angeordnet werden und die Vertiefung von der Dialysemembran 12 bedeckt wird. Die Höhe einer solchen Kammer, d. h. der Abstand von der Oberfläche der Meßelektroden 2, 3, 7 (bzw. deren Deckschicht 11) bis zu der Unterseite der Dialysemembran 12 beträgt bevorzugt weniger als 400 µm, besonders bevorzugt weniger als 300 µm.

[0040] Eine derartige Kammer hat ebenso wie eine dicke Dialysemembran den Vorteil als Reservoir für den Analyten zu dienen, so daß eine vorübergehende lokale Blockade der Dialysemembran 12 ausgeglichen werden kann.

[0041] In Figur 5 ist die im Zusammenhang von Figur 1 bereits erläuterte Kennlinie 20 im Detail dargestellt, welche die funktionale Abhängigkeit des das Meßsignal der ersten Meßelektrode 2 darstellenden Stroms I von der Analytkonzentration C darstellt. In der Praxis wird die Meßgenauigkeit bei der Bestimmung hoher Analytkonzentrationen durch Sättigungseffekte beschränkt. Um die Meßsensitivität der ersten Meßelektrode für hohe Analytkonzentrationen zu optimieren, ist es deshalb günstig, über den gesamten physiologisch relevanten Konzentrationsbereich einen möglichst linearen Verlauf der Kennlinie anzustreben.

[0042] Im menschlichen Körper kommen Glukosekonzentrationen von mehr als 450 mg/dl praktisch nicht vor, so daß der Verlauf der in Figur 5 dargestellten Kennlinie oberhalb von 450 mg/dl ohne Belang ist. Ist der Zusammenhang zwischen Strom I und Konzentration C linear, so läßt sich die Sensitivität der Meßelektrode durch einen einzigen Sensitivitätsparameter charakterisieren, der die Ableitung der Kennlinie nach der Konzentration, d. h. die Steigung ist. In der Praxis läßt sich ein perfekt linearer Zusammenhang meist nicht realisieren, so daß zusätzliche Sensitivitätsparameter benötigt werden, um den Verlauf der Kennlinie zu beschreiben.

[0043] Damit der Einfluß von Sättigungseffekten möglichst vernachlässigbar ist, sollte die Sensitivität der ersten Meßelektrode 2 bei 450 mg/dl mindestens 80 % der Sensitivität bei 100 mg/dl betragen, wie dies bei in Figur 5 dargestellten Kennlinie der Fall ist. Des weiteren sollte die Sensitivität bei 100 mg/dl mindestens 0,1 nA/mg/dl betragen, so daß Konzentrationen oberhalb von 100 mg/dl mit einem ausreichend hohen Signal-Rauschverhältnis erfaßt werden können. Für Konzentrationen unterhalb von etwa 100 mg/dl führt die in Figur 5 dargestellte Kennlinie zu einem zunehmend ungünstigen Signal-Rauschverhältnis, so daß die Meßgenauigkeit für niedrige Konzentrationen unzureichend ist.

[0044] Zur Messung von Analytkonzentrationen unterhalb von 80 mg/dl wird deshalb eine zweite Meßelektrode verwendet, die im diesem niedrigen Konzentrationsbereich eine wesentlich höhere Sensitivität hat. Ein Beispiel der Kennlinie einer geeigneten Meßelektrode ist in Figur 6 dargestellt. Eine möglichst hohe Meßsensitivität bei niedrigen Konzentrationen bedeutet eine möglichst steile Kennlinie in dem entsprechenden Konzentrationsbereich. Da die mit implantierten Elektroden erzielbaren Meßströme begrenzt sind, ist eine hohe Meßsensitivität bei niedrigen Konzentrationen mit einer Sättigung bei höheren Konzentrationen verbunden. Dies zeigt sich in Figur 6 an einem deutlichen Abflachen der Kennlinie bei Konzentrationen von mehr als 200 mg/dl. Für hohe Konzentrationen ergibt sich deshalb ein sehr ungünstiges Signalrauschverhältnis, dem jedoch ein sehr günstiges

Signalrauschverhältnis bei tiefen Konzentrationen gegenübersteht.

[0045] Die Meßsensitivitäten der ersten Meßelektrode und der zweiten Meßelektrode unterscheiden sich bei einer Referenzkonzentration mindestens um einen Faktor 2, vorzugsweise mindestens um einen Faktor 3. Als Referenzkonzentration wird bevorzugt eine Konzentration aus dem ersten oder dem zweiten Konzentrationsbereich gewählt, beispielsweise das arithmetische Mittel aus der Obergrenze und der Untergrenze eines der Konzentrationsbereiche. Unter der Meßsensitivität ist dabei die Ableitung der Intensität des Meßsignals nach der Konzentration, d. h. die Steigung der Kennlinie bei der betreffenden Konzentration, zu verstehen.

[0046] Damit kritische Glukosekonzentrationen von 50 mg/dl mit der zweiten Meßelektrode zuverlässig erkannt werden können, sollte die Sensitivität der zweiten Meßelektrode zwischen 10 mg/dl und 100 mg/dl mindestens 1 nA/mg/dl betragen. Auf diese Weise ergeben sich bei einer kritischen Glukosekonzentration von 50 mg/dl Ströme von mindestens 50 nA, so daß ein Signalrauschverhältnis von 5 oder besser erreicht werden kann.

[0047] In Figur 7 ist eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Messen einer Analytkonzentration mit einem erfindungsgemäßen Elektrodensystem 1 dargestellt. Dabei ist das im vorhergehenden beschriebene Elektrodensystem 1 an eine Auswerteeinheit 23 in Form eines Mikroprozessors angeschlossen, die einen Speicher umfaßt, in dem mindestens ein die Meßsensitivität der ersten Meßelektrode 2 charakterisierender erster Sensitivitätsparameter und mindestens ein die Meßsensitivität der zweiten Meßelektrode 3 charakterisierender zweiter Sensitivitätsparameter gespeichert sind. Die Auswerteeinheit 23 stellt durch Auswertung mindestens eines Meßsignal einer der Meßelektroden 2, 3 fest, in welchem Konzentrationsbereich die Analytkonzentration in der Umgebung des Elektrodensystems liegt. Liegt die Analytkonzentration in dem Konzentrationsbereich, für den die Meßsensitivität der ersten Meßelektrode 2 optimiert ist, wird die Analytkonzentration durch Auswertung des Meßsignals der ersten Meßelektrode 2 ermittelt. Liegt die Analytkonzentration in dem Konzentrationsbereich, für den die Meßsensitivität der zweiten Meßelektrode 3 optimiert ist, wird die Analytkonzentration durch Auswertung des Meßsignals der zweiten Meßelektrode bestimmt.

[0048] Falls die Konzentrationsbereiche der einzelnen Meßelektroden 2, 3 überlappen, können Analytkonzentrationen in einem Überlappungsbereich auch durch Auswertung der Meßsignale von zwei Meßelektroden 2, 3 ermittelt werden.

[0049] Die erste Meßelektrode 2 ist an einen ersten Potentiostaten 21 und die zweite Meßelektrode 3 an einen zweiten Potentiostaten 22 angeschlossen. Die Potentiostaten 21, 22 werden jeweils von dem die Steuer- und Auswerteeinheit 23 bildenden Mikroprozessor gesteuert. Ein Potentiostat ist ein elektronischer Regel-

kreis, mit dem das an der betreffenden Meßelektrode 2, 3 anliegende Potential bezüglich einer Referenzelektrode 5 auf einen gewünschten Wert geregelt wird. Zwischen den Meßelektroden 2, 3, an denen die enzymatische Umsetzung des Analyten einschließlich Ladungsträgererzeugung bei entsprechender Potentialeinregulierung erfolgt, und der Gegenelektrode 4 fließt der zu messende Strom. Der Referenzpunkt wird durch die Referenzelektrode 5 dargestellt, deren Potential in der elektrochemischen Spannungsreihe definiert ist. Durch die Referenzelektrode 5 selbst fließt bevorzugt kein Strom.

[0050] Bei einem implantierten Elektrodensystem ist der maximale Meßstrom sehr begrenzt, da die für den Meßstrom erforderlichen Ladungsträger durch enzymatischen Abbau des Analyten erzeugt werden. Durch den Einfluß des Meßstroms und des verwendeten Enzyms droht deshalb die Analytkonzentration in der für die Messung relevanten Umgebung des Elektrodensystems 1 zu verarmen, insbesondere wenn das die Meßelektroden 2, 3 umgebende Körpergewebe nur relativ schwach von Körperflüssigkeit durchströmt wird, oder der Transport von Analytmolekülen in die Umgebung der Meßelektroden 2, 3 aus anderen Gründen, beispielsweise durch eine Blockade, gehemmt ist. Die Analytmenge, die von einer Meßelektrode im kontinuierlichen Meßbetrieb pro Minute typischerweise verbraucht wird, liegt im Pikomolbereich, ist also relativ klein. Dennoch kann durch die Verarmung der Analytkonzentration im Bereich der Meßelektroden 2, 3 eine Verfälschung der Messung auftreten. Im ungünstigsten Fall kann dieser Effekt zu einem physiologisch plausiblen Signalabfall führen, also eine Abnahme der Analytkonzentration im gesamten Körper des Patienten vortäuschen.

[0051] Mit der in Figur 7 dargestellten Vorrichtung läßt sich prüfen, ob ein mit dem Elektrodensystem 1 über einen bestimmten Zeitraum beobachteter Abfall der Glukosekonzentration eine natürliche Ursache hat und folglich im gesamten Körper des Patienten auftritt oder nur lokal in der Umgebung des Elektrodensystems auftritt. Ein nicht physiologischer Beitrag zu einem Signalabfall, der durch eine lokale Verarmung der Glukosekonzentration in der Umgebung der Meßelektroden 2, 3 verursacht wird, wird dadurch erkannt, daß an die Meßelektroden 2, 3 alternierend eine Meßspannung angelegt wird. Werden die Meßelektroden 2, 3 innerhalb eines zur Erkennung der Verarmung relevanten Zeitraums von mehreren Minuten getrennt an- und abgeschaltet, kann für jede Meßelektrode der Signalverlauf untersucht werden. Wird dabei für die Meßelektrode mit der höheren Meßsensitivität ein schnellerer Signalabfall festgestellt als für die Meßelektrode mit der niedrigeren Meßsensitivität, deutet dies auf eine Verarmung hin.

[0052] Durch einen einfachen Algorithmus, beispielsweise eine lineare Ausgleichsrechnung oder eine nicht-lineare Kurvenauswertung, können für die Meßströme der Meßelektroden 2, 3 jeweils charakteristische Abfallzeiten bestimmt werden, wobei ein sich einstellender Gleichgewichtszustand numerisch berücksichtigt wer-

den kann. Werden dabei von der Auswerteeinheit 23 innerhalb eines für die Verarmung relevanten Zeitraums für die Meßelektroden 2, 3 unterschiedliche charakteristische Abfallzeiten festgestellt, kann durch ein Alarmsignal auf die Unzuverlässigkeit der errechneten Glukosekonzentration hingewiesen werden.

[0053] Sofern die festgestellte Verarmung einen kritischen Schwellenwert nicht übersteigt, besteht die Möglichkeit, die durch den Meßstrom bewirkte Abnahme der Analytkonzentration numerisch bei der Auswertung der Meßströme zur Bestimmung der realen Analytkonzentration in dem Körper des Patienten zu kompensieren. Beispielsweise kann die Verbrauchskinetik der Ladungsträger in bezug auf den Analyten durch ein einfaches Modell erfaßt werden. Die von der Auswerteeinheit 23 auf der Grundlage der aktuellen Messungen ermittelten Abfallzeiten können mit theoretischen Werten des Modells verglichen werden und die Grundlage für eine numerische Kompensation der aus den Meßwerten ermittelten lokalen Analytkonzentration liefern.

[0054] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel führt die Auswerteeinheit 23 also bei der Auswertung der Meßsignale ein Aufbereitungsverfahren durch. Bei diesem Verfahren werden Korrekturdaten, die eine durch einen Meßstrom bewirkte lokale Abnahme der Analytkonzentration betreffen, berücksichtigt, wobei zu der Gewinnung der Korrekturdaten die an den Meßelektroden 2, 3 anliegenden Meßspannungen separat an- und abgeschaltet werden und der zeitliche Verlauf der Meßströme ausgewertet wird, insbesondere indem charakteristische Abfallzeiten der Meßströme bestimmt werden. Im einfachsten Fall kann es sich bei diesen Korrekturdaten um die charakteristischen Abfallzeiten selbst handeln.

[0055] Bei dem in Figur 7 dargestellten Ausführungsbeispiel bildet der Mikroprozessor 23 sowohl die Auswerteeinheit zum Auswerten der Meßsignale als auch die Steuereinheit, mit der die jeweils an den Meßelektroden 2,3 anliegenden Meßspannungen separat an- und abschaltbar sind. Die Auswerteeinheit 23 ist derart ausgebildet, daß eine nach dem Einschalten der Meßspannung für mindestens eine der Meßelektroden 2, 3 durch einen Meßstrom bewirkte lokale Abnahme der Analytkonzentration erkannt und bei der Auswertung zur Bestimmung der Analytkonzentration in dem menschlichen oder tierischen Körper berücksichtigt wird. Diese Berücksichtigung kann in der Weise erfolgen, daß durch ein Signal angezeigt wird, daß eine Bestimmung der Analytkonzentration derzeit nicht möglich ist. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die lokale Abnahme der Analytkonzentration quantitativ zu erfassen und numerisch bei der Berechnung der Analytkonzentration in dem Körper des Patienten zu kompensieren.

[0056] Die Auswerte- und Steuereinheit 23 kann beispielsweise auch zur Steuerung einer künstlichen Bauchspeicheldrüse dienen oder an eine Anzeigeeinrichtung angeschlossen sein, mit der ermittelte Analytkonzentrationen angezeigt oder/und ein Patient vor besonders hohen oder tiefen Analytkonzentrationen, die

Gegenmaßnahmen erfordern, durch ein geeignetes Signal, beispielsweise ein akustisches Signal, gewarnt wird. Besonders günstig ist es in diesem Zusammenhang, wenn die Datenübertragung zu der Anzeigeeinrichtung drahtlos, beispielsweise durch eine Infrarotschnittstelle oder mittels Ultraschall, erfolgt.

Patentansprüche

1. Implantierbares Elektrodensystem zum Messen einer Analytkonzentration in einem menschlichen oder tierischen Körper, umfassend eine erste und eine zweite Meßelektrode (2, 3) zum Ermitteln von Meßsignalen, die jeweils eine Information über die zu messende Analytkonzentration enthalten, wobei die erste Meßelektrode (2) eine erste Meßsensitivität hat, die an einen ersten Konzentrationsbereich des Analyten angepaßt ist, und die zweite Meßelektrode (3) eine zweite Meßsensitivität hat, die von der ersten Meßsensitivität verschieden ist und an einen zweiten Konzentrationsbereich des Analyten angepaßt ist.
2. Elektrodensystem nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** sich die Meßsensitivitäten der Meßelektroden (2, 3) bei einer Referenzkonzentration mindestens um einen Faktor 2, bevorzugt mindestens um einen Faktor 3 unterscheiden.
3. Elektrodensystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Meßelektroden (2, 3, 7) jeweils eine Enzymschicht (9) mit einem Enzym aufweisen, das durch katalytische Umwandlung des Analyten Ladungsträger erzeugt, die für das Meßsignal erfaßt werden.
4. Elektrodensystem nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** die unterschiedlichen Meßsensitivitäten der ersten und der zweiten Meßelektrode (2, 3) durch unterschiedliche Enzymschichten (9) mit unterschiedlichen Enzymen und/oder unterschiedlichen Enzymmengen realisiert sind.
5. Elektrodensystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** mindestens eine der Meßelektroden (2, 3, 7) eine Deckschicht (11) aufweist, die dem Analyten einen Diffusionswiderstand entgegengesetzt, wobei durch Anpassung des Diffusionswiderstands ein Unterschied zwischen den Meßsensitivitäten der ersten Meßelektrode (2) und der zweiten Meßelektrode (3) realisiert ist.
6. Elektrodensystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Meßelektroden (2, 3, 7) eine gemeinsame Gegen-

elektrode (4) haben.

7. Elektrodensystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, daß** es mindestens eine weitere Meßelektrode (7) umfaßt, deren Meßsensitivität an einen weiteren Konzentrationsbereich des Analyten angepaßt ist.

8. Vorrichtung zum Messen einer Analytkonzentration in einem menschlichen oder tierischen Körper, umfassend:

ein implantierbares Elektrodensystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, eine an das Elektrodensystem (1) angeschlossene Auswerteeinheit zum Auswerten von Meßsignalen der ersten und der zweiten Meßelektrode (2, 3), und einen Speicher, in dem mindestens ein die Meßsensitivität der ersten Meßelektrode (2) charakterisierender erster Sensitivitätsparameter und mindestens ein die Meßsensitivität der zweiten Meßelektrode (3) charakterisierende zweiter Sensitivitätsparameter gespeichert sind,

wobei die Auswerteeinheit (23) derart ausgebildet ist, daß durch Auswertung mindestens eines Meßsignals einer der Meßelektroden (2, 3) feststellbar ist, in welchem Konzentrationsbereich die Analytkonzentration liegt, und

falls die Analytkonzentration in dem ersten Konzentrationsbereich liegt, das Meßsignal der ersten Meßelektrode (2) mittels des ersten Sensitivitätsparameter zum Bestimmen der Analytkonzentration ausgewertet wird, und

falls die Analytkonzentration in dem zweiten Konzentrationsbereich liegt, das Meßsignal der zweiten Meßelektrode (3) mittels des zweiten Sensitivitätsparameter zum Bestimmen der Analytkonzentration ausgewertet wird.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, daß** der erste Konzentrationsbereich, für den die erste Meßelektrode (2) optimiert ist, und der zweite Konzentrationsbereich, für den die zweite Meßelektrode (3) optimiert ist, in einem Überlappungsbereich überlappen, und die Auswerteeinheit (23) so ausgebildet ist, daß sowohl das Meßsignal der ersten Meßelektrode (2) als auch das Meßsignal der zweiten Meßelektrode (3) jeweils ausgewertet werden, um festzustellen in welchem oder welchen Konzentrationsbereichen die Analytkonzentration liegt, und in dem Überlappungsbereich liegende Analytkonzentrationen mittels einer statistischen Auswertung aus einem Auswertungsergebnis der ersten Meßelektrode (2) und einem Auswertungsergebnis der zweiten Meßelektro-

de (3) ermittelt werden.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, **dadurch gekennzeichnet, daß** die erste Meßelektrode (2) an einen ersten Potentiostaten (21) und die zweite Meßelektrode (3) an einen zweiten Potentiostaten (22) angeschlossen ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 10, **dadurch gekennzeichnet, daß** die jeweils an den Meßelektroden (2, 3) anliegenden Meßspannungen mittels einer Steuereinheit (23) separat an- und abschaltbar sind, wobei die Auswerteeinheit (23) derart ausgebildet ist, daß eine nach dem Einschalten der Meßspannung für mindestens eine der Meßelektroden (2, 3) durch einen Meßstrom bewirkte lokale Abnahme der Analytkonzentration erkannt und bei der Auswertung zur Bestimmung der Analytkonzentration in dem menschlichen oder tierischen Körper berücksichtigt, vorzugsweise numerisch kompensiert, wird.

12. Verfahren zum Messen einer Analytkonzentration in einem menschlichen oder tierischen Körper mittels eines implantierten Elektrodensystems (1), das eine erste Meßelektrode (2) mit einer ersten Meßsensitivität und eine zweite Meßelektrode (3) mit einer zweiten Meßsensitivität, die von der ersten Meßsensitivität verschieden ist, umfaßt, wobei in einem ersten Konzentrationsbereich liegende Analytkonzentrationen durch Auswertung eines Meßsignals der ersten Meßelektrode (2) und in einem zweiten Konzentrationsbereich liegende Analytkonzentrationen durch Auswertung eines Meßsignals der zweiten Meßelektrode (3) ermittelt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12, **dadurch gekennzeichnet, daß** bei der Auswertung der Meßsignale Korrekturdaten, die eine durch einen Meßstrom bewirkte lokale Abnahme der Analytkonzentration betreffen, berücksichtigt werden, wobei zur Gewinnung der Korrekturdaten an den Meßelektroden (2, 3) anliegende Meßspannungen separat an- und abgeschaltet werden und der zeitliche Verlauf der Meßströme ausgewertet wird, insbesondere indem charakteristische Abfallzeiten der Meßströme bestimmt werden.

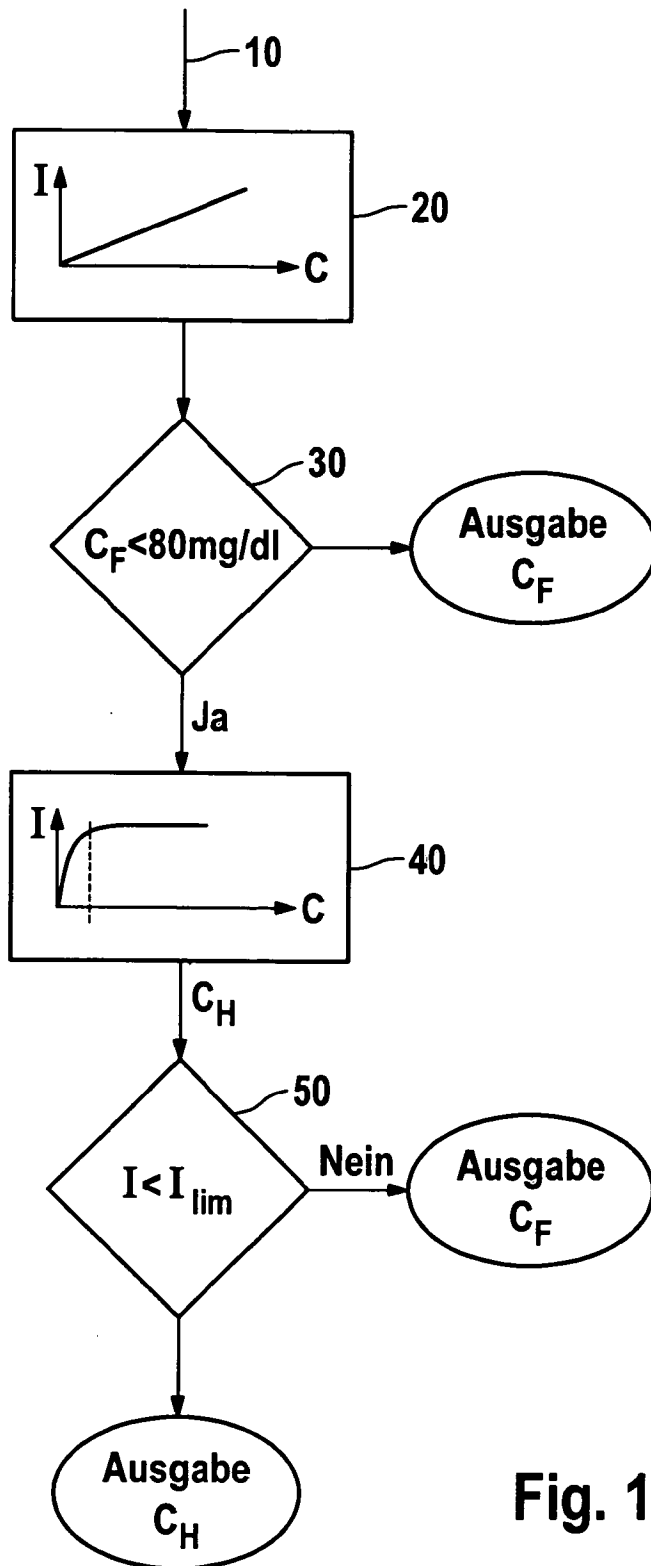


Fig. 1

Fig. 2

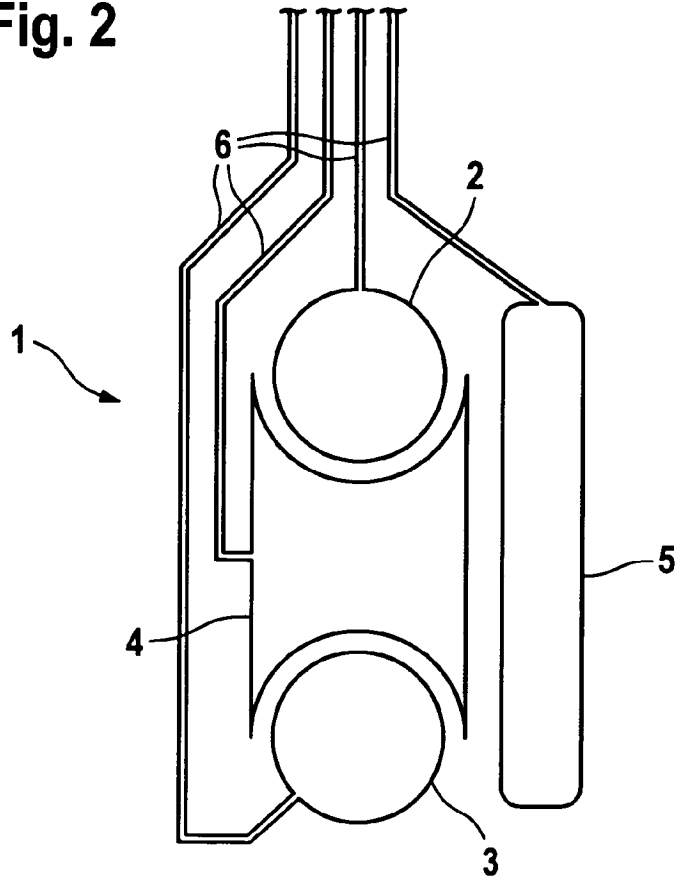


Fig. 3

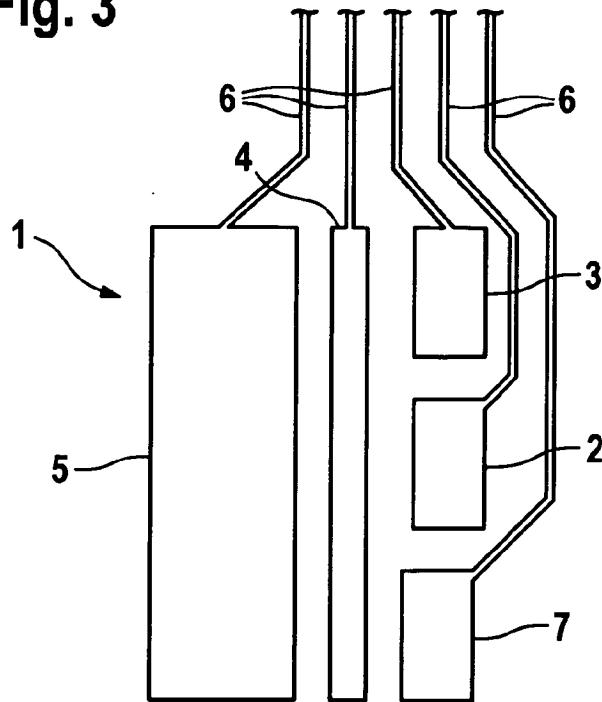


Fig. 4

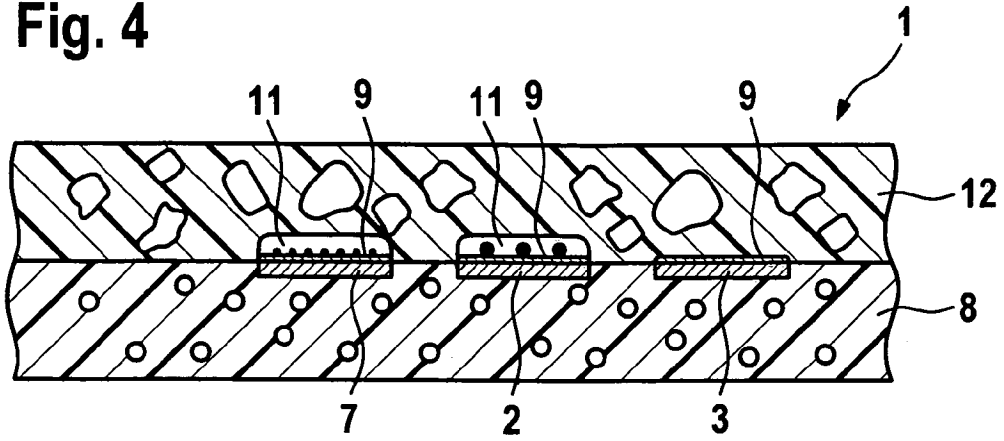
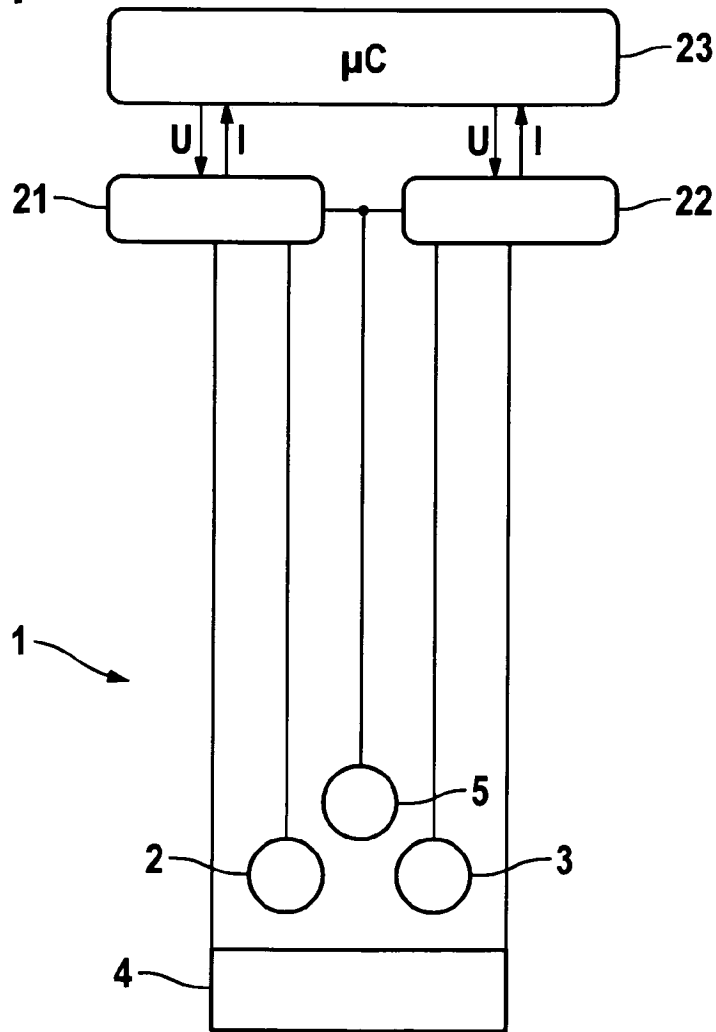


Fig. 7



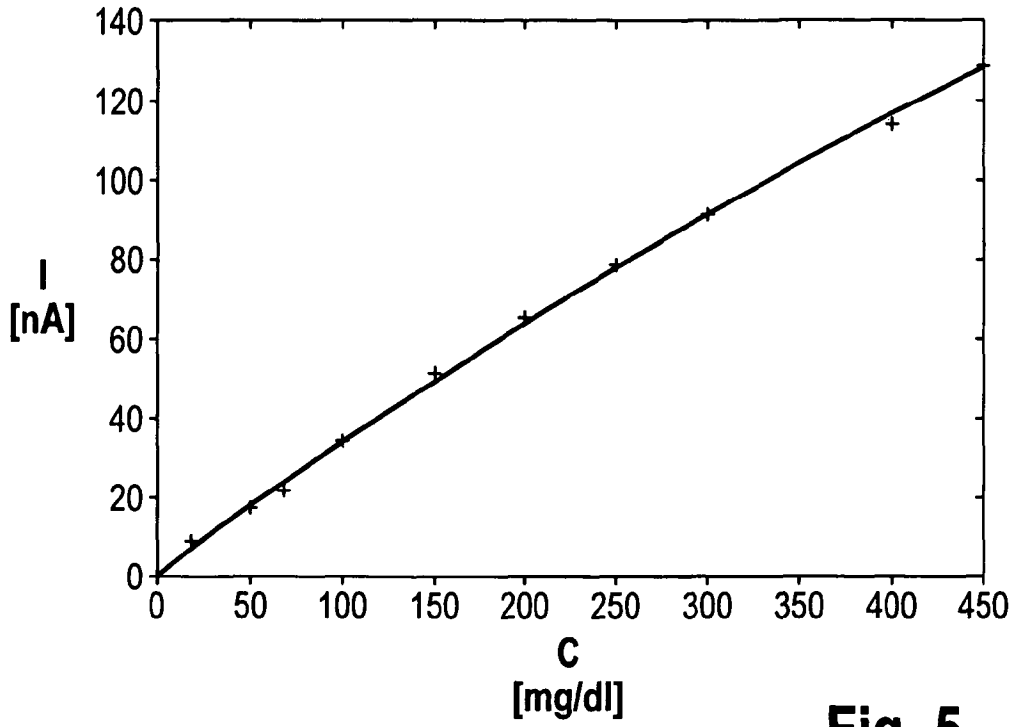


Fig. 5

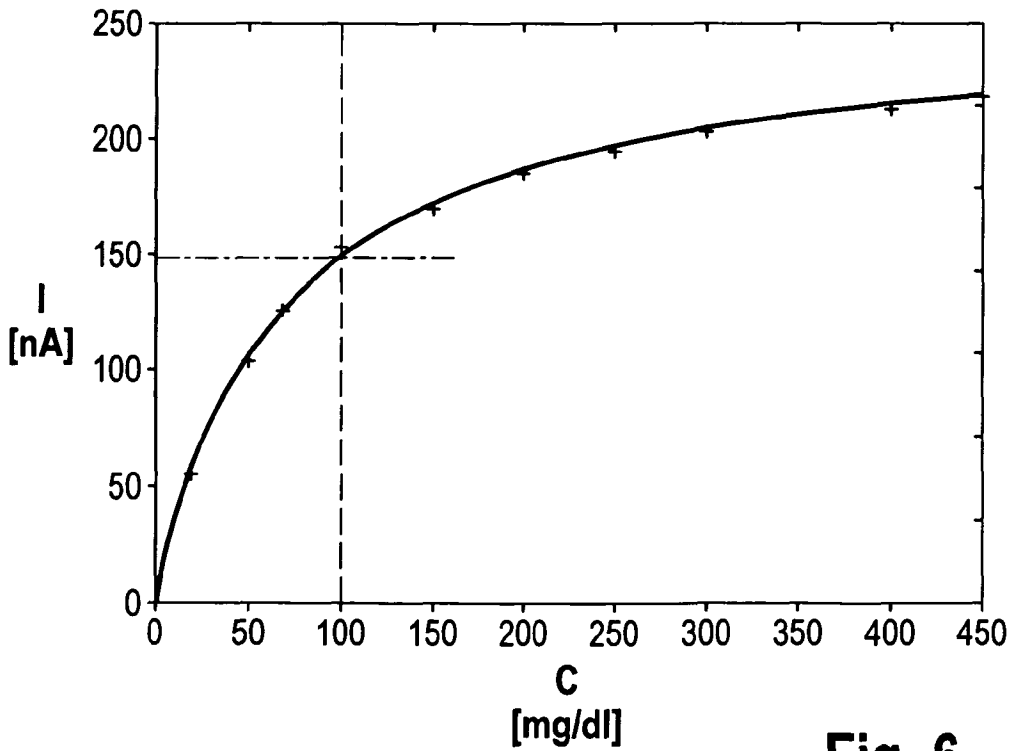


Fig. 6



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER TEILRECHERCHENBERICHT

der nach Regel 45 des Europäischen Patent-
übereinkommens für das weitere Verfahren als
europäischer Recherchenbericht gilt

Nummer der Anmeldung

EP 05 02 4760

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	QU Y ET AL: "Simultaneous determination of total and extracellular concentrations of the amino acid neurotransmitters in cat visual cortex by microbore liquid chromatography and electrochemical detection" JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, Bd. 798, Nr. 1-2, 6. März 1998 (1998-03-06), Seiten 19-26, XP004112336 ISSN: 0021-9673 Kapitel 2.3, 3.1	1,2	A61B5/00
X	----- US 2005/103625 A1 (RHODES RATHBUN ET AL) 19. Mai 2005 (2005-05-19) * Absatz [0049]; Abbildung 1 *	1-11	
X	----- US 2005/051427 A1 (BRAUKER JAMES H ET AL) 10. März 2005 (2005-03-10) * Absätze [0146], [0147]; Abbildungen 9,10 *	1-11	
	----- -/--		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC) A61B
UNVOLLSTÄNDIGE RECHERCHE			
<p>Die Recherchenabteilung ist der Auffassung, daß ein oder mehrere Ansprüche, den Vorschriften des EPÜ in einem solchen Umfang nicht entspricht bzw. entsprechen, daß sinnvolle Ermittlungen über den Stand der Technik für diese Ansprüche nicht, bzw. nur teilweise, möglich sind.</p> <p>Vollständig recherchierte Patentansprüche:</p> <p>Unvollständig recherchierte Patentansprüche:</p> <p>Nicht recherchierte Patentansprüche:</p> <p>Grund für die Beschränkung der Recherche:</p> <p>Siehe Ergänzungsblatt C</p>			
Recherchenort Berlin		Abschlußdatum der Recherche 7. April 2006	Prüfer Clevorn, J
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

2
EPO FORM 1503 03/02 (P04C09)



EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	
X,D	US 6 175 752 B1 (SAY JAMES ET AL) 16. Januar 2001 (2001-01-16) * Spalte 17, Zeile 66 - Spalte 18, Zeile 10 *	1-11	
A,D	----- US 2005/059871 A1 (GOUGH DAVID A ET AL) 17. März 2005 (2005-03-17) * das ganze Dokument *	1-11	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)



Vollständig recherchierte Ansprüche:

1-11

Nicht recherchierte Ansprüche:

12,13

Grund für die Beschränkung der Recherche (nicht patentfähige Erfindung(en)):

Artikel 52 (4) EPÜ - Verfahren zur chirurgischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 05 02 4760

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

07-04-2006

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2005103625 A1	19-05-2005	EP 1411823 A2	28-04-2004
		JP 2005525834 T	02-09-2005
		WO 03011131 A2	13-02-2003
		US 2003032874 A1	13-02-2003

US 2005051427 A1	10-03-2005	KEINE	

US 6175752 B1	16-01-2001	AU 2330799 A	23-11-1999
		EP 1075209 A1	14-02-2001
		JP 2002513602 T	14-05-2002
		WO 9956613 A1	11-11-1999
		US 6565509 B1	20-05-2003

US 2005059871 A1	17-03-2005	KEINE	

EPO FORM P461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- US 6175752 B1 [0001]
- US 20050059871 A1 [0004]

专利名称(译)	可植入电极系统，用于测量人体或动物体内分析物浓度的方法和装置		
公开(公告)号	EP1785085A1	公开(公告)日	2007-05-16
申请号	EP2005024760	申请日	2005-11-12
[标]申请(专利权)人(译)	罗氏诊断公司		
申请(专利权)人(译)	罗氏诊断有限公司 F.霍夫曼罗氏有限公司.		
当前申请(专利权)人(译)	罗氏诊断有限公司 F.霍夫曼罗氏有限公司.		
[标]发明人	STAIB ARNULF GILLEN RALPH		
发明人	STAIB, ARNULF GILLEN, RALPH		
IPC分类号	A61B5/00		
CPC分类号	A61B5/1486		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

可植入分析物浓度测量电极系统具有与显著不同浓度区域匹配的不同灵敏度的电极，其中第二电极电流与上阈值的比较 (50) 用于确定哪个电极电流被接受作为输出。使用电极的程序也包括独立权利要求。

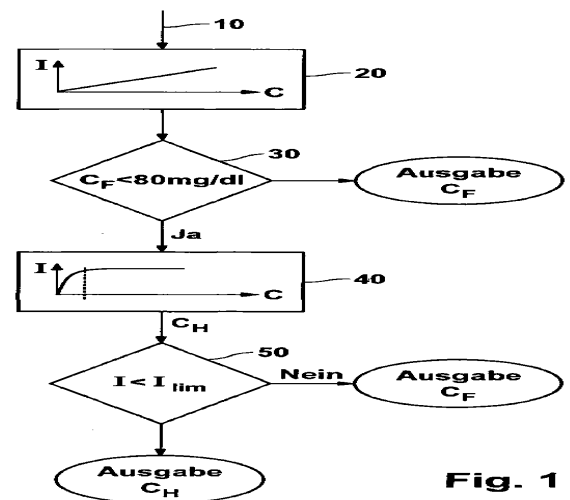


Fig. 1