

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2014-161554
(P2014-161554A)

(43) 公開日 平成26年9月8日(2014.9.8)

(51) Int.Cl.
A61B 8/06 (2006.01)

F I
A61B 8/06

テーマコード(参考)
4C601

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 13 頁)

(21) 出願番号 特願2013-36021 (P2013-36021)
(22) 出願日 平成25年2月26日 (2013.2.26)

(71) 出願人 000003078
株式会社東芝
東京都港区芝浦一丁目1番1号
(71) 出願人 594164542
東芝メディカルシステムズ株式会社
栃木県大田原市下石上1385番地
(74) 代理人 100149803
弁理士 藤原 康高
(74) 代理人 100109900
弁理士 堀口 浩
(74) 代理人 100156579
弁理士 寺西 功一
(72) 発明者 滝本 雅夫
栃木県大田原市下石上1385番地 東芝
メディカルシステムズ株式会社内
最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 超音波診断装置

(57) 【要約】

【課題】 簡便且つ的確にドプラスペクトラムの波形全体の表示が可能な超音波診断装置を提供する。

【解決手段】 上記課題を解決するために、実施形態の超音波診断装置は、データ処理部で生成されたBモードデータ、カラードブラデータ、ドプラスペクトラムデータに基づく画像を表示する表示部と、前記Bモードデータ、前記カラードブラデータ、前記ドプラスペクトラムデータの順、あるいは、前記Bモードデータ、前記ドプラスペクトラムデータの順でデータの生成が遷移した場合、前記Bモードデータの生成が終了した後の所定の時間内に生成された前記カラードブラデータあるいは前記ドプラスペクトラムデータから、前記ドプラスペクトラムデータに基づく画像のScale、Baseline、拡大率・縮小率のうち少なくとも一つを調整するシステム制御部と、を備える。

【選択図】 図2

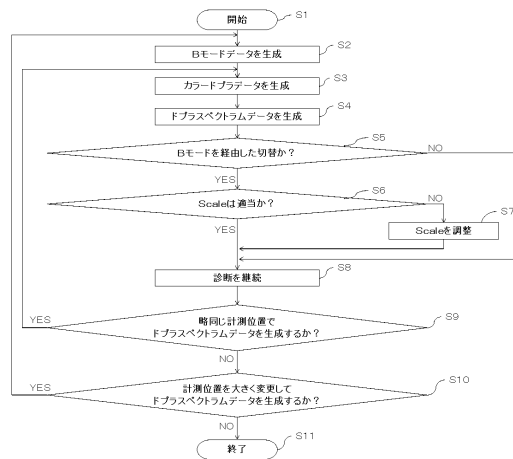

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

Bモードデータ、カラードブラデータ、ドブラスペクトラムデータを生成するデータ処理部と、

前記データ処理部で生成された前記Bモードデータ、前記カラードブラデータ、前記ドブラスペクトラムデータに基づく画像を表示する表示部と、

前記Bモードデータ、前記カラードブラデータ、前記ドブラスペクトラムデータの順、あるいは、前記Bモードデータ、前記ドブラスペクトラムデータの順でデータの生成が遷移した場合、前記Bモードデータの生成が終了した後の所定の時間内に生成された前記カラードブラデータあるいは前記ドブラスペクトラムデータに基づいて、前記表示部に表示される前記ドブラスペクトラムデータに基づく画像の表示態様を変更するシステム制御部と、

を備えた超音波診断装置。

【請求項 2】

患者の心拍を計測するECGユニットを備え、

前記所定の時間は、前記ECGユニットによって計測された前記患者の心拍における少なくとも1心拍分の時間である請求項1に記載の超音波診断装置。

【請求項 3】

前記所定の時間は、前記ドブラスペクトラムデータの生成に遷移したときから開始される時間である請求項1又は2に記載の超音波診断装置。

【請求項 4】

前記システム制御部は、Scale、Baseline、拡大率・縮小率のうち少なくとも一つを調整することで前記表示部に表示される前記ドブラスペクトラムデータに基づく画像の前記表示態様を変更する請求項1乃至3のうちいずれか一つに記載の超音波診断装置。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明の実施形態は、超音波診断装置に関する。

【背景技術】**【0002】**

超音波のドブラ効果を利用して患者の血流情報を得る、所謂、超音波ドブラ法によって患者の血流情報を画像表示する技術がある。この技術において、患者の血流情報は、縦軸が血流速度、横軸が時間といったドブラスペクトラム画像として表示される。しかし、計測する位置や患者によって血流速度は異なるため、波形全体を表示させるためには血流速度の計測レンジ(Scale)や血流速度0の基準線(Baseline)などを調整する必要がある。従来技術では、オペレータが超音波診断装置に設けられた自動調整ボタンを押下することでScaleやBaselineの自動調整が行われ、波形全体が表示される。この技術では、例えば、ボタンを押下した時点までに計測された血流速度の最大値あるいは最小値に基づいて波形の最大振幅を推定し、ScaleやBaselineの調整を行っている。

【先行技術文献】**【特許文献】****【0003】**

【特許文献1】特許第4538091号公報

【発明の概要】**【発明が解決しようとする課題】****【0004】**

しかし、上記の従来技術では、オペレータがわざわざ自動調整ボタンを押下しなければならないため、オペレータにとって手間である。また、オペレータが、早く波形全体を確

10

20

30

40

50

認したいと思うあまり、血流速度の本当の最大値と最小値が計測される前、具体的には1心拍分の時間も待たずに自動調整ボタンを押下してしまった場合、当該自動調整ボタンを押下した時点までの血流速度の最大値あるいは最小値に基づいてScale、Baselineの調整が行われてしまうため、波形全体が表示されないこともある。

【0005】

本発明が解決しようとする課題は、簡便且つ的確にドブラスペクトラムの波形全体の表示が可能な超音波診断装置を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0006】

上記課題を解決するために、実施形態の超音波診断装置は、Bモードデータ、カラードブラデータ、ドブラスペクトラムデータを生成するデータ処理部と、前記データ処理部で生成された前記Bモードデータ、前記カラードブラデータ、前記ドブラスペクトラムデータに基づく画像を表示する表示部と、前記Bモードデータ、前記カラードブラデータ、前記ドブラスペクトラムデータの順、あるいは、前記Bモードデータ、前記ドブラスペクトラムデータの順でデータの生成が遷移した場合、前記Bモードデータの生成が終了した後の所定の時間内に生成された前記カラードブラデータあるいは前記ドブラスペクトラムデータから、前記表示部に表示される前記ドブラスペクトラムデータに基づく画像におけるScale、Baseline、拡大率・縮小率のうち少なくとも一つを調整するシステム制御部と、を備える。

10

【図面の簡単な説明】

20

【0007】

【図1】実施形態におけるブロック図。

【図2】実施形態におけるフロー図。

【図3】エリアシングが起きていない場合のドブラスペクトラム画像の概略図。

【図4】エリアシングが起きている場合のドブラスペクトラム画像の概略図。

【図5】Baselineの調整が成されたドブラスペクトラム画像の概略図。

【発明を実施するための形態】

【0008】

以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。

【0009】

30

まず、本実施形態における超音波診断装置の構成を図1のブロック図を用いて説明する。

【0010】

本実施形態における超音波診断装置は、システム制御部1、送信部2、基準信号発生部3、超音波プローブ4、受信部5、データ処理部10、データ記憶部11、ECG(Electrocardiograph)ユニット13、表示部14、入力部15を備える。データ処理部10は、Bモードデータ生成部6、ドブラ信号検出部7、カラードブラデータ生成部8、ドブラスペクトラムデータ生成部9を備える

システム制御部1は、入力部15を介したオペレータからBモードデータの生成を指示された場合、Bモードデータ生成用の制御データを作成し、作成したBモードデータ生成用の制御データを送信部2へ転送する。この場合、システム制御部1は、受信部5に対してエコー信号をBモードデータ生成部に供給するように指示する。

40

【0011】

システム制御部1は、入力部15を介したオペレータからカラードブラデータの生成を指示された場合、カラードブラデータ生成用の制御データを作成し、作成したカラードブラデータ生成用の制御データを送信部2へ転送する。この場合、システム制御部1は、受信部5に対してエコー信号をドブラ信号検出部7に供給するように指示し、ドブラ信号検出部7に対して検出したドブラ信号をカラードブラデータ生成部8に供給するように指示する。

【0012】

50

システム制御部 1 は、入力部 15 を介したオペレータからドブラスペクトラムデータの生成を指示された場合、ドブラスペクトラムデータ生成用の制御データを作成し、作成したドブラスペクトラムデータ生成用の制御データを送信部 2 へ転送する。この場合、システム制御部 1 は、受信部 5 に対してエコー信号をドブラ信号処理部 7 に供給するように指示し、ドブラ信号検出部 7 に対して検出したドブラ信号をドブラスペクトラムデータ生成部 9 に供給するように指示する。なお、本実施形態では、パルスドブラ法によってサンプリングを行うことでドブラスペクトラムデータを生成する場合について説明するが、連続波ドブラ法によってサンプリングを行う形態でも良い。

【0013】

システム制御部 1 は、データ記憶部 11 に記憶された B モードデータに基づく画像 (B モード画像)、データ記憶部 11 に記憶されたカラードブラデータに基づく画像 (カラードブラ画像、カラーバー)、データ記憶部 11 に記憶されたドブラスペクトラムデータに基づく画像 (ドブラスペクトラム画像) を表示部 14 に表示させる。

10

【0014】

システム制御部 1 は、基準信号発生部 3 が発生させる基準信号の繰り返し周波数 (Pulse Repetition Frequency : PRF) を設定する。

【0015】

システム制御部 1 は、B モードデータ、カラードブラデータ、ドブラスペクトラムデータの順、あるいは、B モードデータ、ドブラスペクトラムデータの順でデータの生成が遷移した場合で、尚且つ、表示部 14 に表示されたドブラスペクトラム画像が「エリアシング」を起こしている場合、エリアシングが生じないような PRF に設定するように基準信号発生部 3 に対して指示する。なお、エリアシングとは、標本化定理に基づくドブラ信号の周波数成分の折り返し現象であり、ドブラ信号が PRF の大きさの $1/2$ より大きい周波数成分を有するときに発生する。エリアシングが生じない PRF の設定については後述する。

20

【0016】

システム制御部 1 は、所定の入力画面を表示部 14 に表示させる。またシステム制御部 1 は、カラードブラデータを生成する範囲やドブラスペクトラムデータを生成する位置を指定するためのカーソルやマーカを表示させる。

【0017】

基準信号発生部 3 は、システム制御部 1 の設定に基づくタイミングで基準信号を発する。以降、ある時点で基準信号が発せられ次の基準信号が発せられるまでの時間を 1 レートとする。

30

【0018】

送信部 2 は図示しないメモリを備え、システム制御部 1 から受信した制御データをメモリに記憶する。送信部 2 は、基準信号発生部 3 が基準信号を発生させることでレートを開始させると、メモリから当該レートに係る制御データを読み出し、読み出した制御データに従って、後述する超音波プローブ 4 が備えている振動子に駆動パルスを供給する。

【0019】

超音波プローブ 4 は、例えば、一次元に配列された複数の振動子を有するリニア型の超音波プローブである。なお、超音波プローブ 4 は、コンベックス型でセクタ型であっても良い。各振動子は、送信部 2 から駆動パルスが供給されると振動し、送信部 2 が読み出した制御データに基づいて送信ビームを発生させる。各振動子は、患者の体内組織にて反射することで生じた反射波を受信し、エコー信号を発生させる。超音波プローブ 4 は、各エコー信号を受信部 5 へ供給する。

40

【0020】

受信部 5 は超音波プローブ 4 から供給されたエコー信号の信号強度を図示しないアンプで増幅させ、制御データに基づく整相加算処理を行なう。受信部 5 はシステム制御部 1 からの指示に従って、整相加算処理が行なわれたエコー信号を B モードデータ生成部 6、ドブラ信号処理部 7 のいずれかに供給する。

50

【 0 0 2 1 】

Bモードデータ生成部6は、受信部5からレート単位で供給されたエコー信号に包絡線検波処理や対数圧縮処理などの処理を施すことにより、エコーの振幅強度に対応した受信信号を生成する。Bモードデータ生成部6は、当該受信信号に基づいてBモードデータを生成する。Bモードデータ生成部6は、生成したBモードデータをデータ記憶部11に送信する。

【 0 0 2 2 】

ドブラ信号検出部7は、受信部5から供給されたエコー信号からドブラ信号を検出する。ドブラ信号検出部7は、システム制御部1が入力部15を介したオペレータからカラードブラデータの生成を指示された場合、検出したドブラ信号をカラードブラデータ生成部8に供給する。一方で、ドブラ信号処理部7は、入力部15を介したオペレータからドブラスペクトラムデータの生成を指示された場合、検出したドブラ信号をドブラスペクトラムデータ生成部8に供給する。

10

【 0 0 2 3 】

カラードブラデータ生成部8は、ドブラ信号検出部7から供給されたドブラ信号に基づいてカラードブラデータを生成する。ここで、カラードブラデータとは、例えば、Bモード画像と同じ断面において入力部15を介したオペレータによって指定された範囲内の血流速度の分布を計測したデータである。カラードブラデータ生成部8は、生成したカラードブラデータをデータ記憶部11に送信する。

【 0 0 2 4 】

ドブラスペクトラムデータ生成部9は、ドブラ信号生成部7から供給されたドブラ信号に基づくドブラスペクトラムデータを生成する。ここでドブラスペクトラムデータとは、例えば、Bモード画像の断面において入力部15を介したオペレータによって指定された位置の血流速度の時間経過を計測したデータである。ドブラスペクトラム生成部9は、生成したドブラスペクトラムデータをデータ記憶部11に送信する。

20

【 0 0 2 5 】

データ記憶部11は、例えば図示しないハードディスクなどの記憶手段を備えており、Bモードデータ生成部6から受信したBモードデータ、カラードブラ生成部8から受信したカラードブラデータ、ドブラスペクトラムデータ生成部9から受信したドブラスペクトラムデータを記憶する。データ記憶部11は、システム制御部1からの指示に従って、Bモードデータ、カラードブラデータ、ドブラスペクトラムデータを表示部14に表示させる。

30

【 0 0 2 6 】

E C Gユニット13は、患者の心拍をカウントし、心拍の様子を逐次システム制御部1に通知する。

【 0 0 2 7 】

表示部14は、システム制御部1からの指示に従って、Bモードデータ、カラードブラデータ、ドブラスペクトラムデータを画像として表示する。表示部14は、システム制御部1からの指示に従って、所定の入力画面を表示する。また、表示部14は、システム制御部1からの指示に従って、カラードブラデータを生成する範囲やドブラスペクトラムデータを生成する位置を指定するためのカーソルやマーカを表示する。

40

【 0 0 2 8 】

入力部15は、例えば、マウスやキーボードなどの入力手段を備えており、オペレータは、表示部14に表示されたカーソルやマーカをマウスやキーボードで操作し、カラードブラデータを生成する範囲やドブラスペクトラムデータを生成する位置を指定する。

【 0 0 2 9 】

次に、本実施形態における超音波診断装置の動作を図2のフロー図を用いて説明する。

【 0 0 3 0 】

ステップS1において、オペレータは診断を開始する。

【 0 0 3 1 】

50

ステップ S 2 において、オペレータは B モードデータの生成を、入力部 1 5 を介してシステム制御部 1 に指示する。システム制御部 1 は、入力部 1 5 を介したオペレータから B モードデータの生成を指示されると、B モードデータ生成用の制御データを生成し、生成した B モードデータ生成用の制御データを送信部 2 へ転送する。送信部 2 は、システム制御部 1 から転送された B モードデータ生成用の制御データをメモリに記憶する。メモリが B モードデータ生成用の制御データを全て記憶すると、基準信号発生部 3 は、システム制御部 1 によって設定された P R F の基準信号を発する。送信部 2 は、基準信号発生部 3 が基準信号を発生させることでレートが開始されると、メモリから当該レートに係る制御データを読み出し、読み出した制御データに従って、超音波プローブ 4 の振動子に駆動パルスを供給する。各振動子は、送信部 2 から駆動パルスが供給されると振動し、当該レートに係る制御データに基づいた送信ビームを発生させる。各振動子は、患者の体内組織にて反射することで生じた反射波を受信し、エコー信号を発生させる。超音波プローブ 4 は、各エコー信号を受信部 5 へ供給する。システム制御部 1 は、受信部 5 に対してエコー信号を B モードデータ生成部に供給するように指示する。受信部 5 は超音波プローブ 4 から供給されたエコー信号の信号強度を図示しないアンプで増幅させ、制御データに基づく整相加算処理を行なう。受信部 5 はシステム制御部 1 からの指示に従って、整相加算処理が行なわれたエコー信号を B モードデータ生成部 6 に供給する。B モードデータ生成部 6 は、受信部 5 から供給されたエコー信号に対して包絡線検波処理や対数圧縮処理などの処理を施すことにより、エコーの振幅強度に対応した受信信号を生成する。以上のプロセスは送信部 2 のメモリが記憶している全ての B モードデータ生成用の制御データについて完了するまで実施され、B モードデータ生成部 6 は、ここで得られた全ての受信信号に基づいて B モードデータを生成する。B モードデータ生成部 6 は、生成した B モードデータをデータ記憶部 1 1 に送信する。データ記憶部 1 1 は、B モードデータ生成部 6 から受信した B モードデータを記憶する。システム制御部 1 は、データ記憶部 1 1 に記憶された B モードデータに基づいて、B モード画像を表示部 1 4 に表示させる。表示部 1 4 は B モード画像を表示する。

【 0 0 3 2 】

ステップ S 3 において、オペレータは入力部 1 5 を介して、表示部 1 4 に表示された B モード画像の中からカラードブラデータを生成する範囲を指定し、システム制御部 1 に対してカラードブラデータの生成を指示する。システム制御部 1 は、入力部 1 5 を介したオペレータからカラードブラデータの生成を指示されると、カラードブラデータ生成用の制御データを生成し、生成したカラードブラデータ生成用の制御データを送信部 2 へ転送する。送信部 2 は、システム制御部 1 から転送されたカラードブラデータ生成用の制御データをメモリに記憶する。メモリがカラードブラデータ生成用の制御データを全て記憶すると、基準信号発生部 3 は、システム制御部 1 によって設定された P R F の基準信号を発する。送信部 2 は、基準信号発生部 3 が基準信号を発生させることでレートが開始されると、メモリから当該レートに係る制御データを読み出し、読み出した制御データに従って、超音波プローブ 4 の振動子に駆動パルスを供給する。各振動子は、送信部 2 から駆動パルスが供給されると振動し、当該レートに係る制御データに基づいた送信ビームを発生させる。各振動子は、患者の体内組織にて反射することで生じた反射波を受信し、エコー信号を発生させる。超音波プローブ 4 は、各エコー信号を受信部 5 へ供給する。受信部 5 は超音波プローブ 4 から供給されたエコー信号の信号強度を図示しないアンプで増幅させ、制御データに基づく整相加算処理を行なう。システム制御部 1 は、受信部 5 に対してエコー信号をドブラ信号検出 7 に供給するように指示する。受信部 5 はシステム制御部 1 からの指示に従って、整相加算処理が行なわれたエコー信号をドブラ信号処理部 7 に供給する。ドブラ信号検出部 7 は、受信部 5 から供給されたエコー信号からドブラ信号を検出する。ドブラ信号検出部 7 は、ここではシステム制御部 1 が入力部 1 5 を介したオペレータからカラードブラデータの生成を指示されているので、検出したドブラ信号をカラードブラデータ生成部 8 に供給する。以上のプロセスは送信部 2 のメモリが記憶している全てのカラードブラデータ生成用の制御データについて完了するまで実施され、カラードブラデータ

10

20

30

40

50

生成部 8 は、ここで得られた全ての受信信号に基づいてカラードブラデータを生成する。カラードブラデータ生成部 8 は、生成したカラードブラデータをデータ記憶部 11 に送信する。データ記憶部 11 は、カラードブラデータ生成部 8 から受信したカラードブラデータを記憶する。システム制御部 1 は、データ記憶部 11 に記憶されたカラードブラデータに基づいて、カラードブラ画像およびカラーバーを表示部 14 に表示させる。表示部 14 はカラードブラ画像およびカラーバーを表示する。

【0033】

ステップ S4 において、オペレータは入力部 15 を介して、表示部 14 に表示された B モード画像の中からドプラスペクトラムデータを生成する位置を指定し、システム制御部 1 に対してドプラスペクトラムデータの生成を指示する。なお、ドプラスペクトラムデータを生成する位置は、例えば表示部 14 に表示されたレンジゲートマーカの位置をオペレータが入力部 15 を介して移動させ、ドプラスペクトラムデータ生成する位置に当該レンジゲートマーカを合わせることで指定される。システム制御部 1 は、入力部 15 を介したオペレータからドプラスペクトラムデータの生成を指示されると、上記指定された位置に係るドプラスペクトラムデータ生成用の制御データを生成し、生成したドプラスペクトラムデータ生成用の制御データを送信部 2 へ転送する。送信部 2 は、システム制御部 1 から転送されたドプラスペクトラムデータ生成用の制御データをメモリに記憶する。メモリがドプラスペクトラムデータ生成用の制御データを全て記憶すると、基準信号発生部 3 は、システム制御部 1 によって設定された PRF の基準信号を発する。送信部 2 は、基準信号発生部 3 が基準信号を発生させることでレートが開始されると、メモリから当該レートに係る制御データを読み出し、読み出した制御データに従って、超音波プローブ 4 の振動子に駆動パルスを供給する。各振動子は、送信部 2 から駆動パルスが供給されると振動し、当該レートに係る制御データに基づいた送信ビームを発生させる。各振動子は、患者の体内組織にて反射することで生じた反射波を受信し、エコー信号を発生させる。超音波プローブ 4 は、各エコー信号を受信部 5 へ供給する。受信部 5 は超音波プローブ 4 から供給されたエコー信号の信号強度を図示しないアンプで増幅させ、制御データに基づく整相加算処理を行なう。システム制御部 1 は、受信部 5 に対してエコー信号をドブラ信号検出 7 に供給するように指示する。受信部 5 はシステム制御部 1 からの指示に従って、整相加算処理が行なわれたエコー信号をドブラ信号処理部 7 に供給する。ドブラ信号検出部 7 は、受信部 5 から供給されたエコー信号からドブラ信号を検出する。ドブラ信号検出部 7 は、ここではシステム制御部 1 が入力部 15 を介したオペレータからドプラスペクトラムデータの生成を指示されているので、検出したドブラ信号をドプラスペクトラムデータ生成部 9 に供給する。以上のプロセスは送信部 2 のメモリが記憶している全てのドプラスペクトラムデータ生成用の制御データについて完了するまで実施され、ドプラスペクトラムデータ生成部 9 は、ここで得られた全ての受信信号に基づいてドプラスペクトラムデータを生成する。ドプラスペクトラムデータ生成部 9 は、生成したドプラスペクトラムデータをデータ記憶部 11 に送信する。データ記憶部 11 は、ドプラスペクトラムデータ生成部 9 から受信したドプラスペクトラムデータを記憶する。システム制御部 1 は、データ記憶部 11 に記憶されたドプラスペクトラムデータに基づいて、ドプラスペクトラム画像を表示部 14 に表示させる。表示部 14 はドプラスペクトラム画像を表示する。

【0034】

ステップ S5 において、システム制御部 1 は、B モードデータを經由した切替であるか否かを確認する。言い換えれば、システム制御部 1 は、B モードデータ、カラードブラデータ、ドプラスペクトラムデータの順、あるいは、B モードデータ、ドプラスペクトラムデータの順でデータの生成が遷移したか否かを判断する。B モードデータ、カラードブラデータ、ドプラスペクトラムデータの順、あるいは、B モードデータ、ドプラスペクトラムデータの順でデータの生成が遷移している場合、ステップ S6 に移行する。一方で、B モードデータ、カラードブラデータ、ドプラスペクトラムデータの順、あるいは、B モードデータ、ドプラスペクトラムデータの順でデータの生成が遷移していない場合、ステップ S8 に移行する。

10

20

30

40

50

【0035】

ステップS6において、システム制御部1は、表示部14に表示されているドブラスペクトラム画像のScaleが適当であるか否かを判断する。本実施形態において、Scaleが適当であるか否かの判断は、例えばECGユニット13によってカウントされた1心拍分の時間内のドブラスペクトラムデータにエリアシングが起きているか否かを基準とする。

【0036】

図3はエリアシングが起きている場合のドブラスペクトラム画像101aとBaseline102aの概略図である。また、図4はエリアシングが起きている場合のドブラスペクトラム画像101bとBaseline102bの概略図である。図3に示すように、ドブラスペクトラムデータにおける血流速度の最大値と最小値は、1心拍分の時間Tを周期として繰り返し観測される。これはエリアシングが起きている場合も同様に言える。したがって、エリアシングが起きているか否かを判断するには、少なくとも1心拍分のドブラスペクトラムデータがあれば良い。図3と図4に示すように、実際にエリアシングが起きているか否かは、例えば、1心拍分のドブラスペクトラムデータの中に、Scaleの最大値付近の値が急にScaleの最小値付近の値に変化している、あるいはScaleの最小値付近の値が急にScaleの最大値付近の値に変化しているデータがあるか否かで判断できる。上記のようにScaleの最大値付近の値が急にScaleの最小値付近の値に変化している、あるいはScaleの最小値付近の値が急にScaleの最大値付近の値に変化しているデータがある場合、ドブラスペクトラムデータはエリアシングを起こしている。

10

20

【0037】

システム制御部1は、上記のような判断によってエリアシングが起きていると判断した場合、即ち、表示部14に表示されているドブラスペクトラム画像のScaleが適当でないと判断した場合、フローとしてはステップS7に移行する。一方で、システム制御部1は、上記のような判断によってエリアシングが起きていると判断した場合、即ち、表示部14に表示されているドブラスペクトラム画像のScaleが適当であると判断した場合、フローとしてはステップS8に移行する。

【0038】

ステップS7において、システム制御部1はScaleを調整する。まず、システム制御部1は、エリアシングを起こしているドブラスペクトラムデータを用いて、仮にPRFが十分に大きくエリアシングが起こしていなかったと仮定したときの血流速度の最大値(推定最大血流速度)と最小値(推定最小血流速度)を推定する。システム制御部1は、推定最大血流速度と推定最小血流速度に基づいて、基準信号発生部3が発生させる基準信号のPRFを設定する。例えば、システム制御部1は、推定最大血流速度と推定最小血流速度のうち絶対値が大きい方の血流速度に対応するドブラ信号の周波数成分がPRFの1/2の大きさより小さくなるようにPRFの大きさを調整する。システム制御部1は、PRFの大きさを調整すると、ステップS4において指定された位置についての新たなドブラスペクトラムデータの生成を開始する。ステップS4のときと同様に、システム制御部1は、新たなドブラスペクトラムデータ生成用の制御データを生成し、生成した新たなドブラスペクトラムデータ生成用の制御データを送信部2へ転送する。送信部2は、システム制御部1から転送された新たなドブラスペクトラムデータ生成用の制御データをメモリに記憶する。メモリが新たなドブラスペクトラムデータ生成用の制御データを全て記憶すると、基準信号発生部3は、ステップS7においてシステム制御部1によって設定されたPRFの基準信号を発する。送信部2は、基準信号発生部3が基準信号を発生させることでレートが開始されると、メモリから当該レートに係る制御データを読み出し、読み出した制御データに従って、超音波プローブ4の振動子に駆動パルスを供給する。各振動子は、送信部2から駆動パルスが供給されると振動し、当該レートに係る制御データに基づいた送信ビームを発生させる。各振動子は、患者の体内組織にて反射することで生じた反射波を受信し、エコー信号を発生させる。超音波プローブ4は、各エコー信号を受信部5へ供給

30

40

50

する。受信部 5 は超音波プローブ 4 から供給されたエコー信号の信号強度を図示しないアンプで増幅させ、制御データに基づく整相加算処理を行なう。システム制御部 1 は、受信部 5 に対してエコー信号をドブラ信号検出 7 に供給するように指示する。受信部 5 はシステム制御部 1 からの指示に従って、整相加算処理が行なわれたエコー信号をドブラ信号処理部 7 に供給する。ドブラ信号検出部 7 は、受信部 5 から供給されたエコー信号からドブラ信号を検出する。ドブラ信号検出部 7 は、ここではシステム制御部 1 が入力部 15 を介したオペレータからドブラスペクトラムデータの生成を指示されているので、検出したドブラ信号をドブラスペクトラムデータ生成部 9 に供給する。以上のプロセスは送信部 2 のメモリが記憶している全ての新たなドブラスペクトラムデータ生成用の制御データについて完了するまで実施され、ドブラスペクトラムデータ生成部 9 は、ここで得られた全ての受信信号に基づいて新たなドブラスペクトラムデータを生成する。ドブラスペクトラムデータ生成部 9 は、生成した新たなドブラスペクトラムデータをデータ記憶部 11 に送信する。データ記憶部 11 は、ドブラスペクトラムデータ生成部 9 から受信した新たなドブラスペクトラムデータを記憶する。システム制御部 1 は、データ記憶部 11 に記憶された新たなドブラスペクトラムデータに基づいて、新たなドブラスペクトラム画像を表示部 14 に表示させる。表示部 14 は新たなドブラスペクトラム画像を表示し、フローとしてはステップ S 8 に移行する。なお、表示部 14 に表示される新たなドブラスペクトラム画像は、図 3 に示すように、波形全体がエリアシングなしに表示された画像である。

10

【 0 0 3 9 】

ステップ S 8 において、オペレータは S c a l e の調整が行われた新たなドブラスペクトラム画像を参照し、診断を継続する。

20

【 0 0 4 0 】

ステップ S 9 において、オペレータは、例えば患者に押し当てている超音波プローブ 4 の位置がずれてしまった場合、略同じ計測位置で再度ドブラスペクトラムデータを生成するか否かを判断する。オペレータが略同じ計測位置で再度ドブラスペクトラムデータを生成すると判断した場合、フローとしてはステップ S 3 に移行する。なお、ここでステップ S 3 に移行した場合、B モードデータ、カラードブラデータ、ドブラスペクトラムデータの順、あるいは、B モードデータ、ドブラスペクトラムデータの順でデータの生成が遷移していないため、システム制御部 1 による S c a l e の調整は行われない。なお、ここで S c a l e の調整が必要ないのは、略同じ計測位置で血流速度を計測しても血流速度の最大値と最小値は大きく変化しないからである。一方、オペレータが略同じ位置で再度ドブラスペクトラムデータを生成しないと判断した場合、フローとしてはステップ S 10 に移行する。

30

【 0 0 4 1 】

ステップ S 10 において、オペレータは、計測位置を大きく変えてドブラスペクトラムデータを生成するか否かを判断する。オペレータが計測位置を大きく変えてドブラスペクトラムデータを生成すると判断した場合、フローとしてはステップ S 2 に移行する。この場合、B モードデータ、カラードブラデータ、ドブラスペクトラムデータの順、あるいは、B モードデータ、ドブラスペクトラムデータの順でデータの生成が遷移したことになるため、ステップ S 6 において S c a l e が不適當だった場合は、システム制御部 1 による S c a l e の調整が行われることになる。なお、ここで S c a l e の調整が必要になるのは、計測位置が大きく変わると血流速度の最大値と最小値が大きく変化してしまうからである。一方、オペレータが計測位置を大きく変えてドブラスペクトラムデータを生成すると判断しない場合、フローとしてはステップ S 11 に移行する。

40

【 0 0 4 2 】

ステップ S 11 において、オペレータは診断を終了する。

【 0 0 4 3 】

以上で説明したように、本実施形態における超音波診断装置は、1 心拍分の時間において計測した血流速度に基づいて、オペレータが何の操作も行うことなく、適切な S c a l e でのエリアシングのないドブラスペクトラムを表示部に表示させる。これによって、従

50

来技術のようにオペレータがボタンを押下しなくとも良くなるため、オペレータの手間が解消される。また、オペレータは、1心拍分の時間待つだけで、適切なScaleでのエリアシングのないドブラスペクトラムを得られるので、従来技術のようにオペレータが、早く波形全体を確認したいと思うあまり焦ってボタンを押下してしまい、結果として適性でない波形が表示されることも無くなる。

【0044】

本実施形態はScaleを1心拍分の時間において計測した血流速度に基づいて自動調整する場合について説明したが、Scaleの自動調製の代わりに、あるいはScaleの自動調整に加えて、Baselineについても同様に自動調整を行っても良い。

【0045】

図5は、Baselineの調整によって表示部14に適正に表示された場合のドブラスペクトラム画像101cとBaseline102cの概略図である。Baselineが適当な場合とは、例えば、図5に示すように、血流速度の最大値から縦軸目盛りの上限値までの差L1と、血流速度の最小値から縦軸目盛りの下限値までの差L2とが等しい場合のことである。このようにBaselineについて自動調整させるために、例えばシステム制御部1が、Bモードデータ、カラードブラデータ、ドブラスペクトラムデータの順、あるいは、Bモードデータ、ドブラスペクトラムデータの順でデータの生成が行われた場合で、尚且つ、ドブラスペクトラムデータがエリアシングを起こしていない場合、ECGユニット13によってカウントされた1心拍分の時間内のドブラスペクトラムデータにおける血流速度の最大値と最小値を求め、その最大値と最小値に基づいてL1とL2が等しくなるようにBaselineを調整した状態でドブラスペクトラム画像を表示部14に表示させる。なお、L1とL2の大きさは、表示部14に表示される縦軸の目盛りの上限値と下限値の差の1/2以下の大きさになる調整することが好ましい。これによって、波形がドブラスペクトラム画像の中央に表示されることになるため、オペレータは波形全体をより観察しやすくなる。上記Baselineの自動調整は、例えば、Baselineが不適当な位置にある状態でも波形全体を表示させるために、あえて波形をドブラスペクトラム画像の上下で折り返して表示させる表示上の操作を行っている場合においても適用できる。

【0046】

また、エリアシングが起こらないようにPRFを予め大きく設定する場合、表示部14におけるドブラスペクトラム画像の表示の拡大率・縮小率を自動調整することによってドブラスペクトラム画像の波形全体を表示させても良い。この場合、システム制御部1が、ECGユニット13によってカウントされた1心拍分の時間内のドブラスペクトラムデータの最大血流速度と最小血流速度を求め、図5に示すように波形の上部と下部に適度な余白が生まれるようにドブラスペクトラム画像を拡大あるいは縮小して表示部14に表示させる。これによって、新たにドブラスペクトラムデータを生成する必要が無くなるので、診断時間の短縮が期待できる。

【0047】

更に、カラードブラデータ、ドブラスペクトラムデータの順で各データを生成する場合、システム制御部1がカラードブラデータにおける血流速度の最大値と最小値を求め、その最大値と最小値に基づいてScaleやBaseline、上記縮小の調整を行って表示部14に表示させても良い。なおここでの血流速度の最大値と最小値は、例えば、ドブラスペクトラムデータを生成する位置、即ち、レンジゲートマーカの位置におけるカラードブラデータの最大値と最小値でも良いし、ドブラスペクトラムデータを生成する位置の周辺の複数位置におけるカラードブラデータの中から求めた最大値と最小値でも良い。これによって、カラードブラデータの生成からドブラスペクトラムデータの生成に移行したときに、始めから適正な表示のドブラスペクトラム画像を得ることができる。

【0048】

また、本実施形態で説明したScaleやBaselineの自動調整機能に加えて、従来技術のようにオペレータが自動調整ボタンを押下することで自動調整が行われても良

10

20

30

40

50

い。これによって、よりオペレータが望むドブラスペクトラム画像を表示させることができる。

【 0 0 4 9 】

以上、本発明の実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

【 符号の説明 】


【 0 0 5 0 】

- 1 . . . システム制御部
- 2 . . . 送信部
- 3 . . . 基準信号発生部
- 4 . . . 超音波プローブ
- 5 . . . 受信部
- 6 . . . Bモードデータ生成部
- 7 . . . ドブラ信号検出部
- 8 . . . カラードブラデータ生成部
- 9 . . . ドブラスペクトラムデータ生成部
- 1 0 . . . データ処理部
- 1 1 . . . データ記憶部
- 1 3 . . . E C G ユニット
- 1 4 . . . 表示部
- 1 5 . . . 入力部
- 1 0 1 a、1 0 1 b、1 0 1 c . . . ドブラスペクトラム画像
- 1 0 2 a、1 0 2 b、1 0 2 c . . . B a s e l i n e


10

20


【図1】

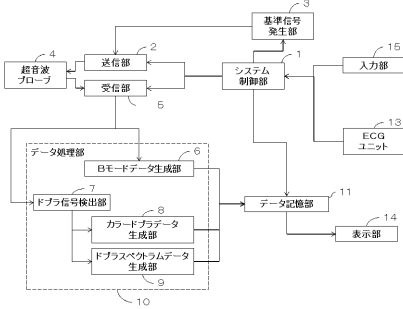


【図2】

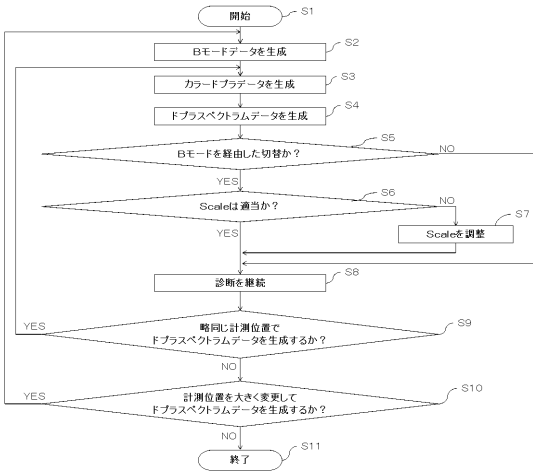


【図3】



【図4】



【図5】



フロントページの続き

Fターム(参考) 4C601 DE01 EE11 FF08 KK10 KK12 KK17 KK18 KK29

专利名称(译)	超声诊断设备		
公开(公告)号	JP2014161554A	公开(公告)日	2014-09-08
申请号	JP2013036021	申请日	2013-02-26
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社东芝 东芝医疗系统株式会社		
申请(专利权)人(译)	东芝公司 东芝医疗系统有限公司		
[标]发明人	滝本雅夫		
发明人	滝本 雅夫		
IPC分类号	A61B8/06		
FI分类号	A61B8/06 A61B8/14		
F-TERM分类号	4C601/DE01 4C601/EE11 4C601/FF08 4C601/KK10 4C601/KK12 4C601/KK17 4C601/KK18 4C601/KK29		
代理人(译)	藤原 康高 堀口博		
其他公开文献	JP6391912B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种超声波诊断装置，其能够简单且准确地显示多普勒频谱的整个波形。为了解决上述问题，根据实施例的超声诊断设备包括显示单元，该显示单元基于由数据处理单元生成的B模式数据，彩色多普勒数据和多普勒频谱数据来显示图像，以及 如果B模式数据，彩色多普勒数据，多普勒频谱数据或B模式数据，多普勒频谱数据的生成按顺序改变，则在B模式数据生成之后的预定值完成。根据在一段时间内生成的彩色多普勒数据或多普勒频谱数据，系统控制单元用于基于多普勒频谱数据调整图像的缩放，基线和放大/缩小比率中的至少一个。。[选择图]图2

