



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 205458858 U

(45) 授权公告日 2016. 08. 17

(21) 申请号 201620072770. 1

(22) 申请日 2016. 01. 25

(73) 专利权人 北京天助畅运医疗技术股份有限公司

地址 100015 北京市朝阳区酒仙桥路 2 号  
(国营第 797 厂内)

(72) 发明人 孙杰 陈凡 乔红玖 孟庆怡  
丁玲翠

(51) Int. Cl.

A61B 17/064(2006. 01)

A61B 17/068(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

### (54) 实用新型名称

含有可吸收钉的软组织固定装置

### (57) 摘要

本实用新型涉及一种含有可吸收钉的软组织固定装置,属于医疗器械的技术领域。本实用新型所述的软组织固定装置包括驱动装置、钉管、驱动杆;钉管外螺接有导管,导管内设置有多只可吸收钉。可吸收钉的钉梁上形成有螺纹结构,并且所述螺纹结构上设置有导程弹簧,多只可吸收钉按照头尾串联的顺序装入具有螺旋槽的导管内;使用时通过扣动扳机,即可在所述驱动装置的驱动下带动驱动杆转动,进而在腹腔镜疝修补手术时,可将所述可吸收钉逐个地发射出所述导管。本实用新型所述的含有可吸收钉的软组织固定装置特别适用于腹腔镜疝修补手术,且具有防粘连、操作方便可靠的特点;而且所述导管为可拆卸的更换件,该固定器使用后仅需更换导管即可重复使用。

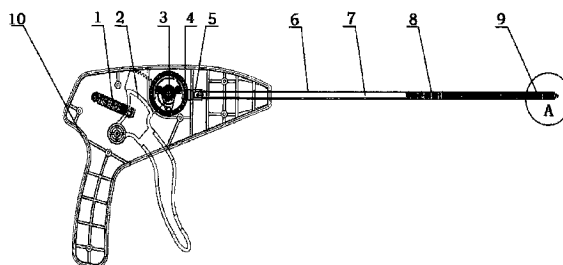

1. 一种含有可吸收钉的软组织固定装置,其特征在于:包括手柄,以及拉力弹簧、扳机、驱动齿轮、大斜齿轮、小斜齿轮、钉管和驱动杆;所述拉力弹簧的第一端卡在所述手柄内壁的固定柱上,所述拉力弹簧的第二端卡在所述扳机的上端上,所述扳机的上端一侧通过一转动轴与所述手柄的内壁可转动地连接,所述扳机的上端另一侧装配有与所述驱动齿轮相配合的斜齿,所述扳机自所述手柄内向外延伸并使得所述扳机的下端位于所述手柄外;所述大斜齿轮与所述驱动齿轮同心设置,并且所述大斜齿轮通过所述驱动齿轮驱动;所述大斜齿轮的外齿与所述小斜齿轮的外齿配合;所述驱动杆由所述小斜齿轮的转动轴驱动,并且所述驱动杆外套设所述钉管,所述钉管的第一端设置在所述手柄内,所述钉管的第二端设置在所述手柄外,所述钉管的第二端可拆卸地连接有导管,所述导管内设置有可吸收钉;所述可吸收钉的钉梁上形成有螺纹结构,并且所述螺纹结构上设置有导程弹簧。

2. 根据权利要求1所述的含有可吸收钉的软组织固定装置,其特征在于:所述导管上沉积有特氟龙润滑涂层,且所述润滑涂层的厚度为3-5 $\mu\text{m}$ 。

3. 根据权利要求1所述的含有可吸收钉的软组织固定装置,其特征在于:所述可吸收钉为具有螺纹的螺钉结构。

## 含有可吸收钉的软组织固定装置

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械的技术领域,更具体地说,本实用新型涉及一种含有可吸收钉的软组织固定装置。

### 背景技术

[0002] 切口疝(incisional hernia)是指腹腔内脏器或组织自腹部切口突出的疝,是剖腹手术的常见并发症;其中,以下腹部中线切口发生率较高,多发生于腹部纵行切口区,见于切口裂开、感染、二期愈合的切口,少数发生于没有切口裂开病史而出现在手术后较长时间后。其发病率约可达2-11%,而伤口发生感染后切口疝发生率可高达40%左右。腹壁切口疝以手术治疗为主,目前切口疝的修补方法为使用或不使用人工补片的开放式修补术和腹腔镜切口疝修补术。单纯组织缝合修补术后切口疝复发率仍可高达20-50%。根据腹壁切口疝国内分类原则,临床以中-大、甚至巨大切口疝较为常见,而此类切口疝多采用人工补片进行无张力疝修补,可有效地将切口疝复发率降低至10%左右。腹腔镜与开放式修补术的比较,具有以下特点:

[0003] (1)腹腔镜切口疝修补术遵循腹壁疝外科原则,符合加强后壁修补的生物工程力学原理,术后复发率可达<5%。(2)手术入路远离原切口疝,减少植入材料部位感染的机会,尤其对于切口曾有感染者。(3)腹壁组织不需广泛游离破坏,尽可能保存腹壁的原强度,更适合复发性切口疝。(4)疝缺损处皮肤与人工补片之间仍保留有未破坏血液供应的软组织,有效覆盖压迫人工补片,利于纤维组织长入聚丙烯粗网孔内,提高人工补片与腹壁组织的愈合强度。(5)气腹状态中游离疝内容物更直观清晰,重力作用使疝内容物自然下垂,可避免损伤肠管的被动局面。(6)腹腔内更易于发现隐匿性的“针孔疝”,降低由此引起的术后复发疝。(7)腹腔内缝合钉多点固定补片,张力均匀分散减低。(8)补片植入区域无皮肤切口,减少了发生血肿积液的可能,不必常规放置引流管,减少污染机会。(9)非腹壁贯穿缝合固定补片者,术后疼痛程度轻、持续时间短,病人恢复迅速。(10)腹腔镜手术在减少切口感染、降低术后复发率的同时达到微创的效果。(11)腹腔镜手术技术要求高,需要相对较长的学习曲线。基于以上特点,腹腔镜切口疝修补术近年来逐渐受到人们的关注,在治疗切口疝时越来越普及。腹腔镜修补术固定补片的方法有完全缝合、完全钉合、缝合与钉合及粘合剂固定等,目前尚无统一标准规范。

[0004] 在现有技术中,TYCO医疗健康集团在专利申请200810009395.6中公开了一种镜用切割缝合器及一次性钉匣。John Isbell Shipp在US 2007/0038220 A1中公开了一种用于固定疝修补片的可吸收螺旋钉,所述可吸收螺旋钉由丙交酯和乙交酯的共聚物制成。Davol, Inc., Cranston, RI在US 2007/0250064 A1中公开了一种外科手术固定的方法和设备。SOFRADIM PRODUCTION, Trevoux(FR)在US 2003/0187465 A1中公开了一种I形手术固定器。Origin Medsystems, Inc. Menlo park, Calif在US5366479A中公开了一种外科螺旋固定器。上述固定器的应用解决了缝线修补的耗时、不方便等问题。同时也可以减少病人的失血和创伤。传统的外科固定器为订书钉型,订书钉型固定的变形需要铁毡或其他结构,结构较

为复杂,且价格较高。单面螺旋钉远端有一个刺入点,近端有一个T形条,T形条平分了螺旋钉的直径,提供了一个受力面。螺旋钉的另一种形式为双面螺旋,远端有两个刺入点,近端有一个连接条,连接条连接了两个螺旋圈,同时平分了两个螺旋圈的直径。在现有技术中,固定器结构通常是一次性使用,另外操作时可能会对人体组织产生摩擦损伤。

### 实用新型内容

[0005] 为了解决现有技术中存在的上述技术问题,本实用新型的目的在于提供一种含有可吸收钉的软组织固定装置。

[0006] 为了实现上述实用新型目的,本实用新型采用了以下技术方案:

[0007] 一种含有可吸收钉的软组织固定装置,包括手柄,以及拉力弹簧、扳机、驱动齿轮、大斜齿轮、小斜齿轮、钉管和驱动杆;所述拉力弹簧的第一端卡在所述手柄内壁的固定柱上,所述拉力弹簧的第二端卡在所述扳机的上端上,所述扳机的上端一侧通过一转动轴与所述手柄的内壁可转动地连接,所述扳机的上端另一侧装配有与所述驱动齿轮相配合的斜齿,所述扳机自所述手柄内向外延伸并使得所述扳机的下端位于所述手柄外;所述大斜齿轮与所述驱动齿轮同心设置,并且所述大斜齿轮通过所述驱动齿轮驱动;所述大斜齿轮的外齿与所述小斜齿轮的外齿配合;所述驱动杆由所述小斜齿轮的转动轴驱动,并且所述驱动杆外套设所述钉管,所述钉管的第一端设置在所述手柄内,所述钉管的第二端设置在所述手柄外,所述钉管的第二端可拆卸地连接有导管,所述导管内设置有可吸收钉;所述可吸收钉的钉梁上形成有螺纹结构,并且所述螺纹结构上设置有导程弹簧。

[0008] 在本实用新型中,所述导管上设置有润滑涂层。所述导管上沉积有特氟龙润滑涂层,且所述润滑涂层的厚度为3-5 $\mu$ m。所述润滑相容涂层表面硬度为Hv500~Hv1000,表面摩擦系数为0.1~0.05。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型所述的含有可吸收钉的软组织固定装置具有以下有益效果:

[0010] 本实用新型所述的含有可吸收钉的软组织固定装置特别适用于腹腔镜疝修补手术,且具有防粘连、操作方便可靠的特点;在本实用新型中所述导管为可拆卸的更换件,使用后仅需更换导管即可重复使用。

### 附图说明

[0011] 图1为本实用新型一个实施例的含有可吸收钉的软组织固定装置的结构示意图。

[0012] 图2为图1中圆圈A处的放大结构示意图。

### 具体实施方式

[0013] 以下将结合具体实施例对本实用新型所述的含有可吸收钉的软组织固定装置做进一步的阐述,以帮助本领域的技术人员对本实用新型的实用新型构思、技术方案有更完整、准确和深入的理解。

[0014] 如图1-2所示,本实施例所述的含有可吸收钉的软组织固定装置,包括手柄10,以及拉力弹簧1、扳机2、驱动齿轮3、大斜齿轮4、小斜齿轮5、钉管6和驱动杆7。所述拉力弹簧1的第一端卡在所述手柄10内壁的固定柱上,所述拉力弹簧1的第二端卡在所述扳机2的上端

上,所述扳机2的上端一侧通过一转动轴与所述手柄10的内壁可转动地连接,所述扳机2的上端另一侧装配有与所述驱动齿轮3相配合的斜齿,所述扳机2自所述手柄10内向外延伸并使得所述扳机2的下端位于所述手柄10外;所述大斜齿轮4与所述驱动齿轮3同心设置,并且所述大斜齿轮4通过所述驱动齿轮3驱动;所述大斜齿轮4的外齿与所述小斜齿轮5的外齿配合;所述驱动杆7由所述小斜齿轮5的转动轴驱动,并且所述驱动杆7外套设所述钉管6,所述钉管6的第一端设置在所述手柄10内,所述钉管6的第二端设置在所述手柄10外,所述钉管6的第二端螺纹连接有导管8,所述导管8内设置有可吸收钉9。所述可吸收钉的钉梁上形成有螺纹结构,并且所述螺纹结构上设置有导程弹簧,具体来说多只可吸收钉按照头尾串联的顺序装入具有螺旋槽的导管内,可吸收钉的头部朝向导管的出口。在本实施例中,所述扳机、拉力弹簧、驱动齿轮、大斜齿轮和小斜齿轮构成本实用新型所述含有可吸收钉的软组织固定装置的驱动装置。使用时通过扣动扳机,即可在所述驱动装置的驱动下带动驱动杆转动,进而在腹腔镜疝修补手术时,可将所述可吸收钉逐个地发射出所述导管。

[0015] 在本实用新型中,所述导管上设置有润滑涂层。在导管上设置所述润滑涂层有利于将所述含有可吸收钉的软组织固定装置的导管平滑地送入人体组织中,而防止发生粘连。所述导管上沉积有特氟龙润滑涂层,且所述润滑涂层的厚度为3~5 $\mu\text{m}$ 。所述润滑相容涂层表面硬度为Hv500~Hv1000,表面摩擦系数为0.1~0.05。

[0016] 在本实用新型中所述可吸收钉的形状采用本领域常用的螺钉结构即可,如整体形状的前半部分为圆锥形、后半部分为柱形或整体为圆台形,便于手术时导针对其准确定位。对螺纹参数没有特殊限制,优选为深且钝的螺纹。

[0017] 对于本领域的普通技术人员而言,具体实施例只是对本实用新型进行了示例性描述,显然本实用新型具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本实用新型的方法构思和技术方案进行的各种非实质性的改进,或未经改进将本实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本实用新型的保护范围之内。

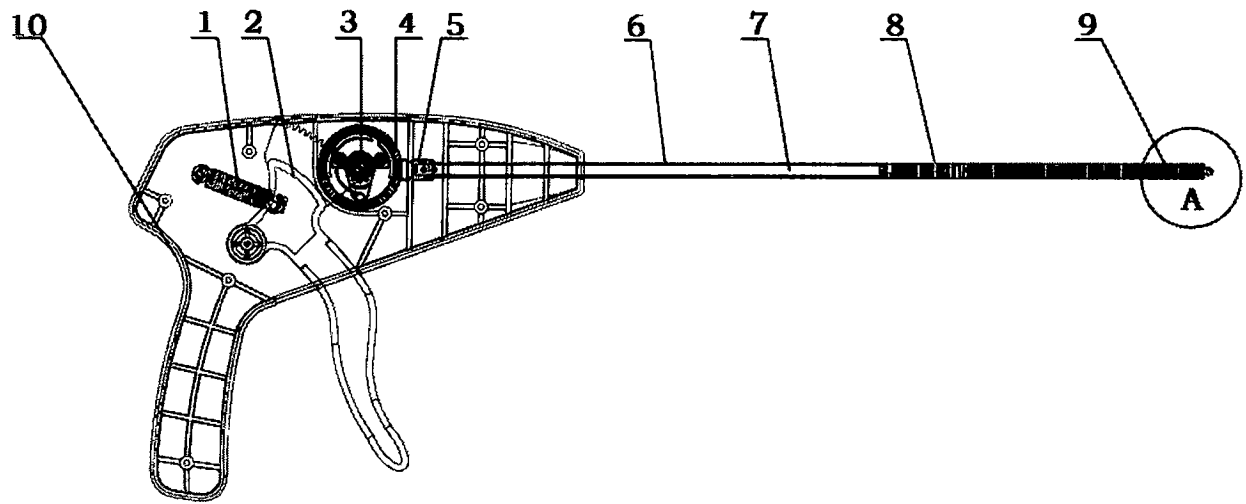


图1

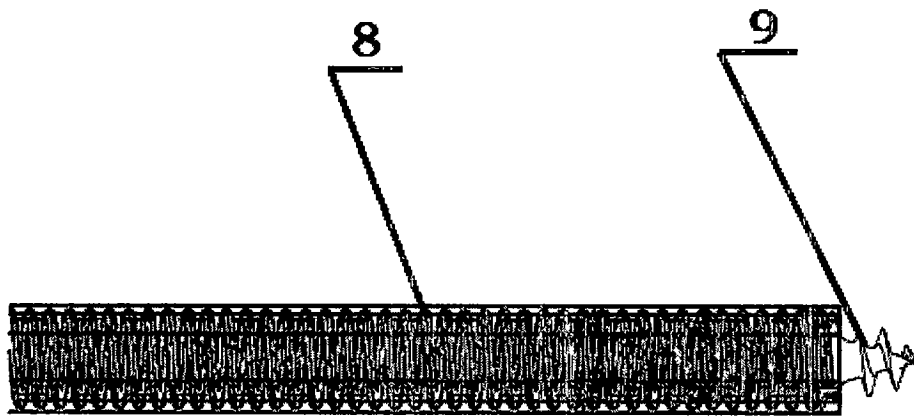


图2

|                |                                                |         |            |
|----------------|------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 含有可吸收钉的软组织固定装置                                 |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">CN205458858U</a>                   | 公开(公告)日 | 2016-08-17 |
| 申请号            | CN201620072770.1                               | 申请日     | 2016-01-25 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司                               |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司                               |         |            |
| 当前申请(专利权)人(译)  | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司                               |         |            |
| [标]发明人         | 孙杰<br>陈凡<br>乔红玫<br>孟庆怡<br>丁玲翠                  |         |            |
| 发明人            | 孙杰<br>陈凡<br>乔红玫<br>孟庆怡<br>丁玲翠                  |         |            |
| IPC分类号         | A61B17/064 A61B17/068                          |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a> <a href="#">SIPO</a> |         |            |

#### 摘要(译)

本实用新型涉及一种含有可吸收钉的软组织固定装置，属于医疗器械的技术领域。本实用新型所述的软组织固定装置包括驱动装置、钉管、驱动杆；钉管外螺接有导管，导管内设置有多只可吸收钉。可吸收钉的钉梁上形成有螺纹结构，并且所述螺纹结构上设置有导程弹簧，多只可吸收钉按照头尾串联的顺序装入具有螺旋槽的导管内；使用时通过扣动扳机，即可在所述驱动装置的驱动下带动驱动杆转动，进而在腹腔镜疝修补手术时，可将所述可吸收钉逐个地发射出所述导管。本实用新型所述的含有可吸收钉的软组织固定装置特别适用于腹腔镜疝修补手术，且具有防粘连、操作方便可靠的特点；而且所述导管为可拆卸的更换件，该固定器使用后仅需更换导管即可重复使用。

