

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-192201  
(P2006-192201A)

(43) 公開日 平成18年7月27日(2006.7.27)

(51) Int.CI.	F 1	テーマコード (参考)
<b>A 6 1 B 1/00</b>	A 6 1 B 1/00	2 H 0 4 0
<b>G 0 2 B 23/24</b>	G 0 2 B 23/24	4 C 0 6 1

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 22 頁)

(21) 出願番号	特願2005-9474 (P2005-9474)	(71) 出願人	000000376 オリンパス株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
(22) 出願日	平成17年1月17日 (2005.1.17)	(74) 代理人	100076233 弁理士 伊藤 進
		(72) 発明者	小板橋 正信 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ リンパス株式会社内
		(72) 発明者	古川 達也 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ リンパス株式会社内
		F ターム (参考)	2H040 BA21 DA14 DA21 DA41 4C061 FF12 HH33 HH47


(54) 【発明の名称】電動湾曲内視鏡装置

## (57) 【要約】

【課題】所望の動作抵抗を簡単な機構によって得ることのできる構成の動作抵抗手段を備えた湾曲操作入力部材を配設し操作性の向上に寄与し得る電動湾曲内視鏡装置を提供する。

【解決手段】挿入部先端側に設けた湾曲部12を湾曲動作させる湾曲駆動手段30と、湾曲部に対する湾曲動作を指示入力するための湾曲操作入力手段20と、湾曲操作入力手段に動作抵抗を生じさせる動作抵抗手段とを有する電動湾曲内視鏡装置1において、動作抵抗手段は湾曲操作入力手段の操作子41の移動と連動し移動自在に配設される板状部材42と、板状部材の少なくとも一部を取り囲むようにかつ板状部材が内部で移動自在に収納される収納体と、収納体によって封入される粘性流体44aとによって構成する。

【選択図】図3

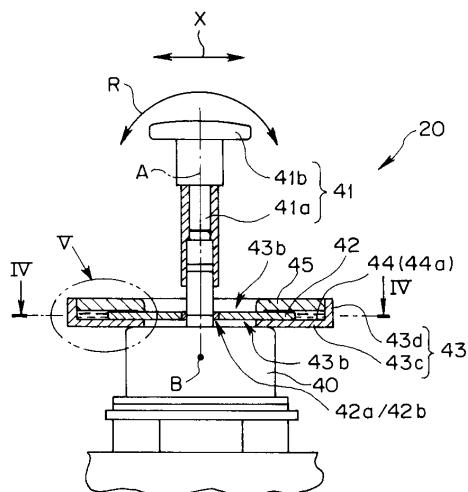

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

挿入部先端側に設けた湾曲部を湾曲動作させる湾曲駆動手段と、前記湾曲部に対する湾曲動作を指示入力するための湾曲操作入力手段と、前記湾曲操作入力手段に動作抵抗を生じさせる動作抵抗手段とを有する電動湾曲内視鏡装置において、

前記動作抵抗手段は、前記湾曲操作入力手段の操作子の移動と連動し移動自在に配設される板状部材と、前記板状部材の少なくとも一部を取り囲むように、かつ前記板状部材が内部で移動自在に収納される収納体と、前記収納体によって封入される粘性流体とによって構成されていることを特徴とする電動湾曲内視鏡装置。

**【請求項 2】**

前記動作抵抗手段は、前記湾曲操作入力手段の操作子の移動と連動して移動自在に配設される円板状部材と、前記円板状部材を収納し、かつ前記円板状部材及び円板状部材の移動範囲より大きな内部空間を有する中空の略円柱状部材と、前記略円柱状部材の内部に粘性流体が封入されていることを特徴とする請求項 1 に記載の電動湾曲内視鏡装置。

**【請求項 3】**

前記動作抵抗手段は、前記湾曲操作入力手段の操作子の移動と連動して移動自在に配設される円板状部材と、前記円板状部材を収納し、かつ前記円板状部材及び円板状部材の移動範囲より大きな内部空間を有する中空の略四角柱状部材と、前記略四角柱状部材の内部に粘性流体が封入されていることを特徴とする請求項 1 に記載の電動湾曲内視鏡装置。

**【請求項 4】**

前記動作抵抗手段は、前記板状部材の底面もしくは上面に形成される V 字状溝と、前記板状部材の底面もしくは上面に相対する収納体の内面上に設けられ、かつ前記 V 字状溝に対して挿脱される突起部を少なくとも一つ形成していることを特徴とする請求項 1 または請求項 2 または請求項 3 に記載の電動湾曲内視鏡装置。

**【請求項 5】**

請求項 1 ~ 請求項 4 のいずれか一つに記載の電動湾曲内視鏡装置において、前記湾曲操作入力手段は、ジョイスティック方式のものであることを特徴とする電動湾曲内視鏡装置。

**【請求項 6】**

挿入部先端側に設けた湾曲部を湾曲動作させる湾曲駆動手段と、前記湾曲部に対する湾曲動作を指示入力するための湾曲操作入力手段とを有する電動湾曲内視鏡装置において、前記湾曲操作入力手段の操作子の移動を規制する規制部材を設けたことを特徴とする電動湾曲内視鏡装置。

**【請求項 7】**

前記湾曲操作入力手段は、ジョイスティック方式のものであることを特徴とする請求項 6 に記載の電動湾曲内視鏡装置。

**【発明の詳細な説明】****【技術分野】****【0001】**

この発明は、電動湾曲内視鏡装置、詳しくは挿入部先端側に設けた湾曲部を電動により湾曲動作させるように構成される電動湾曲内視鏡装置に関するものである。

**【背景技術】****【0002】**

従来より、内視鏡は医療分野や工業分野等において広く利用されている。医療分野における内視鏡は、細長の挿入部を体腔内に挿入することによって、体腔内臓器などを観察したり、必要に応じて処置具チャンネル内に挿通した処置具を用いて各種治療処置をおこなうことができるよう構成されている。

**【0003】**

また、工業分野における内視鏡は、細長の挿入部を各種装置の内部に挿入することによって、ボイラーやタービンやエンジンや化学プラントなどにおける内部の傷や腐蝕などを観

10

20

30

40

50

察したり検査することができるようになっている。

【0004】

このような従来の内視鏡においては、細長形状からなる挿入部の先端部の基端側に湾曲自在に形成される湾曲部を連設して構成されているのが普通である。そして、従来の内視鏡では、操作部に設けられた湾曲操作レバーやボタン等の湾曲操作入力部材を操作することによって、湾曲部の湾曲方行や湾曲速度を湾曲量として指示入力し、こうして指示入力される湾曲量の情報に基づいて湾曲操作ワイヤ等を機械的に牽引または弛緩させることで湾曲部の湾曲動作をおこない得るように構成されている。

【0005】

このような形態の従来の内視鏡において、湾曲駆動手段としての電動モータを操作部等に配設し、上記湾曲操作入力部材による湾曲量情報の指示入力に基づいて上記モータの回動制御をおこなって、同モータの駆動力を用いて湾曲操作ワイヤを牽引または弛緩させ、これにより湾曲部の湾曲動作を電動により実施し得るように構成した電動湾曲内視鏡装置についての提案が従来より種々なされている。

【0006】

そして、このような従来の電動湾曲内視鏡装置における湾曲操作入力手段としては、例えば複数の押しボタン方式のものやジョイスティック方式のもの等、種々の操作部材の方式を適用することができる。このうちジョイスティック方式の湾曲操作入力手段を適用したものでは、軸状の操作子を傾倒させることによって湾曲部の湾曲量情報の入力指示をおこなうように構成されているのが普通である。この場合において、操作子を傾倒させ得る傾倒可能範囲と湾曲量とが対応するように構成されることになるが、操作子の傾倒可能範囲はある所定の範囲に規制されることになる。したがって、この場合には操作子のわずかな傾倒操作によって湾曲量が大きく変位してしまうことにもなる。

【0007】

そこで、例えば特開2003-230535号公報によって開示されている電動湾曲内視鏡装置においては、湾曲操作入力手段としてジョイスティック方式のものを採用して構成すると共に、操作子には、その動作時の動作抵抗を生じさせる動作抵抗手段としてゲル等の粘性流体を封入した袋状部材を備えて構成した例が示されている。

【0008】

これによれば、ジョイスティック方式の湾曲操作入力手段としての操作子に対して動作抵抗手段を設けることによって、当該操作子の傾倒動作の動きを規制し、よって操作者の意図に反した湾曲部の湾曲動作を抑えることができるというものである。

【特許文献1】特開2003-230535号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

ところが、上述の特開2003-230535号公報によって開示される手段において適用される動作抵抗手段は粘性流体を封入した袋状部材が用いられる。この場合、例えば湾曲操作入力手段の操作子を強い力量で急激に操作したり、同操作を繰り返しあこなう場合などを考慮すると、湾曲操作入力手段の内部に袋状部材（動作抵抗手段）を確実に固設する必要がある。しかしながら、上述のような形態の動作抵抗手段を確実に固設することは困難である。また、同公報においては、動作抵抗手段の固設方法の詳細については特に触れられていない。

【0010】

そして、上述の公報に開示される手段では、湾曲操作入力手段の操作子が袋状部材を押し潰す形態となっていることから、同袋状部材が押し潰される際には弾性抵抗が発生することになる。したがって、同操作子を操作する際には、袋状部材内部の粘性流体に反する粘性抵抗のみを動作抵抗として負荷させることが難しいという問題点がある。

【0011】

本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、所望

10

20

30

40

50

の動作抵抗を簡単な機構によって得ることのできる構成の動作抵抗手段を備えた湾曲操作入力部材を配設することで、操作性の向上に寄与することのできる電動湾曲内視鏡装置を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0012】

上記目的を達成するために、本発明による電動湾曲内視鏡装置は、挿入部先端側に設けた湾曲部を湾曲動作させる湾曲駆動手段と、前記湾曲部に対する湾曲動作を指示入力するための湾曲操作入力手段と、前記湾曲操作入力手段に動作抵抗を生じさせる動作抵抗手段とを有する電動湾曲内視鏡装置において、前記動作抵抗手段は、前記湾曲操作入力手段の操作子の移動と連動し移動自在に配設される板状部材と、前記板状部材の少なくとも一部を取り囲むように、かつ前記板状部材が内部で移動自在に収納される収納体と、前記収納体によって封入される粘性流体とによって構成されていることを特徴とする。

10

【発明の効果】

【0013】

本発明によれば、所望の動作抵抗を簡単な機構によって得ることのできる構成の動作抵抗手段を備えた湾曲操作入力部材を配設することで、操作性の向上に寄与し得る電動湾曲内視鏡装置を提供することができる。

20

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。

図1及び図2は、本発明の第1の実施形態を示し、図1は本実施形態の電動湾曲内視鏡装置装置の概略的な構成を示す概略構成図である。また、図2は、図1の電動湾曲内視鏡装置装置の内部構成の概略的な構成を示す概略構成図である。

30

【0015】

図1に示すように本発明の第1の実施の形態の電動湾曲内視鏡装置1は、挿入部6の先端側に設けられる湾曲部12を電動で湾曲動作させる湾曲駆動手段である湾曲駆動部30(図2参照)を備える電動湾曲内視鏡2と、電動湾曲内視鏡2に照明光を供給する光源装置3と、電動湾曲内視鏡2の先端部に内蔵される撮像装置24(図2参照)から出力される撮像信号等についての信号処理をおこなうビデオプロセッサ4と、電動湾曲内視鏡2の湾曲駆動部30(図2)を駆動制御する湾曲制御装置5とによって主に構成されている。

30

【0016】

ビデオプロセッサ4は、図示しないモニタ装置に接続されており、このモニタ装置に映像信号を出力して内視鏡画像を表示させるようになっている。

【0017】

電動湾曲内視鏡2は、細長形状からなる挿入部6と、この挿入部6の基端側に連設され把持部7aを兼ねる操作部7と、この操作部7の側部から延出されるユニバーサルコード8などによって主に構成されている。

40

【0018】

挿入部6は、先端に設けられる硬質の先端硬質部11と、この先端硬質部11の基端側に設けられ湾曲自在に形成される湾曲部12と、この湾曲部12の基端側に設けられ長尺で可撓性を有する可撓管部13とが連設した形態で構成されている。

40

【0019】

操作部7は、使用者が握って把持する部位である把持部7aを有して形成されている。この把持部7aの上部側には、ビデオプロセッサ4を遠隔操作するための複数のビデオスイッチ14aが配設されている。また、把持部7aの側面には、送気操作及び送水操作をおこなうための送気送水ボタン16と、吸引操作をおこなうための吸引ボタン15とが配設されている。そして、把持部7aには、湾曲部12を湾曲動作させるための操作入力をおこなう湾曲操作入力手段である湾曲操作入力部材20が設けられている。この湾曲操作入力部材20としては、例えばジョイスティック方式のもの等が適用される。さらに、把持部7aには、生検鉗子等の処置具を挿入する処置具挿入口17が設けられている。この

50

処置具挿入口 17 は、把持部 7a の内部において処置具挿通用チャンネル（図示せず）に連通している。これにより、処置具挿入口 17 から鉗子等の処置具（図示せず）を挿入すると、内部の処置具挿通チャンネルを介して先端硬質部 11 に形成されているチャンネル開口から同処置具の先端側を突出させることができ、同処置具を用いて生検などをおこなうことができるようになっている。

#### 【0020】

ユニバーサルコード 8 は、ライトガイド 21 や信号ケーブル 24a（いずれも図 2 参照）を内挿している。このユニバーサルコード 8 の一端部にはコネクタ部 9 が配設されている。このコネクタ部 9 は、その先端に光源装置 3 に対して着脱自在に接続し得るライトガイドコネクタ（以下 LG コネクタ）9a を備えている。この LG コネクタ 9a の側部には、ビデオプロセッサ 4 の接続ケーブル 4a が着脱自在に接続されるビデオコネクタ 9b と、湾曲制御装置 5 の接続ケーブル 5a が着脱自在に接続されるアングルコネクタ 9c が設けられている。10

#### 【0021】

電動湾曲内視鏡 2 の挿入部 6 には、図 2 に示すように照明光を伝達するライトガイド 21 が挿通する形態で配設されている。このライトガイド 21 の基端側は、操作部 7 を経てユニバーサルコード 8 に内挿されコネクタ部 9 にまで至っている。また、ライトガイド 21 の先端側の所定の部位であって、挿入部 6 の先端硬質部 11 の内部には、照明光学系 22 が固設されている。そして、コネクタ部 9 と光源装置 3 とが接続された状態となつたときには、光源装置 3 の内部に設けられる光源ランプ（図示せず）からの照明光が挿入部 6 の先端部まで伝達されるようになっている。こうしてライトガイド 21 により挿入部 6 の先端部にまで伝達された照明光は、照明光学系 22 を介して挿入部 6 の先端硬質部 11 に固定される照明窓（図示せず）の先端面から出射して、患部などの被写体を照明するようになっている。20

#### 【0022】

一方、電動湾曲内視鏡 2 の挿入部 6 には、図 2 に示すように撮像装置 24 から延出される信号ケーブル 24a が挿通する形態で配設されている。この信号ケーブル 24a の先端側の所定の部位であって、挿入部 6 の先端硬質部 11 の内部には、CCD 等の撮像素子等からなる撮像装置 24 が固設されている。この撮像装置 24 の前面には撮像光学系 23 が配置されている。また、信号ケーブル 24a は、操作部 7 を経てユニバーサルコード 8 に内挿されており、その基端側がコネクタ部 9 のビデオコネクタ 9b に接続されている。そして、コネクタ部 9 のビデオコネクタ 9b とビデオプロセッサ 4 とが接続ケーブル 4a を介して接続された状態においては、撮像装置 24 からの出力信号は、最終的にビデオプロセッサ 4 へと出力されるようになっている。30

#### 【0023】

これにより、上述のライトガイド 21 の照明窓から出射する照明光によって照明される被写体の反射光束（光学的な被写体像を形成する光束）は、照明窓に隣接して設けられる観察窓（図示せず）を介して取り込まれるようになっている。そして、観察窓から取り込まれ被写体像を形成する光束は、対物光学系 23 を介して撮像装置 24 の受光面上に到達する。その結果、当該撮像装置 24 の受光面上には光学的に形成された被写体像が形成される。40

#### 【0024】

これを受けて、撮像装置 24 は所定の撮像処理、すなわち光電変換処理をおこなって所定の形態の撮像信号を出力するようになっている。こうして撮像装置 24 から出力される撮像信号は、信号ケーブル 24a を介して操作部 7 を経てユニバーサルコード 8 のビデオコネクタ 9b にまで至り、さらに接続ケーブル 4a を介してビデオプロセッサ 4 へと出力されるようになっている。

#### 【0025】

ビデオプロセッサ 4 は、電動湾曲内視鏡 2 の撮像装置 24 から出力される撮像信号を受けて、これに対して所定の信号処理を施し、標準的な映像信号を生成した後、モニタ装置50

(図示せず)へと出力するものである。モニタ装置は、これを受け内視鏡画像を表示させるようになっている。

【0026】

挿入部6の先端硬質部11の基端側には、互いに回動自在に連結される複数の湾曲駒25a, 25, ..., 25bによって構成される湾曲部12の最先端の湾曲駒25aが接続されている。また、湾曲部12の最終駒25bは、可撓管部13の先端側に接続されている。

【0027】

また、挿入部6には、湾曲部12を観察視野の上下左右方向に湾曲するための湾曲操作ワイヤ26が挿通されている。この湾曲操作ワイヤ26の先端側は、湾曲部12の上下左右方向に対応する位置であって、最先端の湾曲駒25aに対してそれぞれロウ付け等によって固定保持されている。これにより、各方向に対応する湾曲操作ワイヤ26は、それぞれが牽引弛緩されることで、湾曲部12が所望の方向に湾曲し、これに伴って先端硬質部11が所望の方向を向くようになっている。

【0028】

湾曲操作ワイヤ26は、電動式の湾曲駆動部30によって牽引弛緩されるようになっている。すなわち、本実施形態の電動湾曲内視鏡装置1における湾曲部12は、電動にて湾曲するようになっている。なお、図2においては、湾曲操作ワイヤ26のうち上下方向又は左右方向のいずれかに湾曲させるための二本のワイヤのみが図示されている。

【0029】

湾曲駆動部30は、湾曲操作ワイヤ26の基端部を巻き付けて固定保持され同湾曲操作ワイヤ26を牽引弛緩するためのスプロケット31と、このスプロケット31を回動させるモータ32とを有して構成されている。

【0030】

また、スプロケット31とモータ32との間には、モータ32の駆動力を切断するためのクラッチ33が設けられている。これにより、湾曲駆動部30は、クラッチ33を作動させることによりモータ32の駆動力の伝達を切断し、湾曲部12をいわゆるアングルフリーの状態にすることが可能となっている。

【0031】

クラッチ33は、湾曲制御装置5に設けられる制御部35(図2参照)の制御によって動作するようになっている。また、これとは別に、クラッチ33は、手動によって動作させるような機構によって構成しても良い。

【0032】

モータ32から延出される信号線32aは、ユニバーサルコード8を挿通しアングルコネクタ9cを介して接続ケーブル5aを挿通し、湾曲制御装置5に設けられるモータアンプ34に接続されている。これにより、湾曲制御装置5のモータアンプ34からのモータ駆動信号がモータ32へと伝達されるようになっている。また、モータアンプ34は、制御部35に接続されており、この制御部35によって駆動制御されるようになっている。

【0033】

また、モータ32には、回転位置を検出する回転位置検出手段としてのエンコーダ36が設けられている。このエンコーダ36から延出される信号線36aは、ユニバーサルコード8を挿通しアングルコネクタ9cを介して接続ケーブル5aを挿通し、湾曲制御装置5の制御部35と電気的に接続されている。これにより、エンコーダ36によって検出されたモータ32の回転位置を示す回転位置信号が制御部35へと出力されるようになっている。

【0034】

一方、上述のスプロケット31は、モータ32の回転運動を湾曲操作ワイヤ26の進退運動に変換する役目をしている。このスプロケット31には、回転位置を検出するための回転位置検出手段であるポテンショメータ37が接続されている。このポテンショメータ37から延出される信号線37aは、ユニバーサルコード8を挿通しアングルコネクタ9cを介して接続ケーブル5aを挿通し、湾曲制御装置5の制御部35と電気的に接続されている。

10

20

30

40

50

cを介して接続ケーブル5aを挿通し、湾曲制御装置5の制御部35と電気的に接続されている。これにより、ポテンショメータ37によって検出されたスプロケット31の回転位置を示す回転位置信号が制御部35へと出力されるようになっている。

#### 【0035】

また、湾曲駆動部30のクラッチ33の近傍には、クラッチ33の動作状態、すなわちオンオフ状態を検出するクラッチ動作検出スイッチ38が配設されている。このクラッチ動作検出スイッチ38から延出される信号線38aは、ユニバーサルコード8を挿通しアングルコネクタ9cを介して接続ケーブル5aを挿通し、湾曲制御装置5の制御部35と電気的に接続されている。これにより、クラッチ動作検出スイッチ38によって検出されたクラッチ33の動作を示すクラッチ動作信号が制御部35へと出力されるようになっている。10

#### 【0036】

また同様に湾曲操作入力部材20から延出される信号線20aは、ユニバーサルコード8を挿通しアングルコネクタ9cを介して接続ケーブル5aを挿通し、湾曲制御装置5の制御部35と電気的に接続されている。これにより、湾曲操作入力部材20によって操作入力される湾曲操作を示す湾曲操作信号が制御部35へと出力されるようになっている。

#### 【0037】

そして、制御部35は、湾曲操作入力部材20からの湾曲操作信号と、エンコーダ36及びポテンショメータ37からの信号とに基づいてモータアンプ34を制御し、これによりモータ32を駆動させることで湾曲部12の湾曲動作をおこなわしめるようになっている。20

#### 【0038】

ところで、使用中に操作部7を落下させたり意図せずに誤操作してしまう等に起因して湾曲操作入力部材20の急激な操作が生じた場合には、これに伴って湾曲操作入力部材20から湾曲操作信号が生じ湾曲駆動部30が駆動される。これにより、湾曲部12は操作者の意図しないほど急激な湾曲動作がおこなわれてしまうことになる。

#### 【0039】

そこで、本実施形態の電動湾曲内視鏡装置1における電動湾曲内視鏡2は、湾曲部12の操作者の意図しない湾曲動作を抑止するための抑止手段が設けられている。

#### 【0040】

すなわち、上記電動湾曲内視鏡2の操作部7には、操作者の湾曲操作意図を検知するための意図検知部39が設けられている。この意図検知部39は、操作部7の把持部7aにおいて、操作者の手のひらの一部が当接する部位に配置されている。したがって、操作者が操作部7の把持部7aを持ったときにのみ意図検知部39による意図検知信号が発生するようになっている。30

#### 【0041】

なお、意図検知部39は、操作者が把持部7aを持てば湾曲操作入力部材20を操作する際の手の動きを手のひらの微小な圧力変化や温度変化または振動などを検知するセンサ部材、例えば感圧センサや温度センサまたは振動センサなどによって形成される。

#### 【0042】

意図検知部39から延出される信号線39aは、ユニバーサルコード8を挿通しアングルコネクタ9cを介して接続ケーブル5aを挿通し、湾曲制御装置5の制御部35と電気的に接続されている。これにより、意図検知部39によって検知される操作者の湾曲操作意図を示す意図検知信号が制御部35へと出力されるようになっている。40

#### 【0043】

そして、制御部35は、湾曲操作入力部材20の入力指示と共に意図検知部39による意図検知信号が入力されているか否かによって、湾曲操作入力部材20の入力指示が有効であるかまたは無効であるかを、すなわち湾曲操作入力部材20の入力指示が操作者が意図して操作したものであるか否かを判断するようになっている。

#### 【0044】

本実施形態の電動湾曲内視鏡装置1の電動湾曲内視鏡2における湾曲操作入力部材20では、さらに湾曲操作入力部材20に動作抵抗を生じさせる動作抵抗手段を備えて構成している。

#### 【0045】

ここで、湾曲操作入力部材20の詳細構成について、図3及び図4によって以下に説明する。

#### 【0046】

図3は、本実施形態の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡における湾曲操作入力部材の概略構成を示す縦断面図である。図4は、図3の湾曲操作入力部材における動作抵抗手段の構成を示す図であって、図3のIV-IV線に沿う断面図である。図5は、図3のV部を拡大して示す要部拡大断面図である。また、図6は、図3と同様に同湾曲操作入力部材の縦断面図であって、図3の湾曲操作入力部材の操作子を所定の方向に傾倒させた状態を示している。図7は、図6の状態にあるときの動作抵抗手段を示し、図6のVII-VII線に沿う断面図である。なお、図3は操作子が中立位置にある状態を示しており、図6は操作子が所定の方向へ傾倒させた状態を示している。

10

#### 【0047】

上記電動湾曲内視鏡2における湾曲操作入力部材20は、本体40と、軸状部材からなる操作子41と、この操作子41の中立位置を保持する中立復帰バネ(図示せず)と、粘性流体44aを用いた動作抵抗手段とによって主に構成されている。

20

#### 【0048】

この場合において、動作抵抗手段を構成する構成部材以外の部分については、従来的一般的なジョイスティック方式の湾曲操作入力部材の構成と同様に構成されている。したがって、以下の説明においては、動作抵抗手段の構成を主に詳述し、それ以外の構成についての簡略的な説明のみにとどめる。

#### 【0049】

すなわち、操作子41は、操作者の指が当接する操作子頭部41bと、この操作子頭部41bを先端に配設し後端が本体40に軸支される軸部41aとによって構成されている。

#### 【0050】

操作子41は、その軸支点(図3及び図6の符号B参照)を中心点として図3に示す矢印R方向を含む球面に沿う範囲内で回動自在となるように軸支されている。換言すれば、操作子41は、軸部41aが図3及び図4に示す中立位置にあるときの軸中心線Aに対して図3及び図4の矢印R方向を含む球面内で傾倒し得るようになっている。なお、図3に示す状態、すなわち操作子41が中立位置にあるときには、本実施形態の電動湾曲内視鏡装置1の電動湾曲内視鏡2の湾曲部12は直線状態にあるものとする。

30

#### 【0051】

さらに、操作子41を傾倒させた状態(例えば図6に示す状態)としたときにも、操作子41の傾倒状態を維持しつつ図4及び図7の矢印W方向に回動させ得るようになっていている。なお、図6及び図7は、操作子41を最も傾倒させた状態を示している。この状態において、本実施形態の電動湾曲内視鏡装置1の電動湾曲内視鏡2の湾曲部12は最大湾曲状態となっている。したがって、電動湾曲内視鏡装置1の電動湾曲内視鏡2の湾曲部12の湾曲可能角度(以下、湾曲角度という)は、湾曲操作入力部材20の操作子41の傾倒角度に対応している。

40

#### 【0052】

上記湾曲操作入力部材20の動作抵抗手段は、操作子41の軸部41aに固設され操作子41の移動に連動して移動自在に配設される板状部材である円板状部材42と、この円板状部材42が内部で移動自在となるように円板状部材42を取り囲むよう形成される収納体(43, 45; 詳細構成は後述する)と、この収納体の内部空間に封入される粘性流体44aとによって構成されている。

#### 【0053】

50

円板状部材42の略中心部には、貫通孔42aが穿設されており、この貫通孔42aに対して操作子41の軸部41aが挿通されている。貫通孔42aの内径は、軸部41aの直径よりも若干大径に形成されている。そして、軸部41aの外周面と貫通孔42aの内周面との間には弾性を有するシール部材が配設されている。なお、円板状部材42を形成する部材としては、例えばポリアセタール等の表面の摩擦抵抗が低い材質の部材が適用される。

#### 【0054】

また、円板状部材42の貫通孔42aの内周面には、シール部材42bが設けられていて、操作子41の軸部41aとの間に挟持されている。これにより、シール部材42bは、円板状部材42の貫通孔42aと操作子41の軸部41aとの両者間に生じるガタを防止する役目をしているのと同時に、操作子41が傾倒する際に生じる軸部41aの移動差分を吸収している。10

#### 【0055】

円板状部材42の外周側には、同円板状部材42の少なくとも外周縁部近傍を取り囲むように形成される収納体(43, 45)が配設されている。この収納体は、受け部材43と蓋部材45との二つの部材によって構成されている。

#### 【0056】

受け部材43は、全体として円環形状からなり、円板状部材42の外周縁部の底面側を支持するシール部材43a(図5参照)を備えた円環部43cと、この円環部43cの外周縁部に連設され外周壁を形成する立上壁部43dとによって形成されている。これにより、受け部材43の断面は略L字形状に形成されている。20

#### 【0057】

蓋部材45は、上記受け部材43の円環部43cと略同形状の円環状の板部材によって形成され、円板状部材42の外周縁部の上面側を支持するシール部材45aを備えた部材である。この蓋部材45の外周縁部は、上記受け部材43の立上壁部43dの上端側内周面に接して配置され、この部位において接着固定されている。なお、受け部材43と蓋部材45との接着固定手段としては、例えば接着剤を用いたり、受け部材43及び蓋部材45が樹脂製である場合には熱溶着等の手段が用いられる。

#### 【0058】

こうして受け部材43と蓋部材45とが一体に形成される収納体の形態は、図3に示すように全体としては中空の円筒形状からなり、略中心部に円形状の孔43bを有する円環状の外観を備え、その断面は円環の内周側に向かた開口43e(図5参照)を有するチャンネル状(コの字状)に形成される筐体となっている。30

#### 【0059】

また、受け部材43の円環部43cの内周縁部と蓋部材45の内周縁部(円環の内周側の上記開口43eの近傍部位)には、図5に示すように互いに対向するようにシール部材43a, 45aが配設されている。このシール部材43a, 45aの間に形成される隙間、すなわち開口43eには、上記円板状部材42が図3及び図5に示す矢印X方向であって、軸中心線A(図3参照)に直交する面内で摺動自在に挟持されるようになっている。40

#### 【0060】

この場合において、各シール部材43a, 45aの形状は、各シール部材43a, 45aと円板状部材42との当接状態が点接触となるように設定されている。つまり、両者が接触することにより生じる摩擦抵抗ができるだけ小さくなるように設定している。したがって、これにより円板状部材42は、収納体(43, 45)に対して抵抗なく円滑に所定方向へと摺動し得るようになっている。

#### 【0061】

そして、このような構成により、円板状部材42は、図3の中立状態における軸中心線Aに対して直交する面内において、すなわち図3及び図5に示す矢印X方向を含む面に沿う方向にのみ円滑に移動し得るように規制されている。

#### 【0062】

10

20

30

40

50

なお、円板状部材 4 2 は、上述したように所定の方向、すなわち図 3 及び図 5 に示す矢印 X 方向（軸中心線 A に直交する面内）において摺動自在となっている。このとき、円板状部材 4 2 は、収納体（4 3，4 5）の各シール部材 4 3 a，4 5 a によって常に挟持される状態が維持されるように、その摺動範囲が規制されている。

#### 【0063】

換言すると、円板状部材 4 2 は、上述したように操作子 4 1 の移動に連動して所定の方向（図 3 及び図 5 の矢印 X 方向を含む面に沿う方向）に移動するようになっている。そして、操作子 4 1 が所定の方向（図 3 及び図 4 の矢印 R 方向を含む球面に沿う方向）に傾倒されると、これに連動して円板状部材 4 2 も所定の方向へ所定の面内（軸中心線 A に直交する面内）において移動することになる。

10

#### 【0064】

この場合において、図 6 に示す状態、すなわち操作子 4 1 を所定の方向に最も傾倒させた状態とすると、操作子 4 1 の軸部 4 1 a の中程の所定の部位 4 1 c が収納体 4 3 の孔 4 3 b の内周縁部に当接する。この状態となったときに、操作子 4 1 及び円板状部材 4 2 の移動が規定されるようになっている。つまり、円板状部材 4 2 の摺動範囲は、操作子 4 1 が中立状態にある図 3 の状態から、操作子 4 1 の軸部 4 1 a の所定の部位 4 1 c が孔 4 3 b の内周縁部に当接した図 6 の状態になるまでの範囲内にある。この図 6 の状態では、円板状部材 4 2 の外周縁部が収納体（4 3，4 5）の各シール部材 4 3 a，4 5 a に挟持されている状態が維持されている。

#### 【0065】

そして、受け部材 4 3 と蓋部材 4 5 とによって形成される空間である収納体内部空間 4 4（図 5 参照）には粘性流体 4 4 a が封入されている。この粘性流体 4 4 a としては、例えばオイルグリスやゲル状部材等の粘性を有する流体が適用される。

20

#### 【0066】

したがって、これにより円板状部材 4 2 が操作子 4 1 によって移動すると、円板状部材 4 2 は収納体内部空間 4 4 に対して挿脱されるように X 方向の面内を移動する。このときの円板状部材 4 2 の摺動状態は、収納体内部空間 4 4 に封入される粘性流体 4 4 a の粘性が動作抵抗となって緩和されることになる。このことから、操作子 4 1 等に対して操作者の意図しない力量が加わったような場合にも、操作子 4 1 及び円板状部材 4 2 が急激に移動するのを抑止する構成となっている。

30

#### 【0067】

また、上述したように湾曲操作入力部材 2 0 は、中立復帰バネ（図示せず）を有している。この中立復帰バネは、操作子 4 1 の所定の中立位置が常に維持されるように、同操作子 4 1 を付勢している部材である。したがって、例えば操作者による所定の力量が操作子 4 1 に対して附加されることによって、同操作子 4 1 が所定の方向に傾倒された状態にあるとき、その力量が解除されると、同操作子 4 1 は、中立復帰バネの作用によって常に所定の中立位置へと復帰するようになっている。

#### 【0068】

そのために、粘性流体 4 4 a は、中立復帰バネによる操作子 4 1 の中立位置への復帰力を抑えつつ、この復帰力を阻害しない程度の粘度のものが用いられる。換言すれば、粘性流体 4 4 a の粘度の設定によって、操作子 4 1 の中立位置への復帰速度を所望のものとなるように設定調整することができるようになっている。

40

#### 【0069】

このように構成される本実施形態の電動湾曲内視鏡装置 1 は、図 1 に示す形態、すなわち電動湾曲内視鏡 2 が、光源装置 3 やビデオプロセッサ 4 や湾曲制御装置 5 などに接続された形態で、例えば内視鏡検査等に用いられる。

#### 【0070】

この場合において、操作者は、電動湾曲内視鏡 2 の把持部 7 a を把持して内視鏡検査をおこなう。このとき、意図検知部 3 9 が操作者の手のひらによって覆われることで意図検知信号が生じる。この状態で操作者は、湾曲操作入力部材 2 0 を操作して湾曲部 1 2 の湾

50

曲操作をおこなったり、操作部 7 に設けられる各種の操作部材を操作することになる。制御部 35 は、意図検知部 39 からの意図検知信号と湾曲操作入力部材 20 の入力指示信号とを受けると、これに基づく入力指示に従った所定の湾曲動作制御をおこなう。

#### 【0071】

操作者が湾曲操作入力部材 20 を操作するのに際しては、例えば指の腹を操作子 41 の操作子頭部 41b に当てて軸部 41a を所望の方向へと傾倒させる。軸部 41a が傾倒する際には、軸部 41a に連動して円板状部材 42 が収納体内部空間 44 の内部を移動することになる。このとき、収納体内部空間 44 には粘性流体 44a が封入されていることから、円板状部材 42 は粘性流体 44a の粘性による動作抵抗が働き、よって円板状部材 42 が急激に移動することなく、操作者の操作意図通りに移動する。

10

#### 【0072】

また、湾曲操作入力部材 20 の軸部 41a が傾倒された状態で、操作者が指を話してしまったような場合には、円板状部材 42 は中立復帰バネ（図示せず）の付勢力によって図 3 の中立位置に復帰する。この場合にも、円板状部材 42 は粘性流体 44a の粘性による動作抵抗によって急激な移動が抑止されることになるので、湾曲操作入力部材 20 は徐々に中立位置へと移動することになる。

#### 【0073】

以上説明したように上記第 1 の実施形態によれば、湾曲操作入力部材 20 の操作子 41 を傾倒させて操作する場合や、同操作子 41 が傾倒しているた状態から中立位置に復帰する際には、当該操作子 41 の軸部 41a の傾倒に連動して移動する円板状部材 42 に対して粘性流体 44a による動作抵抗が働く構成としている。この構成により、湾曲操作入力部材 20 の操作子 41 を操作する際に、操作子 41 が急激に移動してしまうことを抑えることができる。このことは、操作子 41 の傾倒動作に連動して作用する電動湾曲内視鏡 2 の湾曲部 12 が急激に湾曲動作してしまうことを抑えることにもなる。したがって、これにより電動湾曲内視鏡 2 の操作性の向上に寄与することができる。

20

#### 【0074】

上述の第 1 の実施形態においては、湾曲操作入力部材 20 における収納体内部空間 44 の外観形状を略円環状に形成しているが、これに限ることはない。

#### 【0075】

例えば、次に説明する本発明の第 2 の実施形態では、湾曲操作入力部材 20 における収納体内部空間 44 は、上面側から見た場合の断面形状が略長方形状の少なくとも内壁四隅を円弧状に形成したものである。

30

#### 【0076】

図 8 ~ 図 12 は、本発明の第 2 の実施形態を示し、図 8 は、本実施形態の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡における湾曲操作入力部材の概略構成を示す縦断面図である。図 9 ~ 図 12 は、図 8 の湾曲操作入力部材における動作抵抗手段の構成を示す図であって、図 8 の IX - IX 線に沿う断面図である。なお、図 9 は操作子が中立位置にある状態を示し、図 10 ~ 図 12 では、湾曲操作入力部材の操作子を所定の方向に傾倒させた状態をそれぞれ示している。このうち、図 10 は矢印 R1 方向に傾倒させた状態を、図 11 は矢印 R2 方向に傾倒させた状態を、図 12 は矢印 R3 方向に傾倒させた状態を、それぞれ示している。

40

#### 【0077】

本実施形態の基本的な構成は、上述の第 1 の実施形態と略同様である。本実施形態においては、上述の第 1 の実施形態における湾曲操作入力部材 20 に対して、湾曲操作入力部材 20A の一部を構成する収納体の構成が若干異なるのみである。したがって、上述の第 1 の実施形態と同様の構成については、同じ符号を用いて詳細な説明は省略し、湾曲操作入力部材 20A において異なる部分についてのみ、以下に詳述する。

#### 【0078】

本実施形態の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡における湾曲操作入力部材 20A は、図 8 及び図 9 に示すように本体 40 と、操作子 41 と、中立復帰バネ（図示せず）と、

50

粘性流体 4 4 a を用いた動作抵抗手段とによって主に構成されている。

【 0 0 7 9 】

上記湾曲操作入力部材 2 0 A の動作抵抗手段は、操作子 4 1 の軸部 4 1 a に固設される円板状部材 4 2 と、この円板状部材 4 2 が内部で移動自在となるように円板状部材 4 2 を取り囲むよう形成される収納体 ( 4 3 A , 4 5 A ; 詳細構成は後述する ) と、この収納体の内部空間に封入される粘性流体 4 4 a とによって構成されている。

【 0 0 8 0 】

上記収納体は、受け部材 4 3 A と蓋部材 4 5 A との二つの部材によって構成されている。このうち受け部材 4 3 A は、上述の第 1 の実施形態と略同様の構成からなるものであるが、全体としては略中央部に孔 4 3 A b を有する中空の略四角柱状に形成されている点が異なる。そして、これにより形成される収納体内部空間 4 4 A は、上面側から見た場合の断面形状が、図 9 に示すように略長方形形状の少なくとも内壁四隅を円弧状に形成した形態となっている。なお、この場合において、収納体内部空間 4 4 A は、上面側から見た場合の断面形状を略正方形状とすると、機能的には上述の第 1 の実施形態と全く同様となる。

【 0 0 8 1 】

ここで、図 9 に示すように操作子 4 1 の軸部 4 1 a の軸中心線 A に直交する面内（すなわち円板状部材 4 2 の移動し得る方向に沿う面内）において、軸中心線 A に対して互いに直交する二本の中心線を符号 C 1 , C 2 とする。このうち中心線 C 1 から収納体内部空間 4 4 A の短辺との距離をそれぞれ符号 D 2 , D 4 とし、中心線 C 2 から収納体内部空間 4 4 A の長辺との距離をそれぞれ符号 D 1 , D 3 とする。

【 0 0 8 2 】

この場合において、収納体内部空間 4 4 A は、短辺の長さ寸法 = D 1 + D 3 、かつ長辺の長さ寸法 = D 2 + D 4 からなる略長方形の少なくとも内壁四隅を円弧状に形成した形態となっている。その他の構成は、上述の第 1 の実施形態と略同様である。

【 0 0 8 3 】

このように構成した上記湾曲操作入力部材 2 0 A においては、操作子 4 1 を例えば図 9 の R 1 方向に傾倒させて図 1 0 に示す状態とした場合の傾倒角度、すなわち円板状部材 4 2 の移動量は、収納体内部空間 4 4 A における短辺方向の寸法 D 1 によって規定されることになる。

【 0 0 8 4 】

同様に、操作子 4 1 を図 9 の R 2 方向に傾倒させて図 1 1 に示す状態とした場合の傾倒角度（円板状部材 4 2 の移動量）は、収納体内部空間 4 4 A における長辺方向の寸法 D 2 によって規定される。

【 0 0 8 5 】

また同様に、操作子 4 1 を図 9 の R 3 方向に傾倒させた場合の傾倒角度（円板状部材 4 2 の移動量）は、収納体内部空間 4 4 A における短辺方向の寸法 D 3 によって規定される。

【 0 0 8 6 】

さらに同様に、操作子 4 1 を図 9 の R 4 方向に傾倒させた場合の傾倒角度（円板状部材 4 2 の移動量）は、収納体内部空間 4 4 A における長辺方向の寸法 D 4 によって規定される。

【 0 0 8 7 】

なお、図 1 2 は、操作子 4 1 を同図の符号 R 5 方向に傾倒させた場合を示しており、その傾倒角度（円板状部材 4 2 の移動量）は、収納体内部空間 4 4 A における傾倒方向の寸法によって規定されるのは同様である。

【 0 0 8 8 】

このように、本実施形態における湾曲操作入力部材 2 0 A では、収納体内部空間 4 4 A の断面形状の設定、すなわち各寸法 D 1 , D 2 , D 3 , D 4 のそれぞれの設定を工夫することによって、湾曲方向により異なる湾曲角度を設定することができる。本実施形態においては、例えば上述の各寸法のうち寸法 D 1 = D 3 , 寸法 D 2 = D 4 に設定し、かつ寸法

10

20

30

40

50

D<sub>1</sub> < D<sub>2</sub>となるように、各寸法を設定している。これにより、本実施形態においては、操作子41を図9の矢印R1方向（例えば左方向への湾曲）と同図矢印R3方向（例えば右方向への湾曲）とにそれぞれ傾倒させたときの湾曲角度が等しくなるように設定される。また、図9の矢印R2（例えば上方向への湾曲）と同図矢印R4方向（例えば下方向への湾曲）とにそれぞれ傾倒させたときの湾曲角度が等しくなるように設定している。そして、図9の矢印R1，R3方向に傾倒させたときの湾曲角度（左右方向への湾曲角度）と、図9の矢印R2，R4方向に傾倒させたときの湾曲角度（上下方向への湾曲角度）とが異なるように設定している。

#### 【0089】

また、これとは別に、上述の各寸法のうち寸法D<sub>1</sub> D<sub>3</sub>，寸法D<sub>2</sub> D<sub>4</sub>などの設定により、左右方向及び上下方向へのそれぞれの湾曲角度を任意に設定することができる。10

#### 【0090】

以上説明したように上記第2の実施形態によれば、上述の第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。これと同時に、収納体内部空間44Aの断面形状における各寸法の設定を工夫して、操作子41の傾倒角度に伴う円板状部材42の移動量を規制することにより、湾曲部（12）の湾曲角度を用途に応じた所望の角度となるような設定の湾曲操作入力部材20Aとすることができる。したがって、これにより電動湾曲内視鏡の操作性の向上に寄与することができる。

#### 【0091】

次に、本発明の第3の実施形態の電動湾曲内視鏡装置について、図13～図16を用いて以下に説明する。20

#### 【0092】

図13～図16は、本発明の第3の実施形態を示し、図13は、本実施形態の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡における湾曲操作入力部材の概略構成を示す縦断面図である。図14～図16は、図13の湾曲操作入力部材における動作抵抗手段の構成の一部を取り出して示す図であって、図14は、図13のXIV-XIV線に沿う収納体の受け部材の断面図である。図15は、図13の矢印E方向から見た際の円板状部材の平面図である。図16は、図13のXVI部を拡大して示す要部拡大断面図である。

#### 【0093】

本実施形態の基本的な構成は、上述の第1の実施形態と略同様である。本実施形態においては、上述の第1の実施形態における湾曲操作入力部材20に対して、湾曲操作入力部材20Bの一部を構成する収納体の構成が若干異なるのみである。したがって、上述の第1の実施形態と同様の構成については、同じ符号を用いて詳細な説明は省略し、湾曲操作入力部材20Bにおいて異なる部分についてのみ、以下に詳述する。30

#### 【0094】

本実施形態の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡における湾曲操作入力部材20Bは、図13に示すように本体40と、操作子41と、中立復帰バネ（図示せず）と、粘性流体44aを用いた動作抵抗手段とによって主に構成されている。

#### 【0095】

上記湾曲操作入力部材20Bの動作抵抗手段は、操作子41の軸部41aに固設される円板状部材42Bと、この円板状部材42Bが内部で移動自在となるように円板状部材42Bを取り囲むよう形成される収納体（43B，45B；詳細構成は後述する）と、この収納体の内部空間に封入される粘性流体44aとによって構成されている。40

#### 【0096】

上記収納体は、受け部材43Bと蓋部材45Bとの二つの部材によって構成されている。このうち受け部材43Bは、上述の第1の実施形態と略同様の構成からなるものであるが、同受け部材43の円環部43cの内面側に所定間隔をもって放射状に並べて形成される複数の突起部43Bfを具備して形成されている点が異なる。また、これに対応させて円板状部材42Bには、上記突起部43Bfに対向する側の面の外周縁寄りの部位にV字状の周溝（以下、V字状溝という）42Bfが形成されている。50

## 【0097】

そして、湾曲操作入力部材 20B が組み立てられた状態においては、図 16 に示すように円板状部材 42B が操作子 41 の傾倒動作（図 13 の矢印 R 方向参照）に応じて所定の方向（図 13 及び図 16 の矢印 X 方向）に移動する際に、突起部 43Bf が複数の V 字状溝 46 に対して段階的に嵌合及び離脱を繰り返しつつ移動するようになっている。したがって、突起部 43Bf が V 字状溝 46 に嵌合する都度、円板状部材 42B の矢印 X 方向への移動の動作抵抗が生じるようになっている。さらに、収納体の収納体内部空間 44B には、上述の各実施形態と同様に粘性流体 44a が封入されている。

## 【0098】

上述のように突起部 43Bf と V 字状溝 46 とによって、いわゆるクリック機構が形成されている。この場合において、突起部 43Bf と V 字状溝 46 の嵌合力は、突起部 43Bf が V 字状溝 46 に嵌合し離脱する際に、操作子 41 を操作する操作者にクリック感を与える程度に設定されればよい。

## 【0099】

したがって、操作子 41 を傾倒した状態で操作者が手を離したときには、操作子 41 は中立復帰バネの付勢力によって中立位置への移動を開始し、これに連動して円板状部材 42B も粘性流体 44a の動作抵抗に抗して中立位置へと移動する。この移動中に突起部 43Bf が V 字状溝 46 に嵌合したとき、このことでその移動が停止されることはなく、操作子 41（円板状部材 44）は最終的に所定の中立位置に復帰し得るようになっている。他の構成は、上述の第 1 の実施形態と略同様である。

## 【0100】

このように構成した上記湾曲操作入力部材 20B においては、収納体内部空間 44B に封入される粘性流体 44a による動作抵抗に加えて、突起部 43Bf と V 字状溝 46 とが嵌合することによって生じる動作抵抗が、操作子 41 の傾倒動作時または復帰動作時に負荷されるようになっている。

## 【0101】

以上説明したように上記第 3 の実施形態によれば、上述の第 1 の実施形態と同様の効果を得ることができる。これと同時に、粘性流体 44a による動作抵抗に加えて、さらに、操作子 41 が傾倒または復帰する際の動作に連動して機械的な作用による動作抵抗が発生する構成としたので、操作子 41 を操作する際により微小な操作をおこなうことができるようになる。したがって、これにより電動湾曲内視鏡の操作性の向上に寄与することができる。

## 【0102】

なお、本実施形態では、突起部 43Bf を複数設けるようにしているが、突起部 43Bf は少なくとも一つ形成されればよい。そして、突起部 43Bf を設けることにより生じるクリック感が生じる位置を所定の湾曲角度に対応するように設定しておけば、操作者は、そのクリック感が得られた時点において、湾曲部（12）の設定される所定の湾曲角度を、その操作中に容易に確認することができる。

## 【0103】

さらに、本実施形態の構成に加えて、上述の第 2 の実施形態の構成を加味した形態を採ることもできる。この場合において、V 字状溝は周溝ではなく所定の円弧長を有する溝部または直線状の溝とし、これに応じた部位に突起部を形成することで、円板状部材 42B の移動量が大となる方向と移動量が小となる方向とのそれぞれにおいて V 字状溝と突起部とによる動作抵抗を確保するように形成すればよい。

## 【0104】

このように構成した場合においても、上記第 3 の実施形態と同様の効果に加えて、上述の第 2 の実施形態と同様の効果を得ることができる。

## 【0105】

ところで、上述の各実施形態においては、上記湾曲操作入力部材（20, 20A, 20B）の操作子 41 が傾倒し得る範囲は、収納体（43, 43A, 43B 及び 45, 45A

10

20

30

40

50

, 4 5 B ) に形成される孔 4 3 b , 4 3 A b , 4 3 B b の形状によって規制されるように構成されている。

#### 【 0 1 0 6 】

例えば、上述の第 1 及び第 3 の実施形態においては、孔 4 3 b , 4 3 B b は略円形状に形成されている。また、上述の第 2 の実施形態においては、孔 4 3 A b は略四角形状（略長方形形状の内壁四隅を円弧状とした形状）に形成されている。

#### 【 0 1 0 7 】

操作子 4 1 を傾倒させることによって湾曲部（1 2 ; 図 1 参照）の湾曲角度が設定されることになるが、この場合において、収納体の孔を略円形状に形成した場合には、図 1 7 に示すようになる。

#### 【 0 1 0 8 】

図 1 7 は、収納体の孔とこれによって規制される操作子の軸部の位置との関係を概略的に示す図である。

#### 【 0 1 0 9 】

図 1 7 において、操作子 4 1 を傾倒させた場合において、孔 4 3 b によって規制される軸部 4 1 a のそれぞれの位置を符号 U , D , L , R 及び符号 UL , DR によって示している。この場合において、

操作子 4 1 の軸部 4 1 a が符号 U にあるとき、湾曲部（1 2 ）は上方向（アップ）への最大湾曲状態にある。

#### 【 0 1 1 0 】

操作子 4 1 の軸部 4 1 a が符号 D にあるとき、湾曲部（1 2 ）は下方向（ダウン）への最大湾曲状態にある。

#### 【 0 1 1 1 】

操作子 4 1 の軸部 4 1 a が符号 L にあるとき、湾曲部（1 2 ）は左方向への最大湾曲状態にある。

#### 【 0 1 1 2 】

操作子 4 1 の軸部 4 1 a が符号 U にあるとき、湾曲部（1 2 ）は右方向への最大湾曲状態にある。

#### 【 0 1 1 3 】

また、操作子 4 1 の軸部 4 1 a が符号 UL にあるとき、湾曲部（1 2 ）は左斜め上方向への湾曲状態にある。

#### 【 0 1 1 4 】

同様に、操作子 4 1 の軸部 4 1 a が符号 DR にあるとき、湾曲部（1 2 ）は右斜め下方向への湾曲状態にある。

#### 【 0 1 1 5 】

ここで、例えば操作子 4 1 の軸部 4 1 a を符号 UL に位置させるような操作、すなわちツイスト操作をおこなった場合に上方向及び左方向の最大湾曲状態が確保される実際の位置は、図 1 7 の符号 UL 1 に示す位置に軸部 4 1 a を移動させた場合である。

#### 【 0 1 1 6 】

ところが、上述の第 1 及び第 3 実施形態におけるように、収納体の孔 4 3 b , 4 3 B b を略円形状に形成している場合には、軸部 4 1 a の可動範囲が規制されており、ことのこれから、ツイスト操作をおこなった場合には、操作子 4 1 の軸部 4 1 a を符号 UL 1 の位置にまで移動させることができないようになっている。したがって、この構成では、湾曲部（1 2 ）を、各方向において最大湾曲状態（符号 UL 1 の位置）まで湾曲させることができない場合がある。

#### 【 0 1 1 7 】

具体的には、例えば図 1 7 において操作子 4 1 の軸部 4 1 a が符号 UL の位置にあるとき、上方向においては符号 U 1 に軸部 4 1 a が位置したときに相当する湾曲角度に、左方向においては符号 L 1 に軸部 4 1 a が位置したときに相当する湾曲角度にそれぞれ設定されることになる。したがって、軸部 4 1 a が符号 UL の位置あるときには、符号 U , L で

10

20

30

40

50

示す各方向における位置に対応する最大湾曲角度よりも、符号 Y, X に示す分だけ少ない湾曲角度に規制されている。なお、図 17において操作子 41 の軸部 41a が符号 DR の位置にあるときも全く同様である。

#### 【0118】

適用する電動湾曲内視鏡装置によっては、ツイスト操作において斜め方向への操作（符号 UL, DR 等への方向）をおこなった場合にも、各方向（符号 U, D, L, R 方向）における湾曲角度が、最大湾曲状態と同等の湾曲角度となるような構成が望まれる場合もある。

#### 【0119】

そこで、上述の第 2 の実施形態などに示すものと同様に、収納体の孔 43Ab を略四角形状（略長方形形状の内壁四隅を円弧状とした形状）に形成すれば、ツイスト操作における斜め方向（符号 UL, DR 等への方向）に操作したときにも、各方向での最大湾曲状態とすることができる。10

#### 【0120】

この場合には、収納体の孔 43Ab は図 18 に示すような形態となる。すなわち図 18 において操作子 41 の軸部 41a が符号 UL の位置にあるとき、上方向においては符号 U に軸部 41a が位置したときに相当する湾曲角度（上方向における最大湾曲角度）が、左方向においては符号 L に軸部 41a が位置したときに相当する湾曲角度（左方向における最大湾曲角度）が、それぞれ設定されることになる。したがって、軸部 41a が図 18 の符号 UL の位置あるときには、同図符号 U, L で示す位置での各方向における最大湾曲角度と同等の湾曲角度が設定されることになる。なお、図 18 において操作子 41 の軸部 41a が符号 DR の位置にあるときも全く同様である。20

#### 【0121】

このような構成とすることにより、ツイスト操作における斜め方向（符号 UL, DR 等への方向）へ操作したときにも、常にその最大湾曲状態とすることができる

次に、本発明の第 4 の実施形態の電動湾曲内視鏡装置について、図 19～図 21 を用いて以下に説明する。21

#### 【0122】

図 19 及び図 20 は、本発明の第 4 の実施形態を示し、図 19 は、本実施形態の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡における湾曲操作入力部材の概略構成を示す外観斜視図である。図 20 は、図 19 の湾曲操作入力部材の概略構成を示す縦断面図である。30

#### 【0123】

本実施形態の基本的な構成は、上述の第 1 の実施形態と略同様である。本実施形態においては、上述の第 1 の実施形態における湾曲操作入力部材 20 に対して、操作子 41 の移動を規制し傾倒角度を設定し得る規制部材 47 をさらに備えて構成した点が異なる。したがって、上述の第 1 の実施形態と同様の構成については、同じ符号を用いて詳細な説明は省略し、湾曲操作入力部材 20C において異なる部分についてのみ、以下に詳述する。なお、図 20 においては、湾曲操作入力部材 20C の内部構成を簡略化して図示している。

#### 【0124】

本実施形態の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡における湾曲操作入力部材 20C は、図 19 及び図 20 に示すように本体 40 と、操作子 41 と、中立復帰バネ（図示せず）と、粘性流体（44a；図示せず）を用いた動作抵抗手段とによって主に構成されている。本実施形態においては、これに加えて、本体 40 の上面に操作子 41 の移動を規制し傾倒角度を設定し得る規制部材 47 が配設されている。40

#### 【0125】

この規制部材 47 は、例えば本体 40 の上面を覆い得る薄板状部材であって、略中央部には操作子 41 の移動を規制するための孔 47a が穿設されている。

#### 【0126】

操作子 41 を中立位置より、例えば図 19 の矢印 X または矢印 Y 方向等へ向けて傾倒させていくと、操作子 41 の軸部 41a の所定の部位が規制部材 47 の孔 47a の内周縁部

10

20

30

40

50

に当接する。これによって、操作子 4 1 の移動が規制され、よって傾倒動作が所定の角度で規制されるようになっている。

#### 【0127】

そして、孔 4 8 a のサイズを任意に設定することで、操作子 4 1 の傾倒角度を設定することができる。したがって、湾曲部（図示せず。図 1 参照）の湾曲角度を所望の角度に設定することができるようになっている。その他の構成は、上述の第 1 の実施形態と同様である。

#### 【0128】

また、図 2 1 は、上記第 4 の実施形態の変形例であって、湾曲操作入力部材の概略構成を示す外観斜視図である。

10

#### 【0129】

この変形例においては、図 2 1 に示すように湾曲操作入力部材 2 0 D の本体 4 0 に配設する規制部材 4 7 D に形成する孔 4 7 D a の形状を略四角形状としている。その他の構成は、上述の第 4 の実施形態と全く同様である。

#### 【0130】

この図 2 1 に示す変形例においては、上述の図 1 8 を用いて説明したように、ツイスト操作における斜め方向（符号 U L , D R 等への方向）へ操作子 4 1 を傾倒操作したときにも、常にその最大湾曲状態とすることができる。

#### 【0131】

以上説明したように、上述の第 4 の実施形態及びその変形例によれば、湾曲操作入力部材 2 0 C , 2 0 D において、操作子 4 1 の移動を規制し傾倒角度を設定する規制部材 4 7 , 4 7 D を設けることによって、電動湾曲内視鏡の湾曲部を所望の湾曲角度に設定することができる。

20

#### 【0132】

なお、上述の第 4 の実施形態及びその変形例においては、規制部材 4 7 , 4 7 D を湾曲操作入力部材 2 0 C , 2 0 D の本体 4 0 に対して着脱自在に構成するようにしてもよい。

#### 【0133】

この場合においては、孔 4 7 a のサイズが異なる複数の規制部材 4 7 , 4 7 D を用意することによって、この湾曲操作入力部材 2 0 C , 2 0 D を適用する電動湾曲内視鏡の用途に応じた湾曲部の湾曲角度の設定を、規制部材 4 7 , 4 7 D を交換するのみで任意におこなうことができる。

30

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0134】

【図 1】本発明の第 1 の実施形態の電動湾曲内視鏡装置装置の概略的な構成を示す概略構成図。

【図 2】図 1 の電動湾曲内視鏡装置装置の内部構成の概略的な構成を示す概略構成図。

【図 3】図 1 の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡における湾曲操作入力部材の概略構成を示す縦断面図であって、操作子が中立位置にある状態を示す図。

【図 4】図 3 の湾曲操作入力部材における動作抵抗手段の構成を示し、図 3 の IV - IV 線に沿う断面図。

40

#### 【図 5】図 3 の V 部を拡大して示す要部拡大断面図。

【図 6】図 1 の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡における湾曲操作入力部材の概略構成を示す縦断面図であって、操作子を所定の方向に傾倒させた状態を示す図。

#### 【図 7】図 6 の状態にあるときの動作抵抗手段を示し、図 6 の VII - VII 線に沿う断面図。

【図 8】本発明の第 2 の実施形態の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡における湾曲操作入力部材の概略構成を示す縦断面図。

【図 9】図 8 の湾曲操作入力部材における動作抵抗手段の構成を示し、図 8 の IX - IX 線に沿う断面図であって、操作子が中立位置にある状態を示す図。

【図 10】図 8 の湾曲操作入力部材における動作抵抗手段の構成を示し、図 8 の IX - IX 線に沿う断面図であって、操作子を矢印 R 1 方向に傾倒させた状態を示す図。

50

【図11】図8の湾曲操作入力部材における動作抵抗手段の構成を示し、図8のIX-IX線に沿う断面図であって、操作子を矢印R2方向に傾倒させた状態を示す図。

【図12】図8の湾曲操作入力部材における動作抵抗手段の構成を示し、図8のIX-IX線に沿う断面図であって、操作子を矢印R3方向に傾倒させた状態を示す図。

【図13】本発明の第3の実施形態の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡における湾曲操作入力部材の概略構成を示す縦断面図。

【図14】図13の湾曲操作入力部材における動作抵抗手段の構成の一部を取り出して示す図であって、図13のXIV-XIV線に沿う収納体の受け部材の断面図。

【図15】図13の湾曲操作入力部材における動作抵抗手段の構成の一部を取り出して示す図であって、図13の矢印E方向から見た際の円板状部材の平面図。

【図16】図13の湾曲操作入力部材における動作抵抗手段の構成の一部を取り出して示す図であって、図13のXVI部を拡大して示す要部拡大断面図。

【図17】本発明の第1及び第3の実施形態の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡の湾曲操作入力部材における収納体の孔とこれによって規制される操作子の軸部の位置との関係を概略的に示す図。

【図18】本発明の第2の実施形態の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡の湾曲操作入力部材における収納体の孔とこれによって規制される操作子の軸部の位置との関係を概略的に示す図。

【図19】本発明の第4の実施形態の電動湾曲内視鏡装置の電動湾曲内視鏡における湾曲操作入力部材の概略構成を示す外観斜視図。

【図20】図19に示す湾曲操作入力部材の概略構成を示す縦断面図。

【図21】本発明の第4の実施形態の変形例における湾曲操作入力部材の概略構成を示す外観斜視図。

#### 【符号の説明】

##### 【0135】

1 .... 電動湾曲内視鏡装置

2 .... 電動湾曲内視鏡

3 .... 光源装置

4 .... ビデオプロセッサ

5 .... 湾曲制御装置

6 .... 挿入部

7 .... 操作部

7 a .... 把持部

8 .... ユニバーサルコード

9 .... コネクタ部

1 1 .... 先端硬質部

1 2 .... 湾曲部

1 3 .... 可撓管部

1 7 .... 処置具挿入口

2 0 , 2 0 A , 2 0 B , 2 0 C , 2 0 D .... 湾曲操作入力部材

2 5 , 2 5 a , 2 5 b .... 湾曲駒

2 6 .... 湾曲操作ワイヤ

3 0 .... 湾曲駆動部

3 2 .... モータ

4 0 .... 本体

4 1 .... 操作子

4 1 a .... 軸部

4 1 b .... 操作子頭部

4 2 , 4 2 B .... 円板状部材

4 2 a .... 貫通孔

10

20

30

40

50

4 2 b ……シール部材

4 3 , 4 3 A , 4 3 B ……受け部材(収納体)

4 3 B f ……突起部

4 3 a , 4 5 a ……シール部材

4 3 b , 4 3 A b , 4 3 B b ……孔

4 4 , 4 4 A , 4 4 B ……収納体内部空間

4 4 a ……粘性流体

4 5 , 4 5 A , 4 5 B ……蓋部材

4 6 ……V字状溝


4 7 , 4 7 D ……規制部材

4 7 a , 4 7 D a ……孔


代理人弁理士伊藤進

10


【図1】

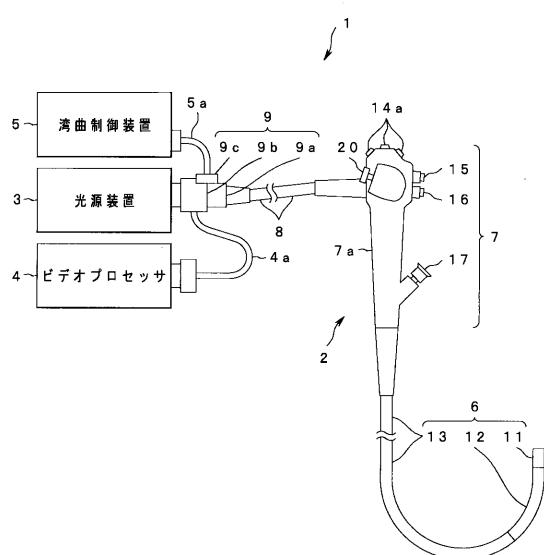


【図2】

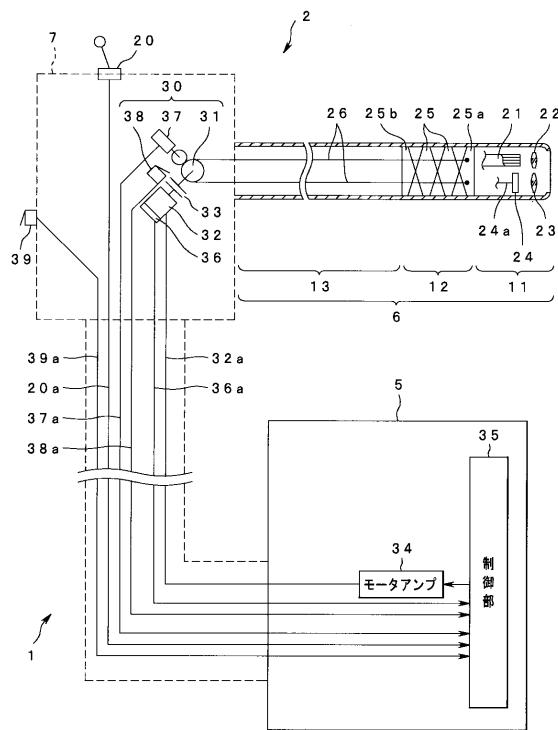


【図3】

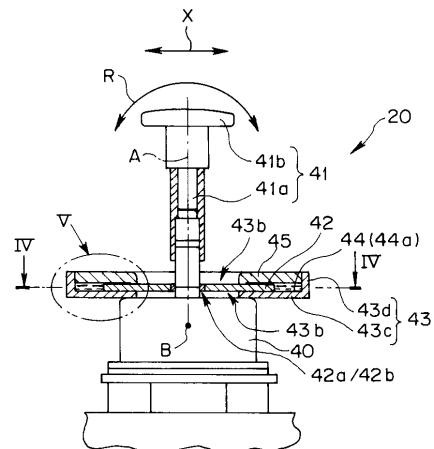


【図4】

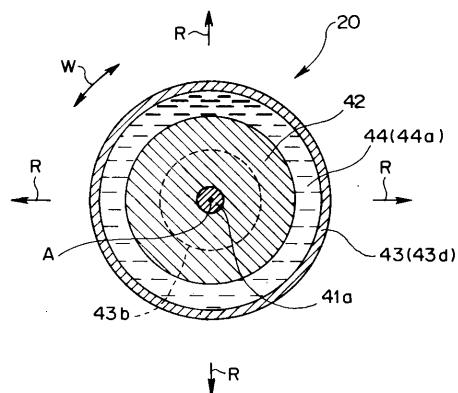


【図5】

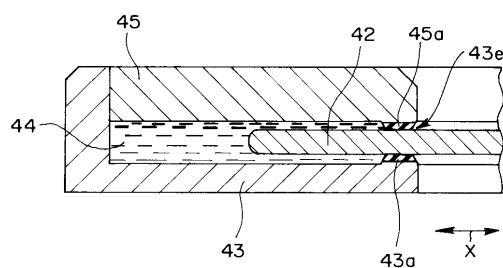


【図6】

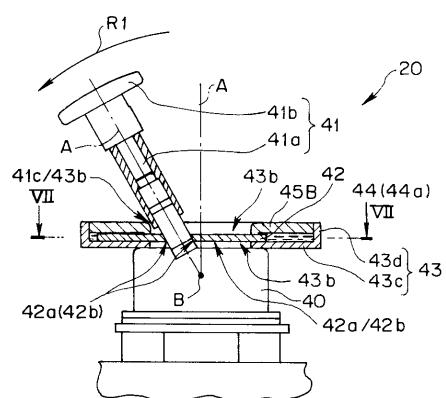


【図8】

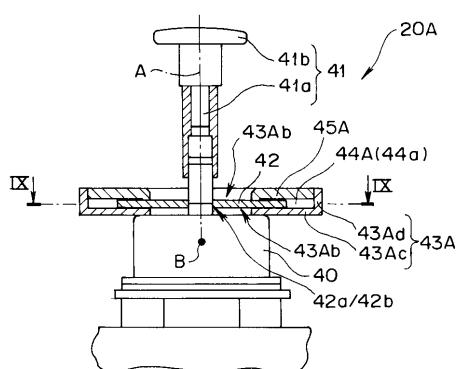


【図7】

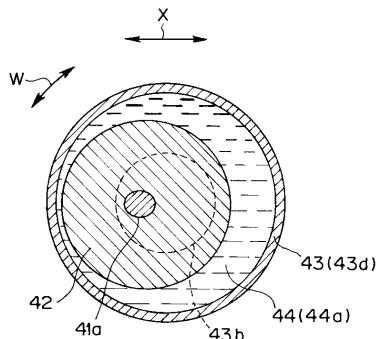


【図9】

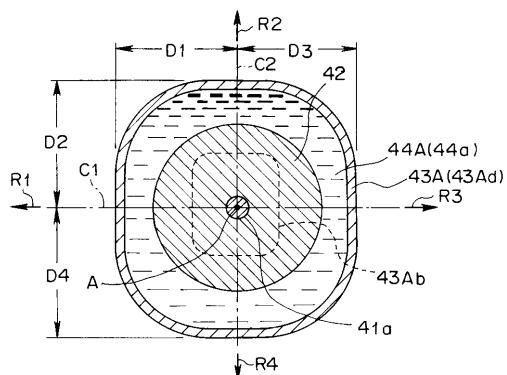


【図10】

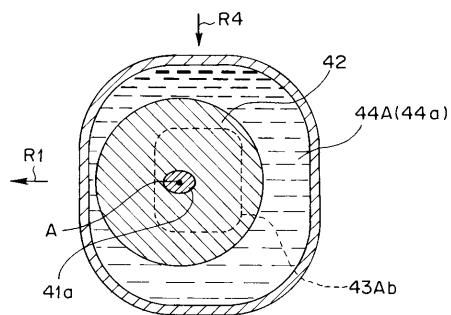


【図12】

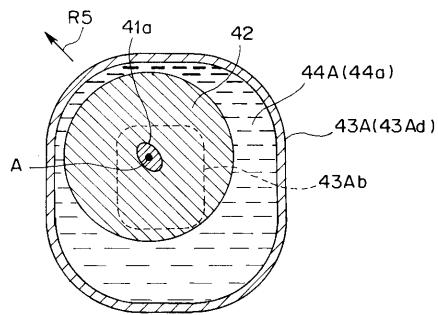


【図11】

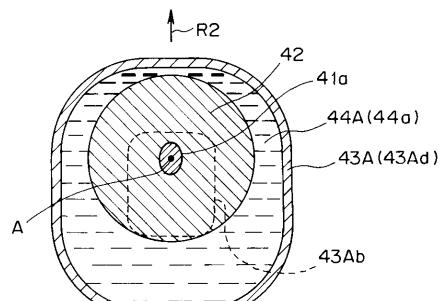


【図13】

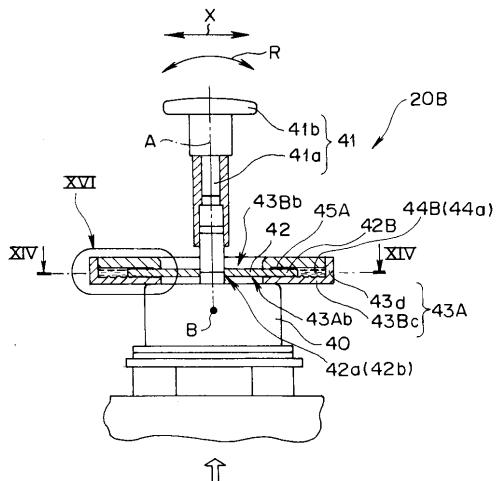


【図14】

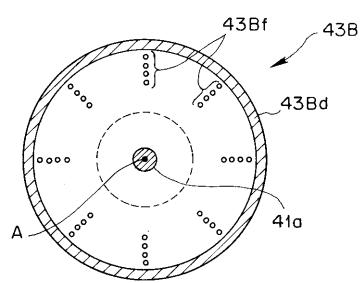


【図16】

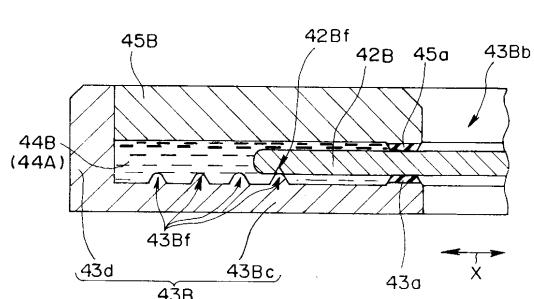


【図15】




【図17】

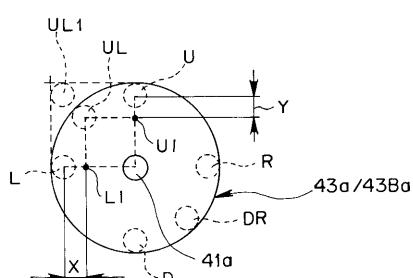


【図 1 8】

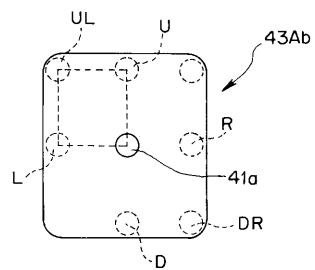


【図 2 0】

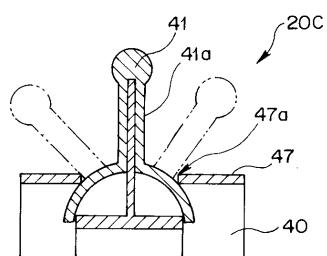

【図 1 9】

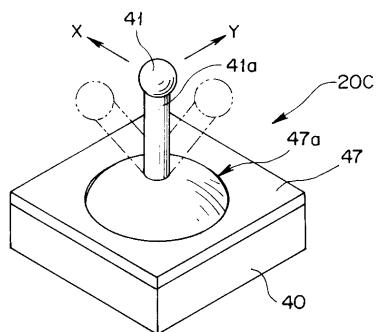

【図 2 1】

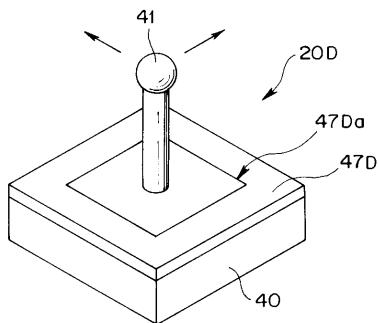

专利名称(译)	电动弯曲内视镜装置		
公开(公告)号	<a href="#">JP2006192201A</a>	公开(公告)日	2006-07-27
申请号	JP2005009474	申请日	2005-01-17
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	小板橋正信 古川達也		
发明人	小板橋 正信 古川 達也		
IPC分类号	A61B1/00 G02B23/24		
CPC分类号	A61B1/0052 A61B1/0016 G02B23/2476 G05G2009/04714 G05G2009/04766		
FI分类号	A61B1/00.310.H G02B23/24.A A61B1/00.711 A61B1/005.523 G06F3/033.330.A G06F3/033.411 G06F3 /0338.411		
F-TERM分类号	2H040/BA21 2H040/DA14 2H040/DA21 2H040/DA41 4C061/FF12 4C061/HH33 4C061/HH47 4C161 /FF12 4C161/HH33 4C161/HH47 5B087/AB11 5B087/BC02 5B087/BC13		
代理人(译)	伊藤 进		
其他公开文献	JP4616017B2		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

### 摘要(译)

要解决的问题：提供一种电动弯曲内窥镜装置，该电动弯曲内窥镜装置设置有弯曲操作输入构件，该弯曲操作输入构件具有能够通过简单机构获得期望的运动阻力并且有助于提高可操作性的构造的运动阻力装置。弯曲操作输入装置，用于指示相对于弯曲部分的弯曲运动的输入;弯曲操作输入装置，用于输入弯曲操作输入到弯曲操作输入装置;操作阻力装置包括板构件42和板构件，板构件42与弯曲操作输入装置的操作器41的运动一起可移动地设置。粘性流体44a被容纳体包围，粘性流体44a围绕粘性流体44a的至少一部分。点域

