

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2007-185517
(P2007-185517A)

(43) 公開日 平成19年7月26日(2007.7.26)

(51) Int. Cl.

F 1

A61B 17/28 (2006.01)
A61B 17/12 (2006.01)
A61B 17/00 (2006.01)
A61B 1/00 (2006.01)

A 6 1 B	17/28	3 1 O
A 6 1 B	17/12	3 2 O
A 6 1 B	17/00	3 2 O
A 6 1 B	1/00	3 3 4 D

テーマコード（参考）

4 C060
4 C061

審査請求 未請求 請求項の数 38 O.L. (全 68 頁)

(21) 出願番号 特願2007-4561 (P2007-4561)
(22) 出願日 平成19年1月12日 (2007.1.12)
(31) 優先権主張番号 11/331, 962
(32) 優先日 平成18年1月13日 (2006.1.13)
(33) 優先権主張国 米国(US)

(71) 出願人	304050923 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
(74) 代理人	100106909 弁理士 棚井 澄雄
(74) 代理人	100064908 弁理士 志賀 正武
(74) 代理人	100101465 弁理士 青山 正和
(74) 代理人	100094400 弁理士 鈴木 三義
(74) 代理人	100086379 弁理士 高柴 忠夫
(74) 代理人	100129403 弁理士 増井 裕士

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 内視鏡用処置具及び留置具並びに装着装置

(57) 【要約】

【課題】より操作性の向上した内視鏡用処置具を提供する。

【解決手段】体内に挿入される挿入部の先端に設けられた処置部7を備え、処置部7は、一对の鉗子部材115, 131と、一对の鉗子部材115, 131の少なくとも一方を他方に対して開閉自在に枢支する枢支軸が支持された先端カバー80と、挿入部の先端に固定され、先端カバー80が挿入部の先端方向及び基端方向に相対的に移動自在に保持される先端保持部71と、対象物を持持するために鉗子部材115, 131を開いているときに先端保持部71に対して先端カバー80を係止して相対的な移動を抑制するピン75と、鉗子部材115, 131を開閉操作させる操作ワイヤ15に設けられ、少なくとも鉗子部材115, 131が閉じた状態のときにはピン75による先端カバー80と先端保持部71との係合を解除させる解除部材105と、を含む。

【選択図】 図 9

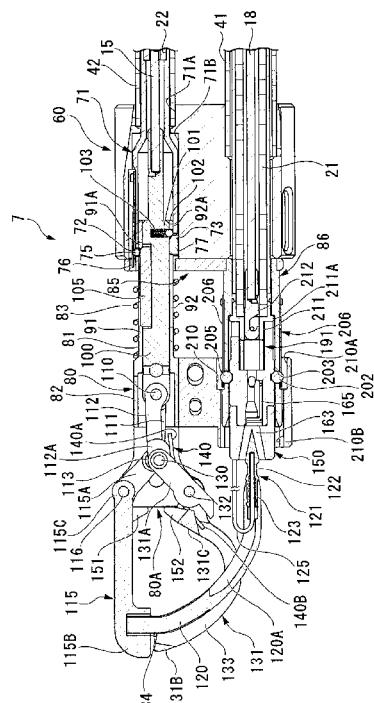

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

先端と基端とを備え、前記先端が体内に挿入される挿入部と、
前記先端に設けられた処置部と、
前記基端に設けられた操作部と、
を備え、前記処置部は、
一対の鉗子部材と、
前記一対の鉗子部材の少なくとも一方を他方に対して開閉自在に枢支する枢支軸が支持された先端カバーと、
前記挿入部の先端に固定され、前記先端カバーが前記挿入部の先端方向及び基端方向に相対的に移動自在に保持される先端保持部と、
対象物を把持するために前記鉗子部材を開いているときに前記先端保持部に対して前記先端カバーを係止して相対的な移動を抑制する先端係止部材と、
前記鉗子部材を開閉操作させる操作部材に設けられ、少なくとも前記鉗子部材が閉じた状態のときには前記先端係止部材による前記先端カバーと前記先端保持部との係合を解除させる先端解除部材と、
を含む内視鏡用処置具。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の内視鏡用処置具であって、
前記先端カバーと前記一対の鉗子部材とを連結させる鉗子係止部材と、
前記鉗子係止部材による連結を前記先端係止部材の係合が解除された後に解除させる鉗子解除部材と、を含む内視鏡用処置具。

【請求項 3】

請求項 1 に記載の内視鏡用処置具であって、
前記一対の鉗子部材のそれぞれに設けられ、前記一対の鉗子部材を閉じたときに前記先端カバーに当接するストッパを含む内視鏡用処置具。

【請求項 4】

請求項 1 に記載の内視鏡用処置具であって、
糸状部材の一端側に取り付けられた先端部材と、他端側に設けられたフック係合部と、
前記糸状部材の一端から他端に至るまでの間に設けられ、前記先端部材と係合可能なケーシングと、前記ケーシングに設けられ、前記糸状部材の一端から他端の間で前記ケーシングが移動することを抑制する係止部材とを有する留置具の前記先端部材が着脱自在に装着されるように前記鉗子部材に設けられた装着部と、

前記ケーシングを着脱自在に保持可能で、前記先端保持部に設けられたケーシング保持部と、
をさらに備え、

前記先端解除部材は、前記鉗子部材の閉動作に伴って、前記先端部材が前記ケーシングに係合し得る状態になったときに前記先端係止部材によって前記先端カバーと前記先端保持部との係合を解除する内視鏡用処置具。

【請求項 5】

請求項 4 に記載の内視鏡用処置具であって、
前記ケーシング保持部に前記ケーシングを係合させるケーシング係止部材と、
前記前記先端カバーに設けられ、前記ケーシング係止部材による前記ケーシング保持部と前記ケーシングとの係合状態を制御するガイド部と、
をさらに含む内視鏡用処置具。

【請求項 6】

請求項 4 に記載の内視鏡用処置具であって、
前記操作部は、
前記鉗子部材の前記開閉操作を行う鉗子操作部と、
前記留置部材のフック係合部が係合可能なフックを操作するためのフック操作部と、

前記鉗子操作部及び前記フック操作部がスライド自在に支持される軸を有する操作本体と、
を含む内視鏡用処置具。

【請求項 7】

請求項 6 に記載の内視鏡用処置具であって、

前記フック操作部は、前記鉗子操作部よりも挿入方向における先端側で前記軸に支持されると共に、前記挿入方向の基端側に向けて延びる少なくとも 1 つの指掛け部を有し、前記指掛け部が前記鉗子操作部よりも前記軸から離間した位置で前記鉗子操作部にオーバーラップするように摺動自在に支持される内視鏡用処置具。

【請求項 8】

請求項 1 に記載の内視鏡用処置具であって、

内視鏡の挿入部分の先端の硬質部分を保持する受け部と、

前記受け部から突出して保持される前記内視鏡の先端位置を前記先端カバーとの相対位置で規定する規定部材と、
を含む内視鏡用処置具。

【請求項 9】

請求項 1 に記載の内視鏡用処置具において、

前記挿入部を内視鏡の挿入部分に沿わせてオーバーチューブ内に挿通させるために、前記内視鏡挿入部と前記挿入部とをそれぞれ挿通させる貫通孔を有する弁体をさらに備え、

前記弁体は、前記貫通孔の開口に設けられた少なくとも 1 つのテープ面と、前記オーバーチューブの内面に当接する当接部とを備える内視鏡用処置具。 20

【請求項 10】

請求項 4 に記載の内視鏡用処置具において、

前記挿入部は、

前記鉗子部材を開閉操作するための第 1 のワイヤを前記先端方向及び前記基端方向に進退自在に挿通した第 1 のシースと、

先端に前記留置具のフック係合部に係合可能なフックが接続される第 2 のワイヤを前記先端方向及び前記基端方向に進退自在に挿通した第 2 のシースと、

前記第 1 のシースと前記第 2 のシースとを束ねる第 1 のホルダと、

前記第 1 のシースと前記第 2 のシースとを束ね、前記第 1 のホルダよりも前記先端側に設けられた第 2 のホルダと、 30

前記第 1 のホルダに対して前記第 2 のシースに摺動抵抗を付与する第 1 の調整部材と、

前記第 2 のホルダに対して前記第 1 のシースに、前記第 1 の調整部材よりも大きい摺動抵抗を付与する第 2 の調整部材と、

を含む内視鏡用処置具。

【請求項 11】

請求項 4 に記載の内視鏡用処置具において、

前記操作部は、

前記鉗子部材の前記開閉操作を行うための鉗子操作部と、

前記留置具の前記フック係合部が係合可能なフックを操作するためのフック操作部と、 40
前記鉗子操作部及び前記フック操作部を同軸上にそれぞれがスライド自在に配置させる操作本体と、

を含む内視鏡用処置具。

【請求項 12】

請求項 11 に記載の内視鏡用処置具であって、

前記フック操作部は、前記鉗子操作部よりも挿入方向で先端側に配置され、前記フック操作部は挿入方向の基端側に向けて延びる複数の指掛け部を有し、前記指掛け部の間に前記鉗子操作部が進入可能である内視鏡用処置具。

【請求項 13】

請求項 11 に記載の内視鏡用処置具であって、

糸状部材の一端側に取り付けられた先端部材と、他端側に設けられたフック係合部と、前記糸状部材の一端から他端に至るまでの間に設けられ、前記先端部材と係合可能なケーシングと、前記ケーシングに設けられ、前記糸状部材の一端から他端の間で前記ケーシングが移動することを抑制する係止部材とを有する留置具をさらに含む内視鏡用処置具。

【請求項 14】

請求項 13 に記載の内視鏡用処置具であって、

前記処置部は、

前記先端部材が着脱自在に装着される、前記鉗子部材に設けられた装着部と、

前記ケーシングを着脱自在に保持する、前記先端保持部に設けられたケーシング保持部と、

をさらに備え、前記先端解除部材は、前記鉗子部材の閉動作に伴い、前記先端部材が前記ケーシングに係合しうる状態になったときには、前記先端係止部材による前記先端カバーと前記先端保持部との係合を解除する内視鏡用処置具。

【請求項 15】

請求項 14 に記載の内視鏡用処置具であって、

前記ケーシング保持部に前記ケーシングを係合させるケーシング係止部材と、

前記前記先端カバーに設けられ、前記ケーシング係止部材による前記ケーシング保持部と前記ケーシングとの係合状態を制御するガイド部と、

をさらに含む内視鏡用処置具。

【請求項 16】

請求項 13 に記載の内視鏡用処置具であって、

前記挿入部は、

前記鉗子部材を開閉操作するための第 1 のワイヤを前記先端方向及び前記基端方向に進退自在に挿通した第 1 のシースと、

先端に前記留置具のフック係合部に係合可能なフックが接続される第 2 のワイヤを前記先端方向及び前記基端方向に進退自在に挿通した第 2 のシースと、

前記第 1 のシースと前記第 2 のシースとを束ねる第 1 のホルダと、

前記第 1 のシースと前記第 2 のシースとを束ね、前記第 1 のホルダよりも前記先端側に設けられた第 2 のホルダと、

前記第 1 のホルダに対して前記第 2 のシースに摺動抵抗を付与する第 1 の調整部材と、

前記第 2 のホルダに対して前記第 1 のシースに、前記第 1 の調整部材よりも大きい摺動抵抗を付与する第 2 の調整部材と、

を含む内視鏡用処置具。

【請求項 17】

請求項 1 に記載の内視鏡用処置具において、

前記操作部は、

前記鉗子部材の前記開閉操作を行うための鉗子操作部と、

前記留置具の前記フック係合部が係合可能なフックを操作するためのフック操作部と、前記鉗子操作部及び前記フック操作部を同軸上にそれぞれがスライド自在に配置される操作本体と、

を含む内視鏡用処置具。

【請求項 18】

体内に挿入される挿入部の先端に設けられ、少なくとも一方が他方に対して開閉自在に枢支された一対の鉗子部材の閉動作に伴って、前記一対の鉗子部材の一方に着脱自在に装着される先端部材を組織に通した後に収容し、前記先端部材と糸で繋がれているケーシングを保持するケーシング保持部と、

前記ケーシング保持部と、前記ケーシングとを係合させるケーシング係止部材と、

前記先端カバーに設けられ、前記ケーシング係止部材による前記ケーシング保持部と前記ケーシングとの係合状態を制御するガイド部材と、

を含む内視鏡用処置具。

10

20

30

40

50

【請求項 19】

一対の鉗子部材と、
前記一対の鉗子部材の少なくとも一方を他方に対して開閉自在に枢支する枢支軸が支持された先端カバーと、
内視鏡の生体内に挿入される先端部分の側部を着脱自在に保持する受け部と、
前記受け部に対して内視鏡先端の突出量を規制するために、前記内視鏡の先端位置を前記先端カバーとの相対的な位置で規定する規定部材と、
を含む内視鏡用処置具。

【請求項 20】

先端側に処置を行うための処置部が接続され、基端側に前記処置部を操作する操作部が接続された第1のシース及び第2のシースと、
前記第1のシース及び前記第2のシースを束ねる第1のホルダと、
前記第1のシース及び前記第2のシースを束ね、前記第1のホルダよりも前記先端側に設けられた第2のホルダと、
前記第1のホルダに対して前記第2のシースに摺動抵抗を付与する第1の調整部材と、
前記第2のホルダに対して前記第1のシースに、前記第1の調整部材よりも大きい摺動抵抗を付与する第2に調整部材と、
を含む内視鏡用処置具。

【請求項 21】

請求項20に記載の内視鏡用処置具であって、
前記第1のシースには前記処置部を動作させるための第1のワイヤが挿通され、
前記第2のシースには前記処置部を動作させるための第2のワイヤが挿通される内視鏡用処置具。

【請求項 22】

請求項21に記載の内視鏡用処置具であって、
前記第1のワイヤは、前記処置部に設けられた一対の鉗子部材の少なくとも一方を他方に対して開閉させる鉗子操作ワイヤである内視鏡用処置具。

【請求項 23】

請求項20に記載の内視鏡用処置具であって、
前記操作部は、
前記鉗子部材を開閉操作する鉗子操作部と、
前記縫合糸を締め付けるフックを操作するフック操作部と、
前記鉗子操作部及び前記フック操作部とを同軸上にスライド自在に配置させる操作本体と、
を含む内視鏡用処置具。

【請求項 24】

請求項23に記載の内視鏡用処置具であって、
前記フック操作部は、前記鉗子操作部よりも挿入方向で先端側に配置され、前記フック操作部は挿入方向の基端側に向けて延びる複数の指掛け部を有し、前記指掛け部の間に前記鉗子操作部が進入可能である内視鏡用処置具。

【請求項 25】

一端と他端とを有する糸状部材と、
前記糸状部材の一端側に接続される先端部材と、
前記糸状部材に設けられる糸係止部材と、
前記先端部材と前記糸係止部材とを収容する空間を有し、前記先端部材と係合する先端部材係止部材が内部に設けられたケーシングと、
前記ケーシングに設けられ、前記先端部材係止部材による前記先端部材の係止を解除する装置を挿入可能な孔と、
を備える留置具。

【請求項 26】

10

20

30

40

50

請求項 1 に記載の内視鏡用処置具であって、
前記先端カバーは、前記先端保持部材に対して互いに離れる方向に押圧する弾性部材を含む内視鏡用処置具。

【請求項 27】

請求項 26 に記載の内視鏡用処置具であって、
前記弾性部材はバネである内視鏡用処置具。

【請求項 28】

先端と基端とを備え、前記先端が体内に挿入される挿入部と、
前記先端に設けられた処置部と、
前記基端に設けられた操作部と、
を備え、

前記処置部は、
前記操作部の操作によって進退する 1 つの入力部材と、
前記入力部材に第一の接続部を介して切り離し可能に接続される第一のリンクと、
前記第一のリンクによって開閉動作可能な第一の鉗子部材と、
前記入力部材に第二の接続部を介して切り離し可能に接続される第二のリンクと、
前記第二のリンクによって開閉動作可能で、前記第一の鉗子部材より開閉可能な角度が小さい第二の鉗子部材と、
を備え、

前記第一の接続部は、前記第二の鉗子部材を所定の開度まで開くまでの間は、前記入力部材と前記第一のリンクの接続を解除する内視鏡用処置具。 20

【請求項 29】

請求項 28 の内視鏡用処置具であって、
前記第二の接続部は、全開させた前記第二の鉗子部材を閉じる動作中には、前記入力部材が所定長だけ駆動するまでの間、前記入力部材と前記第二のリンクを接続する内視鏡用処置具。

【請求項 30】

請求項 28 の内視鏡用処置具であって、
前記第二の接続部は、前記第二の鉗子部材が全開したときに、前記入力部材と前記第二のリンクの接続を解除する内視鏡用処置具。 30

【請求項 31】

先端と基端とを備え、前記先端が体内に挿入される挿入部と、
前記先端に設けられた処置部と、
前記基端に設けられた操作部と、
を備え、
前記処置部は、
前記操作部の操作によって進退する 1 つの入力部材と、
前記入力部材に第一の接続部を介して切り離し可能に接続される第一のリンクと、
前記第一のリンクによって開閉動作可能な第一の鉗子部材と、
前記入力部材に第二の接続部を介して切り離し可能に接続される第二のリンクと、
前記第二のリンクによって開閉動作可能で、前記第一の鉗子部材より開閉可能な角度が小さい第二の鉗子部材と、
を備え、

前記第二の接続部は、全開させた前記第二の鉗子部材を閉じる方向において、前記入力部材が所定長だけ駆動した後、前記入力部材と前記第二のリンクの接続を解除する内視鏡用処置具。 40

【請求項 32】

先端と基端とを備え、前記先端が体内に挿入される挿入部と、
前記先端に設けられた処置部と、
前記基端に設けられた操作部と、

10

20

30

40

50

を備え、

前記処置部は、

前記操作部の操作によって進退する1つの入力部材と、

前記入力部材に第一の接続部を介して切り離し可能に接続される第一のリンクと、

前記第一のリンクによって開閉動作可能な第一の鉗子部材と、

前記入力部材に第二の接続部を介して切り離し可能に接続される第二のリンクと、

前記第二のリンクによって開閉動作可能で、前記第一の鉗子部材より開閉可能な角度が小さい第二の鉗子部材と、

を備え、

前記第二の接続部は、前記第二の鉗子部材が全開したときに、前記入力部材と前記第二のリンクの接続を解除する内視鏡用処置具。

【請求項 3 3】

請求項 2 8、3 1、3 2 の内視鏡用処置具であって、

前記第一、第二の接続部は、前記入力部材を通す穴が1つ形成された板をそれぞれ複数有し、前記穴は前記板を前記入力部材の移動方向に対して傾斜配置したときに前記板と前記入力手段が係合する大きさで、前記板の傾きを制御することで前記第一、第二の接続部と前記入力部材との接続を断続させる内視鏡用処置具。

【請求項 3 4】

請求項 3 3 の内視鏡用処置具であって、

複数の前記板は、異なる方向に斜めに付勢されている内視鏡用処置具。

【請求項 3 5】

先端と基端とを備え、前記先端が体内に挿入される挿入部と、

前記先端に設けられた処置部と、

前記基端に設けられた操作部と、

を備え、

前記処置部は、一対の鉗子部材と、前記一対の鉗子部材の少なくとも一方を他方に対し開閉自在に枢支する枢支軸が支持された先端カバーと、先端カバー内に収容され、前記鉗子部材に着脱自在に装着された針を受け入れ可能なケーシングを保持するケーシング保持部と、前記ケーシング保持部内に配置され、弾性変形により前記ケーシングに係合可能アームが設けられた支持部材と、を有し、

前記ケーシング保持部は、先端開口側では前記ケーシングに前記アームを係止させるように前記アームを押圧して弾性変形させ、基端側では前記アームが復元して開き、前記ケーシングとの係合が解除される空間を有する内視鏡用処置具。

【請求項 3 6】

縫合器に装着される着脱針に、縫合糸を介して縫合糸を受け入れ可能なケーシングを連結したカートリッジを前記縫合器に装着するために用いられる装着装置であって、

前記縫合器を受け入れ可能で、前記着脱針を支持する針保持部と、前記ケーシングを収容し、前記縫合器から離れる方向に付勢されるホルダと、を有する装着装置。

【請求項 3 7】

請求項 3 6 に記載の装着装置であって、

前記ホルダを付勢するバネを有し、前記ホルダは前記バネを引き伸ばした位置でストップにより係止されており、前記縫合糸を巻き取るシリンドラから前記縫合糸が外れたときの回転を利用して前記ホルダのストップを解除する装着装置。

【請求項 3 8】

請求項 3 6 に記載の装着装置であって、

前記ホルダを付勢するバネを有し、前記バネを引き伸ばした位置でストップにより係止されており、前記ストップを収縮させるボタンを設けた装着装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

10

20

30

40

50

本発明は、内視鏡用の処置具であって、特に体内に留置される留置具、及び留置具を留置するための内視鏡用処置具、留置具を装着するための装着装置に関するものである。

【背景技術】

【0002】

人体の臓器などに対して医療行為を行う方法として、腹壁を大きく切開して医療行為を行う開腹手術、腹壁に形成した開口から腹腔内にアプローチして医療行為を行う腹腔鏡手術、あるいは口や肛門などから体内に軟性内視鏡を挿入して所望の処置を行う内視鏡的手技、等が行われている。

これらの方法を用いた医療行為においては、組織の縫合、緊縛、結紮などの処置が行われる。このような処置を行う際に、しばしば体内に留置されるタイプの留置具が用いられる。このような留置具はアプリケータに装着され、体内からアプリケータを操作することで体内の所望の部位に留置される。

特許文献1には、このような留置具とそれを留置するためのアプリケータ（以下、留置具とアプリケータを総称して処置具と称する）の一例を開示している。この関連技術に開示された処置具は、曲針に取り付けた着脱針を組織に穿刺後、フックシースを先端側に動かし、その先端に係合されたケーシングによって着脱針を係合後、フックシースを基端側に引き、曲針から着脱針を取り外す構造になっている。

【特許文献1】米国特許出願2003-0181924号

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

着脱針をケーシングに係合させるためにケーシングを保持するフックシースの進退操作が必要で、そのためには操作部を持ち替える必要があった。また、着脱針がケーシングに係合するためには、着脱針とケーシングの長手方向中心軸を一致させる必要があり、術者が術中に確認しなければならなかった。従来の操作部は構造が複雑であり、操作に熟練を要した。

本発明の目的は、より操作性の向上した内視鏡用処置具を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0004】

上記の課題を解決する本発明の請求項1に係る発明は、先端と基端とを備え、前記先端が体内に挿入される挿入部と、前記先端に設けられた処置部と、前記基端に設けられた操作部と、を備え、前記処置部は、一対の鉗子部材と、前記一対の鉗子部材の少なくとも一方を他方に対して開閉自在に枢支する枢支軸が支持された先端カバーと、前記挿入部の先端に固定され、前記先端カバーが前記挿入部の先端方向及び基端方向に相対的に移動自在に保持される先端保持部と、対象物を把持するために前記鉗子部材を開いているときに前記先端保持部に対して前記先端カバーを係止して相対的な移動を抑制する先端係止部材と、前記鉗子部材を開閉操作させる操作部材に設けられ、少なくとも前記鉗子部材が閉じた状態のときには前記先端係止部材による前記先端カバーと前記先端保持部との係合を解除させる先端解除部材と、を含む内視鏡用処置具とした。

【0005】

請求項2に係る発明は、請求項1に記載の内視鏡用処置具であって、前記先端カバーと前記一対の鉗子部材とを連結させる鉗子係止部材と、前記鉗子係止部材による連結を前記先端係止部材の係合が解除された後に解除させる鉗子解除部材と、を含む。

【0006】

請求項3に係る発明は、請求項1に記載の内視鏡用処置具であって、前記一対の鉗子部材のそれぞれに設けられ、前記一対の鉗子部材を閉じたときに前記先端カバーに当接するストップを含む。

【0007】

請求項4に係る発明は、請求項1に記載の内視鏡用処置具であって、糸状部材の一端側に取り付けられた先端部材と、他端側に設けられたフック係合部と、前記糸状部材の一端

10

20

30

40

50

から他端に至るまでの間に設けられ、前記先端部材と係合可能なケーシングと、前記ケーシングに設けられ、前記糸状部材の一端から他端の間で前記ケーシングが移動することを抑制する係止部材とを有する留置具の前記先端部材が着脱自在に装着されるように前記鉗子部材に設けられた装着部と、前記ケーシングを着脱自在に保持可能で、前記先端保持部に設けられたケーシング保持部と、をさらに備え、前記先端解除部材は、前記鉗子部材の閉動作に伴って、前記先端部材が前記ケーシングに係合し得る状態になったときに前記先端係止部材によって前記先端カバーと前記先端保持部との係合を解除する。

【 0 0 0 8 】

請求項 5 に係る発明は、請求項 4 に記載の内視鏡用処置具であって、前記ケーシング保持部に前記ケーシングを係合させるケーシング係止部材と、前記前記先端カバーに設けられ、前記ケーシング係止部材による前記ケーシング保持部と前記ケーシングとの係合状態を制御するガイド部と、をさらに含む。 10

【 0 0 0 9 】

請求項 6 に係る発明は、請求項 4 に記載の内視鏡用処置具であって、前記操作部は、前記鉗子部材の前記開閉操作を行う鉗子操作部と、前記留置部材のフック係合部が係合可能なフックを操作するためのフック操作部と、前記鉗子操作部及び前記フック操作部がスライド自在に支持される軸を有する操作本体と、を含む。 20

【 0 0 1 0 】

請求項 7 に係る発明は、請求項 6 に記載の内視鏡用処置具であって、前記フック操作部は、前記鉗子操作部よりも挿入方向における先端側で前記軸に支持されると共に、前記挿入方向の基端側に向けて延びる少なくとも 1 つの指掛け部を有し、前記指掛け部が前記鉗子操作部よりも前記軸から離間した位置で前記鉗子操作部にオーバーラップするように摺動自在に支持される。 20

【 0 0 1 1 】

請求項 8 に係る発明は、請求項 1 に記載の内視鏡用処置具であって、内視鏡の挿入部分の先端の硬質部分を保持する受け部と、前記受け部から突出して保持される前記内視鏡の先端位置を前記先端カバーとの相対位置で規定する規定部材と、を含む。 20

【 0 0 1 2 】

請求項 9 に係る発明は、請求項 1 に記載の内視鏡用処置具において、前記挿入部を内視鏡の挿入部分に沿わせてオーバーチューブ内に挿通させるために、前記内視鏡挿入部と前記挿入部とをそれぞれ挿通させる貫通孔を有する弁体をさらに備え、前記弁体は、前記貫通孔の開口に設けられた少なくとも 1 つのテーパ面と、前記オーバーチューブの内面に当接する当接部とを備える。 30

【 0 0 1 3 】

請求項 10 に係る発明は、請求項 4 に記載の内視鏡用処置具において、前記挿入部は、前記鉗子部材を開閉操作するための第 1 のワイヤを前記先端方向及び前記基端方向に進退自在に挿通した第 1 のシースと、先端に前記留置具のフック係合部に係合可能なフックが接続される第 2 のワイヤを前記先端方向及び前記基端方向に進退自在に挿通した第 2 のシースと、前記第 1 のシースと前記第 2 のシースとを束ねる第 1 のホルダと、前記第 1 のシースと前記第 2 のシースとを束ね、前記第 1 のホルダよりも前記先端側に設けられた第 2 のホルダと、前記第 1 のホルダに対して前記第 2 のシースに摺動抵抗を付与する第 1 の調整部材と、前記第 2 のホルダに対して前記第 1 のシースに、前記第 1 の調整部材よりも大きい摺動抵抗を付与する第 2 に調整部材と、を含む。 40

【 0 0 1 4 】

請求項 11 に係る発明は、請求項 4 に記載の内視鏡用処置具において、前記操作部は、前記鉗子部材の前記開閉操作を行うための鉗子操作部と、前記留置具の前記フック係合部が係合可能なフックを操作するためのフック操作部と、前記鉗子操作部及び前記フック操作部を同軸上にそれぞれがスライド自在に配置させる操作本体と、を含む。 50

【 0 0 1 5 】

請求項 12 に係る発明は、請求項 11 に記載の内視鏡用処置具であって、前記フック操

作部は、前記鉗子操作部よりも挿入方向で先端側に配置され、前記フック操作部は挿入方向の基端側に向けて延びる複数の指掛け部を有し、前記指掛け部の間に前記鉗子操作部が進入可能である。

【 0 0 1 6 】

請求項 1 3 に係る発明は、請求項 1 1 に記載の内視鏡用処置具であって、糸状部材の一端側に取り付けられた先端部材と、他端側に設けられたフック係合部と、前記糸状部材の一端から他端に至るまでの間に設けられ、前記先端部材と係合可能なケーシングと、前記ケーシングに設けられ、前記糸状部材の一端から他端の間で前記ケーシングが移動することを抑制する係止部材とを有する留置具をさらに含む。

【 0 0 1 7 】

請求項 1 4 に係る発明は、請求項 1 3 に記載の内視鏡用処置具であって、前記処置部は、前記先端部材が着脱自在に装着される、前記鉗子部材に設けられた装着部と、前記ケーシングを着脱自在に保持する、前記先端保持部に設けられたケーシング保持部と、をさらに備え、前記先端解除部材は、前記鉗子部材の閉動作に伴い、前記先端部材が前記ケーシングに係合しうる状態になったときには、前記先端係止部材による前記先端カバーと前記先端保持部との係合を解除する。

【 0 0 1 8 】

請求項 1 5 に係る発明は、請求項 1 4 に記載の内視鏡用処置具であって、前記ケーシング保持部に前記ケーシングを係合させるケーシング係止部材と、前記前記先端カバーに設けられ、前記ケーシング係止部材による前記ケーシング保持部と前記ケーシングとの係合状態を制御するガイド部と、をさらに含む。

【 0 0 1 9 】

請求項 1 6 に係る発明は、請求項 1 3 に記載の内視鏡用処置具であって、前記挿入部は、前記鉗子部材を開閉操作するための第 1 のワイヤを前記先端方向及び前記基端方向に進退自在に挿通した第 1 のシースと、先端に前記留置具のフック係合部に係合可能なフックが接続される第 2 のワイヤを前記先端方向及び前記基端方向に進退自在に挿通した第 2 のシースと、前記第 1 のシースと前記第 2 のシースとを束ねる第 1 のホルダと、前記第 1 のシースと前記第 2 のシースとを束ね、前記第 1 のホルダよりも前記先端側に設けられた第 2 のホルダと、前記第 1 のホルダに対して前記第 2 のシースに摺動抵抗を付与する第 1 の調整部材と、前記第 2 のホルダに対して前記第 1 のシースに、前記第 1 の調整部材よりも大きい摺動抵抗を付与する第 2 に調整部材と、を含む。

【 0 0 2 0 】

請求項 1 7 に係る発明は、請求項 1 に記載の内視鏡用処置具において、前記操作部は、前記鉗子部材の前記開閉操作を行うための鉗子操作部と、前記留置具の前記フック係合部が係合可能なフックを操作するためのフック操作部と、前記鉗子操作部及び前記フック操作部を同軸上にそれぞれがスライド自在に配置させる操作本体と、を含む内視鏡用処置具。

【 0 0 2 1 】

請求項 1 8 に係る発明は、体内に挿入される挿入部の先端に設けられ、少なくとも一方が他方に対して開閉自在に枢支された一対の鉗子部材の閉動作に伴って、前記一対の鉗子部材の一方に着脱自在に装着される先端部材を組織に通した後に収容し、前記先端部材と糸で繋がれているケーシングを保持するケーシング保持部と、前記ケーシング保持部と、前記ケーシングとを係合させるケーシング係止部材と、前記先端カバーに設けられ、前記ケーシング係止部材による前記ケーシング保持部と前記ケーシングとの係合状態を制御するガイド部材と、を含む内視鏡用処置具とした。

【 0 0 2 2 】

請求項 1 9 に係る発明は、一対の鉗子部材と、前記一対の鉗子部材の少なくとも一方を他方に対して開閉自在に枢支する枢支軸が支持された先端カバーと、内視鏡の生体内に挿入される先端部分の側部を着脱自在に保持する受け部と、前記受け部に対して内視鏡先端の突出量を規制するために、前記内視鏡の先端位置を前記先端カバーとの相対的な位置で

10

20

30

40

50

規定する規定部材と、を含む内視鏡用処置具とした。

【0023】

請求項20に係る発明は、先端側に処置を行うための処置部が接続され、基端側に前記処置部を操作する操作部が接続された第1のシース及び第2のシースと、前記第1のシース及び前記第2のシースを束ねる第1のホルダと、前記第1のシース及び前記第2のシースを束ね、前記第1のホルダよりも前記先端側に設けられた第2のホルダと、前記第1のホルダに対して前記第2のシースに摺動抵抗を付与する第1の調整部材と、前記第2のホルダに対して前記第1のシースに、前記第1の調整部材よりも大きい摺動抵抗を付与する第2に調整部材と、を含む。

【0024】

請求項21に係る発明は、請求項20に記載の内視鏡用処置具であって、前記第1のシースには前記処置部を動作させるための第1のワイヤが挿通され、前記第2のシースには前記処置部を動作させるための第2のワイヤが挿通される。

【0025】

請求項22に係る発明は、請求項21に記載の内視鏡用処置具であって、前記第1のワイヤは、前記処置部に設けられた一対の鉗子部材の少なくとも一方を他方に対して開閉させる鉗子操作ワイヤである。

【0026】

請求項23に係る発明は、請求項20に記載の内視鏡用処置具であって、前記操作部は、前記鉗子部材を開閉操作する鉗子操作部と、前記縫合糸を締め付けるフックを操作するフック操作部と、前記鉗子操作部及び前記フック操作部とを同軸上にスライド自在に配置させる操作本体と、を含む。

【0027】

請求項24に係る発明は、請求項23に記載の内視鏡用処置具であって、前記フック操作部は、前記鉗子操作部よりも挿入方向で先端側に配置され、前記フック操作部は挿入方向の基端側に向けて延びる複数の指掛け部を有し、前記指掛け部の間に前記鉗子操作部が進入可能である。

【0028】

請求項25に係る発明は、一端と他端とを有する糸状部材と、前記糸状部材の一端側に接続される先端部材と、前記糸状部材に設けられる糸係止部材と、前記先端部材と前記糸係止部材とを収容する空間を有し、前記先端部材と係合する先端部材係止部材が内部に設けられたケーシングと、前記ケーシングに設けられ、前記先端部材係止部材による前記先端部材の係止を解除する装置を挿入可能な孔と、を備える留置具とした。

【0029】

請求項26に係る発明は、請求項1に記載の内視鏡用処置具であって、前記先端カバーは、前記先端保持部材に対して互いに離れる方向に押圧する弾性部材を含む。

【0030】

請求項27に係る発明は、請求項26に記載の内視鏡用処置具であって、前記弾性部材はバネである。

【0031】

請求項28に係る発明は、先端と基端とを備え、前記先端が体内に挿入される挿入部と、前記先端に設けられた処置部と、前記基端に設けられた操作部と、を備え、前記処置部は、前記操作部の操作によって進退する1つの入力部材と、前記入力部材に第一の接続部を介して切り離し可能に接続される第一のリンクと、前記第一のリンクによって開閉動作可能な第一の鉗子部材と、前記入力部材に第二の接続部を介して切り離し可能に接続される第二のリンクと、前記第二のリンクによって開閉動作可能で、前記第一の鉗子部材より開閉可能な角度が小さい第二の鉗子部材と、を備え、前記第一の接続部は、前記第二の鉗子部材を所定の開度まで開くまでの間は、前記入力部材と前記第一のリンクの接続を解除する内視鏡用処置具とした。

【0032】

10

20

30

40

50

請求項 29 に係る発明は、請求項 28 の内視鏡用処置具であって、前記第二の接続部は、全開させた前記第二の鉗子部材を閉じる動作中には、前記入力部材が所定長だけ駆動するまでの間、前記入力部材と前記第二のリンクを接続する。

【 0 0 3 3 】

請求項 30 に係る発明は、請求項 28 の内視鏡用処置具であって、前記第二の接続部は、前記第二の鉗子部材が全開したときに、前記入力部材と前記第二のリンクの接続を解除する。

【 0 0 3 4 】

請求項 31 に係る発明は、先端と基端とを備え、前記先端が体内に挿入される挿入部と、前記先端に設けられた処置部と、前記基端に設けられた操作部と、を備え、前記処置部は、前記操作部の操作によって進退する 1 つの入力部材と、前記入力部材に第一の接続部を介して切り離し可能に接続される第一のリンクと、前記第一のリンクによって開閉動作可能な第一の鉗子部材と、前記入力部材に第二の接続部を介して切り離し可能に接続される第二のリンクと、前記第二のリンクによって開閉動作可能で、前記第一の鉗子部材より開閉可能な角度が小さい第二の鉗子部材と、を備え、前記第二の接続部は、全開させた前記第二の鉗子部材を閉じる方向において、前記入力部材が所定長だけ駆動した後、前記入力部材と前記第二のリンクの接続を解除する内視鏡用処置具とした。

【 0 0 3 5 】

請求項 32 に係る発明は、先端と基端とを備え、前記先端が体内に挿入される挿入部と、前記先端に設けられた処置部と、前記基端に設けられた操作部と、を備え、前記処置部は、前記操作部の操作によって進退する 1 つの入力部材と、前記入力部材に第一の接続部を介して切り離し可能に接続される第一のリンクと、前記第一のリンクによって開閉動作可能な第一の鉗子部材と、前記入力部材に第二の接続部を介して切り離し可能に接続される第二のリンクと、前記第二のリンクによって開閉動作可能で、前記第一の鉗子部材より開閉可能な角度が小さい第二の鉗子部材と、を備え、前記第二の接続部は、前記第二の鉗子部材が全開したときに、前記入力部材と前記第二のリンクの接続を解除する内視鏡用処置具とした。

【 0 0 3 6 】

請求項 33 に係る発明は、請求項 28 、 31 、 32 の内視鏡用処置具であって、前記第一、第二の接続部は、前記入力部材を通す穴が 1 つ形成された板をそれぞれ複数有し、前記穴は前記板を前記入力部材の移動方向に対して傾斜配置したときに前記板と前記入力手段が係合する大きさで、前記板の傾きを制御することで前記第一、第二の接続部と前記入力部材との接続を断続させる。

【 0 0 3 7 】

請求項 34 に係る発明は、請求項 33 の内視鏡用処置具であって、複数の前記板は、異なる方向に斜めに付勢されている。

【 0 0 3 8 】

請求項 35 に係る発明は、先端と基端とを備え、前記先端が体内に挿入される挿入部と、前記先端に設けられた処置部と、前記基端に設けられた操作部と、を備え、前記処置部は、一対の鉗子部材と、前記一対の鉗子部材の少なくとも一方を他方に対して開閉自在に枢支する枢支軸が支持された先端カバーと、先端カバー内に収容され、前記鉗子部材に着脱自在に装着された針を受け入れ可能なケーシングを保持するケーシング保持部と、前記ケーシング保持部内に配置され、弾性変形により前記ケーシングに係合可能アームが設けられた支持部材と、を有し、前記ケーシング保持部は、先端開口側では前記ケーシングに前記アームを係止させるように前記アームを押圧して弾性変形させ、基端側では前記アームが復元して開き、前記ケーシングとの係合が解除される空間を有する。

【 0 0 3 9 】

請求項 36 に係る発明は、縫合器に装着される着脱針に、縫合糸を介して縫合糸を受け入れ可能なケーシングを連結したカートリッジを前記縫合器に装着するために用いられる装着装置であって、前記縫合器を受け入れ可能で、前記着脱針を支持する針保持部と、前

10

20

30

40

50

記ケーシングを収容し、前記縫合器から離れる方向に付勢されるホルダと、を有する装着装置とした。

【0040】

請求項37に係る発明は、請求項36に記載の装着装置であって、前記ホルダを付勢するバネを有し、前記ホルダは前記バネを引き伸ばした位置でストッパにより係止されており、前記縫合糸を巻き取るシリンドラから前記縫合糸が外れたときの回転を利用して前記ホルダのストッパを解除する。

【0041】

請求項38に係る発明は、請求項36に記載の装着装置であって、前記ホルダを付勢するバネを有し、前記バネを引き伸ばした位置でストッパにより係止されており、前記ストッパを収縮させるボタンを設けた。

【発明の効果】

【0042】

本発明に係る内視鏡用処置具によれば、着脱針の先端がケーシングに係合し得る状態になったときに先端保持部と先端カバーとの係合を解除できるようにすることで、鉗子部材を開じる動作に連動して着脱針をケーシング内に挿入させることができるので、操作性が向上する。

本発明に係る留置具では、手技の途中でも着脱針をケーシングから引き抜くことが可能になる。

本発明に係る装着装置では、フックからループが外れずに確実に装着できる。ゴム手袋をした状態でも簡単に操作できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0043】

実施態様について図面を参照して以下に詳細に説明する。以下の各実施態様で、同じ構成要素には同一の符号を付してある。また、実施態様の間で重複する説明は省略する。

【0044】

(第1の実施態様)

図1は内視鏡用処置具の一例としての縫合器を示している。縫合器1(アプリケータ)は、術者が操作する操作部2から長尺の挿入部3が延びている。挿入部3は、内視鏡4の内視鏡挿入部5と共にオーバーチューブ6内に挿入されている。挿入部3の先端は、オーバーチューブ6の先端から突出しており、ここに処置部7が取り付けられている。

【0045】

図2に示すように、操作部2は、硬質で挿入方向に延びる軸を有する細長の操作本体10を有する。操作本体10の先端部10Aからは、挿入部3が延びている。操作本体10の基端部には、指掛け用のリング11が取り付けられている。リング11よりも先端側には、操作本体10の長さ方向に沿ってスリット12が設けられており、ここにリング11側から順番に鉗子操作部13と、フック操作部14とがそれぞれ操作本体10の軸線方向に独立してスライド自在に取り付けられている。操作部2の材質としては、ABS(アクリロニトリル ブタジエン スチレン)樹脂、ポリカーボネート、ポリアセタール、ポリフェニルサルファン、ポリフタルアミド、ポリエーテルエーテルケトン、などがあげられる。操作部2をABS樹脂や、ポリカーボネートなどで製造すると安価に製造できる。ポリアセタールで製造すると摺動性が良くなるため、操作の際に必要とされる力量を低減することができる。また、ポリフェニルサルファン、ポリフタルアミド、ポリエーテルエーテルケトンで製造すると耐薬品性や耐熱性に優れるため消毒や滅菌による変性が少ない。

【0046】

鉗子操作部13には、鉗子操作ワイヤ(鉗子操作部材、第1のワイヤ)15が固定されている。鉗子操作ワイヤ15は、スリット12内を通って挿入部3内に導かれている。フック操作部14は、円筒14Aの側部から一対のハンドル16が基端に向けて延び、ハンドル16の基端部には指掛け用のリング17(指掛け部)が一体に形成されている。一対のハンドル16の間隔は、鉗子操作部13が進入可能に開いており、ハンドル16のリン

10

20

30

40

50

グ17を鉗子操作部13を超えて引くことで、フック操作部14のストロークが長くとれるようになっている。フック操作部14には、フック操作ワイヤ(フック操作部材、第2のワイヤ)18が固定されている。フック操作ワイヤ18は、スリット12内を通って挿入部3内に導かれている。なお、ハンドル16は、1つでも良いし、3つ以上でも良い。

【0047】

操作本体10、鉗子操作部13、及びフック操作部14は、樹脂成形品からなり、それぞれが一体成形された部材をスナップフィットで固定することで製造されている。すなわち、操作本体10は、展開形状の部材を折り曲げて、スナップフィットで固定して製造される。操作本体10の基端には、別に成形したリング11を嵌合させる。鉗子操作部13及びフック操作部14は、それぞれの展開形状の部材を操作本体10を覆うように折り曲げて、スナップフィットで固定する。

【0048】

図3に示すように、挿入部3は、操作部2の先端から延びるフックシース21と、鉗子シース22とを有する。フックシース21内には、フック操作ワイヤ18が進退自在に通されている。鉗子シース22内には、鉗子操作ワイヤ15が進退自在に通されている。

挿入部3には、その経路中に操作部2の一部をなす進退操作部25(第1のホルダ)と、スコープホルダ26(第2のホルダ)とが配置されており、進退操作部25とスコープホルダ26で、2つのシース21, 22を平行に束ねている。進退操作部25は、2つのシース21, 22を通す貫通孔30, 31が平行に形成されている。フックシース21の貫通孔30に先端が突出するように、第1の調整部材32が挿入されている。この実施態様では、第1の調整部材32にはネジを使用している。第1の調整部材32を締め込んでフックシース21に当接させることで、フックシース21の摺動抵抗が増大させられている。一方、鉗子シース22は、貫通孔31に挿入した状態で進退操作部25に固定されている。

【0049】

スコープホルダ26は、2つのシース21, 22を通す貫通孔33, 34が平行に形成されたホルダ本体35を有し、ホルダ本体35から内視鏡4の内視鏡挿入部5を通す筒状の受け部36が一体に形成されている。スコープホルダ26には、貫通孔34が形成されている。貫通孔34には、鉗子シース22が進退自在に挿通されている。さらに、第2の調整部材37が鉗子シース22に当接するように配設されている。この実施態様で第2の調整部材37には、ネジを使用している。第2の調整部材37を締め込んで鉗子シース22に当接させることで、鉗子シース22の摺動抵抗が増大させられている。一方、フックシース21の貫通孔33には、このような調整部材は設けられておらず、進退自在に配されている。

【0050】

スコープホルダ26と進退操作部25の間に露出している両シース21, 22を掴むか、又は進退操作部25を前進させると、スコープホルダ26に対して両シース21, 22が前進する。スコープホルダ26に保持されている内視鏡4は動かないで、両シース21, 22の先端に取り付けられている処置部7を内視鏡4に対して前進させることができる。

【0051】

これに対して、フックシース21のみを前進させたいときには、フックシース21を掴んで前進させる。このとき、第1の調整部材32によって進退操作部25は動かない。これは、フックシース21の進退操作部25内での摺動抵抗が小さく、鉗子シース22のスコープホルダ26内での第2の調整部材37による摺動抵抗が大きいので、フックシース21が進退操作部25に対して滑るため、フックシース21のみが前進する。

このように、進退操作部25及びスコープホルダ26によって、両シース21, 22の前進と、フックシース21のみの前進とを使い分けることができる。術者の操作を助けるために、フックシース21と鉗子シース22の色を変える、又は片方のシース21, 22の表面に凹凸をつける、あるいはそれぞれのシース21, 22の外径を異ならせる、など

10

20

30

40

50

すると、操作中のシースをさらに確認し易くなる。

なお、第1、第2の調整部材32，37による摺動抵抗は、締め込み量で調整できる。第1、第2の調整部材32，37の他の形態としては、Oリングを使用し、Oリングの太さで摺動抵抗を変化させても良い。

【0052】

進退操作部25及びスコープホルダ26は、樹脂成形品からなり、それぞれが一体成形された部材をスナップフィットで固定して製造されている。すなわち、進退操作部25及びスコープホルダ26は、展開形状の部材の貫通孔30，31，33，34となる溝に各シース21，22を通し、第1の調整部材32，37を挿入した後に、展開形状の部材を折り曲げて、スナップフィットで固定する。

さらに、フックシース21がコイルシース41内に挿通されている。鉗子シース22は、コイルシース42内に挿通されている。スコープホルダ26から先は、2本のコイルシース41，42が延出する。コイルシース41，42は、金属の平板を密巻きした平コイルからなる。このことから、従来のようにチューブを使用した場合と比べて部品コストの低減と、組み立て工数の削減が図れる。なお、フックシース21，鉗子シース22の外表面は、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、FEPやPFAのようなフッ素樹脂、などの材質からなる熱収縮チューブで覆われている。ここで、低密度ポリエチレンの場合はコイルシース41，42との摺動抵抗を減らせる上に安価に作ることができる。また、高密度ポリエチレンの場合は、より摺動抵抗を減らすことができる。さらに、FEPやPFAのようなフッ素樹脂の場合は、摺動抵抗が少ない上に耐薬品性や、耐熱性に優れているため、消毒や滅菌による変性が少ない。いずれも摺動抵抗を減らすことでの小さな力で操作できるようになる。

【0053】

図1に示すように、挿入部3の途中には、2つのコイルシース41，42と内視鏡4の内視鏡挿入部5とを束ねると共に、オーバーチューブ6との間で気密構造を形成する弁体50が設けられている。弁体50の材質としては、シリコーンゴム、天然ゴム、イソプロピレンゴムなどがあげられ、コイルシース41，42に接着剤などを用いて固定されている。図4及び図5に示すように、弁体50は、各シース41，42用の貫通孔51，52と、内視鏡4用の貫通孔53が平行に設けられている。弁体50は、筒状の部材の両端面を斜めにカットしてテープ面54，55を形成してある。テープ面54，55によって、貫通孔52とは反対側の部分52Aの挿入方向の長さが短くなっている。さらに、弁体50の外周には、断面視で外形が略円弧の圧入部56が形成されている。また、内視鏡4用の貫通孔53の内周側にも同様の圧入部57が形成されている。この弁体50は、テープ面54，55を設けることでオーバーチューブ6に引っ掛かり難くなっている。さらに、圧入部56を設けることで、挿入方向で一箇所のみでオーバーチューブ6に接するようになるので、接触面積の低下に伴う摺動抵抗の低減が見込まれ、挿入が容易になる。同様に、圧入部57は、内視鏡挿入部5との接触面積を小さくするので、内視鏡挿入部5の挿入が容易になる。また、この部分55Aが肉厚になって剛性が高まっているので、弁体50の変形を抑えることができる。なお、各貫通孔51～53の開口部は、外径を広げるようテープ状になっており、コイルシース41，42や内視鏡挿入部5の挿入が容易になっている。

【0054】

次に、処置部7について説明する。

さらに、図6～図8に示すように挿入部3の先端側には、受け部60が固定されている。図8に示すように、受け部60は、内視鏡4の内視鏡挿入部5を挿入可能なC形状のベース部61を有する。ベース部61の一部が切り欠かされることで、内視鏡挿入部5と縫合器1とを合わせた外形が小さくなり、オーバーチューブ6を細径化することができる。また、受け部60とオーバーチューブ6の接触面積を小さくすることができる。これらのことから、オーバーチューブ6や、体腔への挿入が容易になる。ベース部61と内視鏡4の接続強度を確保するためにベース部61の内側に軟性部材62が貼り付けてある。軟性部

10

20

30

40

50

材 6 2 は、ベース部 6 1 が内視鏡 4 を傷付けないようにする機能も果たす。

【 0 0 5 5 】

さらに、図 6 及び図 7 に示すように、受け部 6 0 において、コイルシース 4 1 , 4 2 が引き込まれる側の基端部には、テープ部 6 3 が形成されている。テープ部 6 3 は、基端部に向けて受け部 6 0 の外径を減少させるようになっており、手技の際にオーバーチューブ 6 から引き出した処置部 7 を再びオーバーチューブ 6 内に収容するときには、テープ部 6 3 によってベース部 6 1 の外周が引っ掛からないようになる。

【 0 0 5 6 】

図 9 に示すように、受け部 6 0 内には、コイルシース 4 2 の先端部が外周に固定される筒状の孔 7 1 A が配置されている。また、孔 7 1 B には、先端保持部 7 1 が進退自在に配されている。先端保持部 7 1 は、コイルシース 4 2 の軸線に沿って延び、基端部に鉗子シース 2 2 が固定され、内部に鉗子操作ワイヤ 1 5 が通されている。

先端保持部 7 1 の先端部には、孔 7 2 とスリット 7 3 とが設けられている。孔 7 2 とスリット 7 3 とは、先端保持部 7 1 の一直線上に形成されており、スリット 7 3 の端部は、孔 7 2 よりも基端側に延びている。孔 7 2 には、第 1 の係止部材（先端係止部材）であるピン 7 5 が挿入されている。ピン 7 5 は、孔 7 2 に入った状態でその一部が先端保持部 7 1 内に突出している。ピン 7 5 は、付勢部材である板バネ 7 6 で先端保持部 7 1 の外周に取り付けられている。板バネ 7 6 は、ピン 7 5 を孔 7 2 に収める方向に付勢している。一方、スリット 7 3 には、細長の解除部材 7 7 が挿入されている。解除部材 7 7 は、レーザ溶接や接着剤などで先端保持部 7 1 に固定された第 2 の解除部材（鉗子解除部材）であり、細長の板状の部材の基端、かつ先端保持部 7 1 の中心軸方向が斜めにカットされている。

【 0 0 5 7 】

先端保持部 7 1 内には、先端開口側から先端カバー 8 0 の筒部 8 1 が挿入されている。先端カバー 8 0 は、先端保持部 7 1 の内径に略等しい外径を有する筒部 8 1 と、筒部 8 1 の先端に一体に形成されたカバー本体 8 2 を有する。筒部 8 1 の外側には、コイルバネ 8 3 が配置されており、先端保持部 7 1 の先端開口に固定されたブリッジ部 8 5 からカバー本体 8 2 を離すように付勢している。ブリッジ部 8 5 は、挿入方向に直交する方向に延びてあり、一端部に先端保持部 7 1 の先端が固定され、他端部に後述するケーシング支持部 8 6 の基端部が固定されている。

【 0 0 5 8 】

筒部 8 1 には、複数のスリット 9 1 , 9 2 , 9 3 が長さ方向に沿って形成されている。スリット 9 1 は、筒部 8 1 の軸線回りで先端保持部 7 1 の孔 7 2 の形成位置に合わせて形成されている。スリット 9 1 の幅は、ピン 7 5 が入ることはできない大きさであるが、スリット 9 1 の基端部 9 1 A だけは拡幅されており、ピン 7 5 の先端が進入可能になっている。また、スリット 9 2 は、軸線回りに先端保持部 7 1 のスリット 7 3 の形成位置に合わせて形成されている。スリット 9 2 の幅は、解除部材 7 7 が挿入可能な大きさである。スリット 9 2 の基端は、スリット 9 1 の基端部 9 1 A よりも基端側に延びている。

【 0 0 5 9 】

図 6 に示すように、スリット 9 3 は、他のスリット 9 1 , 9 2 を避ける位置に形成されている。このスリット 9 3 には、ブリッジ部 8 5 に固定されたピン 9 5 が挿入されており、筒部 8 1 のスライドガイドになっている。

【 0 0 6 0 】

図 9 に示すように、筒部 8 1 内には、開閉機構を構成するロッド 1 0 0 が進退自在に挿入されている。ロッド 1 0 0 の基端部には、鉗子操作ワイヤ 1 5 が固定されている。ロッド 1 0 0 の基端寄りの位置は、径方向に延びる凹部 1 0 1 が形成されており、ここに第 2 の係止部材（鉗子係止部材）であるボール 1 0 2 が挿入されている。ボール 1 0 2 は、コイルバネ 1 0 3 によって径方向外側に付勢されている。このボール 1 0 2 は、筒部 8 1 のスリット 9 2 の基端部に設けられた大径部 9 2 A には入り込めるが、大径部 9 2 A よりも先端側には入り込めない。

10

20

30

40

50

【0061】

さらに、ボール102の配設位置よりも先端側で、軸線回りに180°回転した位置には、第1の解除部材(先端解除部材)である解除部材105が取り付けられている。解除部材105は、回転軸回りでボール102と一致する位置に突出している。解除部材105の基端部は、ピン75が乗り上げ易いようにテープ面を有する。

ロッド100の先端には、ピン110を介して2つのリンク部材111, 112のそれぞれの一端部が回動自在に取り付けられている。リンク部材111の他端部は、ピン113で鉗子部材115の一端部115Aに回転自在に取り付けられている。鉗子部材115は、一端部115Aから他端部115Bに至るまでの間に屈曲部115Cを有し、この屈曲部115Cがピン116(枢支軸)で先端カバー80に回転自在に枢支されている。鉗子部材115の他端部115Bには、曲針120(装着部)が固定されている。曲針120の先端部には、着脱針121が着脱自在に取り付けられている。着脱針121は、鋭利な先端から縮径した括れ部122を経た後に、曲針120に嵌合する基端部123が形成されている。基端部123には、縫合糸125の一端部が引き込まれて固定されている。括れ部122は、着脱針121に形成した凹部を4方向からカシメて、内部に挿入した縫合糸125を固定する際に形成される。このような構成では、従来のように縫合糸の結び目を利用して縫合糸を着脱針に固定する場合に比べて、着脱針の外径を小さくすることができる。なお、縫合糸125は、曲針120のスリット120Aを通して引き出されている。

【0062】

一方、他方のリンク部材112の他端部は、ピン130で中間部材131Aの基端側と回転自在に連結されている。中間部材131Aの先端側はピン132で先端カバー80に回転自在に支持されている。また、鉗子部材131は、基端側で先端カバー80とピン132(枢支軸)で回転自在に枢支されている。鉗子部材131の先端部131Bは、開口部133を有する環状になっており、先端に向けて湾曲している。最も先端に位置する部分には、組織に刺入される針134が固定されている。

図10に示すように、一対の鉗子部材115, 131を開いたときに、曲針120に取り付けられた着脱針121の先端と、鉗子部材131の針134の先端とは、挿入方向で同じ位置に配置される。各針121, 134が略同時に組織に刺入されるようになるので、針121, 134が組織から外れ難くなり、確実に穿刺することが可能になる。また、組織に深く針121, 134を刺入できるようになる。

【0063】

ここで、図6に示すように、鉗子部材131において、先端カバー80にピン132で支持される部分131Cは、先端カバー80の外側に配置されている。先端カバー80は、凹部80Bが形成されており、凹部80Bに鉗子部材131の部分131Cがピン132で支持されている。図7に示すように、鉗子部材131の部分131Cと先端カバー80との境界に大きな段差がなくなるので、体腔内への挿入が容易になり、操作性が向上する。

また、鉗子部材131が先端カバー80の外側で支持されることで、先端カバー80内に、鉗子部材131が確実に閉じるように付勢するチャージ用バネを設置するスペースが確保される。図7及び図9に示すように、チャージ用バネ140は、ピン132に遊びをもってコイル状に巻かれており、一対の鉗子部材115, 131を開じたときに一端部140Aが中間部材131Aの基端部に当接する。チャージ用バネ140の他方の端部140Bは、鉗子部材131の部分131Cに当接する。このチャージ用バネ140は、鉗子部材115, 131を開じたときに鉗子部材131の先端部131Bを完全に閉じるように付勢する。

【0064】

ここで、チャージ用バネ140は、コイル状に巻かれているので、端部140A, 140B同士は、幅方向に異なる位置に延びている。図11に示すように、一端部140Aは外側に配置され、他端部140Bは中心寄りに配置される。なお、この図は鉗子部材11

10

20

30

40

50

5, 131を開いたときを示し、チャージ用バネ140は機能していない。中間部材131Aの他端部112Aは、チャージ用バネ140の一端部140Aを当接できるように幅方向で外側に膨出している。これに対して、中間部材131Aの他端部112Aの内側は、切り欠かれており、幅方向に異形になっている。中間部材131Aの他端部112Aをこのように構成することで、ケーシング150を進退させたときに中間部材131Aとの干渉を防ぐことができる。さらに、ケーシング150を回避する構成において、異形構造を作ることで充分な剛性が得られる。

【0065】

なお、図6に示すように、一対の鉗子部材115, 131のそれぞれには、鉗子部材115, 131を完全に閉じたときに先端カバー80の先端面80Aに当接する突起状のストップ151, 152が設けられている。ストップ151, 152を当接させることで、鉗子部材115, 131を閉じたときに鉗子部材115が撓まなくなって着脱針121の軸線がずれ難くなる。

【0066】

次に、図9に示すように、縫合糸125の他端部が引き込まれるケーシング150と、ケーシング150を支持するケーシング支持部86について説明する。

図12及び図13に示すように、ケーシング150は、縫合糸(糸状部材)125と着脱針(先端部材)121と共に、体内に留置されるカートリッジ(あるいは留置具とも称する)153を形成する。

ケーシング150は、筒状の部材161, 162を組み合わせて構成されており、着脱針121を挿入可能な収容孔163が形成されている。収容孔163の先端側は、テープ面163Aになっており収容孔163の軸線と着脱針121の軸線とを一致させ易くなっている。さらに、収容孔163内には、着脱針121の抜け止め用の針係止部材(先端部材係止部材)である線バネ165が挿入されている。線バネ165は、棒材をU字状に折り曲げて、両端部166を同じ方向に平行になるように90度折り曲げた構成を有する。線バネ165の端部166は、収容孔163の幅を減少させるように配置される。初期状態では、線バネ165の端部166は、収容孔163の幅を拡幅させた溝167に収まっている。着脱針121が収容孔163に進入したときには、端部166同士を押し広げることができ。図13に示すように、着脱針121が収容孔163に収容されると、着脱針121の基端部123は、ケーシング150内に完全に収容されるので、着脱針121の基端部123で組織を痛めることはない。

【0067】

なお、ケーシング150の材質としては、ポリフェニルサルファン、ポリタルアミド、ポリエーテルエーテルケトン、チタン合金、純チタン、などがあげられる。ケーシング150をポリフェニルサルファン、ポリタルアミド、ポリエーテルエーテルケトンのような材質から製造すると、耐薬品性、耐酸性に優れていることから生体内で変性し難い。さらに、溶着性に優れることから超音波溶着やレーザ溶着を利用して組み立てることができる。また、純チタンやチタン合金は、生体適合性に優れる。

【0068】

着脱針121がケーシング150に収容されると、線バネ165が着脱針121の括れ部122を挟み込む。なお、着脱針121をケーシング150から引き抜こうとすると、線バネ165も一緒にスライド移動し、端部166が先端側の幅の狭い部分168(図12参照)に入り込む。ここでは端部166を開くことができないので、線バネ165がストップになつて着脱針121の抜け落ちを防止する。なお、着脱針121をケーシング150から取り出したいときには、図13に示すようにケーシング150の側部に開口する解除穴170に解除装置を挿入し、線バネ165を矢印に示すように基端側に戻せば良い。端部166が溝167まで戻って、端部166同士を押し開くことが可能になる。したがって、線バネ165の位置を固定した状態で、着脱針121を引っ張れば、ケーシング150から引き抜ける。

【0069】

10

20

30

40

50

解除装置としては、例えば、図14に示すように、鉗子180の鉗子部材181に解除ピン182を設けた構成があげられる。術者が手元側の操作で解除ピン182を解除穴170に挿入すると、手技の途中でも着脱針121をケーシング150から引き抜くことが可能になる。なお、解除装置の形態は、図示したものに限定されず、解除穴170に挿入できて、線バネ165を基端側へ移動できる形状であれば何でも良い。

【0070】

図12及び図15に示すように、ケーシング150に引き込まれた縫合糸125は、収容孔163の途中で、着脱針121が進入する領域よりも基端側から収容孔163に引き込まれる。収容孔163の基端側は、ケーシング150の基端面に開口する大径の孔190に連通している。この孔190の内には、ブレーキ部(糸係止部材)191が配設されている。ブレーキ部191は、縫合糸125を通した弾性部材192の周囲に金属製の板材193を巻いてから潰した扁平形状を有し、縫合糸125との間で所定の摺動抵抗を発生させる。ケーシング150には、径方向に貫通するスリット194が設けられており、スリット194にブレーキ部191を緩く嵌合させている。さらに、孔190とスリット194とが形成する段差195がブレーキ部191のストップになるので、ブレーキ部191が縫合糸125の長さ方向に引っ張られても、ケーシング150からブレーキ部191が飛び出すことはない。ブレーキ部191によって、縫合糸125の一端から他端の間でケーシング150が移動する際に所定の摺動抵抗を発生させることが可能になり、ケーシング150の移動が抑制される。

【0071】

ここで、ケーシング150の基端面から引き出された縫合糸125の端部は、ループ200(フック係合部)を形成している。ループ200の形成には、二重引け解け結び201を使用している。二重引け解け結び201は、結び目を小さくできるのでフックシース21の内径が小さい場合でもフックシース21内に挿入し易い。

【0072】

図10に示すように、ケーシング150は、ケーシング支持部86内に収容されている。ケーシング150の側部に形成された環状の凹部202のそれぞれにケーシング支持部86の孔203を通して挿入されるボール(第3係止部材、ケーシング係止部材)205が係止されている。ボール205は、ケーシング支持部86に固定された付勢部材である板バネ206によってケーシング150に係止するように付勢されている。また、ボール205と板バネ206は、レーザ溶接や接着剤などで一体化しても良い。なお、ケーシング支持部86の先端は、先端カバー80のガイド部であるガイド孔210に進退自在に挿入されている。ガイド孔210は、基端部が拡径されている。図9に示すように拡径された部分210Aでは、ボール205を径方向外側に移動させることができる。拡径された部分210Aよりも先端部分210Bでは、ガイド孔210の径が狭くなっているため、ボール205を径方向外側に移動させることはできない。

【0073】

ケーシング支持部86内では、ケーシング150の孔190にフックシース21に取り付けられた先端爪部211が嵌入されている。先端爪部211は、ケーシング支持部86の内周に形成された段差86Aに先端側から当接してストップとなるフランジ211Aを有し、貫通孔内にフック212が収容されている。フック212は、フックシース21内に進退自在に通されたフック操作ワイヤ18の先端部に固定されている。フック212には、縫合糸125の他端部側のループ200(図12参照)が引っ掛けられる。従来では、フックシース21とケーシング支持部86との間に、内側チューブを設けていたが、この実施態様では内側チューブを無くすることで装置構成を簡略化している。これによって、部品コストの低減と、組立工数の削減が図れる。

【0074】

ここで、図7に示すように処置部7の先端カバー80の側部には、内視鏡4の挿入方向における位置決めをする規制部として、目印220が設けられている。目印220に内視鏡4の先端部を合わせると、内視鏡4の先端の硬質部分と、処置部7の硬質部分とを挿入

10

20

30

40

50

方向で重ねることができる。従来では、受け部 60 に内視鏡 4 の先端部を位置決めしていたので、全体としての硬質の長さは、処置部 7 の長さと、内視鏡 4 の硬質部の長さとを足したものになっており、オーバーチューブ 6 への挿入や、生体内への挿入性が悪かった。この実施態様では、硬質部分の長さが短くなるので、挿入性が向上する。また、内視鏡 4 が先端寄りに配置されるので、内視鏡 4 の観察装置の視野を先端カバー 80 などが邪魔しないようになり、視野を確保できる。目印 220 の代わりの規定部材として、破線で示すように内視鏡 4 の先端面に突き当てる板部材 221 を先端カバー 80 から突出させても良い。さらに、図 8 に示すように、先端カバー 80 の隅部を斜めにカットして傾斜面 225 を形成している。この傾斜面 225 を形成することで、仮想線で示すオーバーチューブ 6 の内径に縫合器 1 が收まり、進退操作が容易になる。

10

【0075】

次に、この実施形態の作用について説明する。なお、以下においては、胃壁に形成された開口を縫合する場合を説明するが、ターゲット部位は、これに限定されず例えば、食道、十二指腸、小腸、大腸、子宮、膀胱などの管腔器官でも良い。また、内視鏡 4 を挿入する自然開口は、口に限定されずに鼻や肛門でも良い。さらに、止血や潰瘍による穿孔部、粘膜欠損部の縫縮などの治療に用いても良い。

【0076】

内視鏡 4 の内視鏡挿入部 5 をスコープホルダ 26、弁体 50、受け部 60 に順番に通し、内視鏡 4 の先端面を目印 220 に合わせる。内視鏡 4 を縫合器 1 にしっかりと固定するために、内視鏡 4 の先端と受け部 60 とをテープ等で固定しても良い。次に、カートリッジ 153 を縫合器 1 の所望位置にセットする。別の内視鏡でオーバーチューブ 6 を患者の口から噴門付近あるいは胃内まで挿入する。次に、オーバーチューブ 6 を介して内視鏡 4 に固定された縫合器 1 を胃内に挿入する。

20

胃内では、ターゲット部位である組織の開口の位置を内視鏡 4 の観察装置で確認する。内視鏡 4 の先端部は、従来のタイプに比べて縫合器の先端側に配置されているので、視野が縫合器 1 に妨げられ難く、組織の開口と着脱針 121 と同じ視野内に納めることができる。

【0077】

次に、縫合に先立って胃内で鉗子部材 115, 131 を開く。具体的には、術者は、操作部 2 の鉗子操作部 13 を前進させる。鉗子操作ワイヤ 15 が前進してロッド 100 に連結されたリンク部材 111, 112 が鉗子部材 115, 131 をピン 106, 132 回りに回転させて開かせる。図 16 に示すように、開いた鉗子部材 115, 131 をターゲット部位である開口 SO に近接させたら、鉗子部材 115, 131 で開口 SO の周囲の組織を挟み込むようにして鉗子部材 115, 131 を閉じる。

30

術者が操作部 2 の鉗子操作部 13 を後退させると、鉗子操作ワイヤ 15 が後退してリンク部材 111, 112 が先端カバー 80 内に引き込まれ、鉗子部材 115, 131 がピン 106, 132 回りに回動して閉じる。鉗子部材 131 の針 134 が組織に刺入され、組織を開口 SO 側に押し付ける。一方、鉗子部材 115 の曲針 120 は、開口 SO を挟んで鉗子部材 131 側とは反対側の組織内に刺入され、開口 SO を横断して鉗子部材 131 に手繩り寄せられた組織を通ってケーシング 150 側に突き出る。その結果、図 17 に示すように、開口 SO に曲針 120 及び縫合糸 125 が通される。

40

【0078】

ここで、開口 SO が比較的大きく、1 度の縫合で開口 SO を挟むことができない場合は、開口 SO の一端を最初に穿刺し、曲針 120 を略半分程度開いて着脱針 121 と針 134 との間に空間を作り、その空間に開口 SO の他端の組織を取り込んで穿刺して縫合を行っても良い。

【0079】

また、このとき、組織が硬かったりすると着脱針 121 が組織を貫通し難く、鉗子操作部 13 に大きい力が加わって着脱針 121 が組織から貫通した位置で鉗子操作部 13 を止めることができず、着脱針 121 をケーシング 150 に係合させる位置まで一連の動作と

50

して実行されてしまうことがある。この場合には、前述のように2回穿刺して縫合することができなくなる。前記のような2回穿刺を確実に実行するためには、操作部2を図18に示すような構成にすると良い。この操作部2は、操作本体10の基端部にスリット12に連通する孔401が設けられており、ここにリング11の先端に延設されたカムロッド402が挿入されている。孔401の先端には、突き当部403が開口径を減少させるように設けられている。孔401の内周部には螺旋状のカム溝405が形成されている。カム溝405は、周方向に少なくとも半周(180°)以上延びている。カムロッド402からは、先端に突き当部403を通過可能なロッド406がさらに延びている。ロッド406は、スリット12内に入り込んでおり、先端にストッパ407が鉗子操作部13に当接可能に設けられている。さらに、カムロッド402の外周には、1つのピン408が径方向外側に向けて延設されている。ピン408は、カム溝405に挿入されており、ピン408を介してリング11が操作本体10に係合されている。

【0080】

この操作部2では、ストッパ407に当接するまで鉗子操作部13を引くことができる。図18に示す位置からリング11を180°回転させると、リング11と共に回転するピン408の回転運動がカム溝405によってリング11の直線運動に変換されて、リング11が後退する。リング11に一体に設けられているストッパ407が例えば移動量Xだけ後退する。ストッパ407が後退することで鉗子操作部13は、移動量Xだけさらに後退できるようになる。このときの位置を着脱針121がケーシング150に係合するまで先端カバー80が移動する位置に設定しておき、最初のストッパ407の位置を2回穿刺の一回目の位置に設定しておくと、2回穿刺を確実にできるようになる。

【0081】

また、別の態様を図19に示す。図19に示すように、操作本体10のスリット12の内面に、スリット12内側に隆起するように障害レール410が長さ方向に沿って所定長さで設けられている。このスリット12にスライド自在に鉗子操作部411が進退自在に取り付けられている。鉗子操作部411は、鉗子部材115, 131を開閉させるスライダである。図20に示すように、内部にはスライド方向に直交する孔412が設けられており、孔412にはストッパ部材413が挿入されている。ストッパ部材413は、弾性部材であるコイルバネ414で孔412に縮径された開口に向けて付勢されており、その先端部が鉗子操作部411から突出してストッパ解除ボタン415になっている。さらに、ストッパ部材413は、側部に切り欠き416が設けられている。図21に示すように、切り欠き416は、障害レール410に比べて十分に大きいが、自然状態では切り欠き416の位置と障害レール410の位置とは一致していない。このため、鉗子操作部411は、障害レール410にストッパ部材413が当たるまでしか後退できない。図22に示すように、ストッパ解除ボタン415を押し込むと、コイルバネ414が収縮する分だけストッパ部材413が移動し、切り欠き416の位置と障害レール410の位置が一致する。切り欠き416で障害レール410を回避できるようになるので、鉗子操作部411をリング11に向けてさらに後退させることが可能になる。このように、操作者は、ストッパ部材413の先端のストッパ解除ボタン415を押すことで鉗子操作部411の移動量を制御することが可能になるので、2回穿刺を確実にできるようになる。

【0082】

開口S0に曲針120及び縫合糸125が通されたら、チャージ用バネ140の付勢力で鉗子部材131が閉方向に付勢され、針134が組織にしっかりと噛み込む。さらに、鉗子部材115, 131のストッパ151, 152が先端カバー80の先端面80Aに突き当たって、鉗子部材115, 131の撓みが防止されて着脱針121の軸線と、ケーシング150の軸線とが略一致する。

【0083】

ここで、鉗子部材115, 131が完全に閉じたときに、又は完全に閉じる直前に、先端カバー80の筒部81内に引き込まれたロッド100の解除部材105のテープ面がピン75を押し上げる。ピン75が押し上げられると、筒部81と、先端保持部71との係

合が解除される。その結果、先端保持部 71 に対して先端カバー 80 が引き込み可能になる。したがって、図 23 に示すように、鉗子操作ワイヤ 15 をさらに後退させると、先端カバー 80 がコイルバネ 83 を圧縮しながら後退し、先端カバー 80 にピン 116, 132 及びストッパー 151, 152 で連結された鉗子部材 115, 131 が後退する。なお、このとき、筒部 81 のボール 102 は、解除部材 77 を越えて、大径部 92A に入り込み、筒部 81 とロッド 100 とが連結される。

【0084】

これに対して、ケーシング 150 は、ケーシング支持部 86 に保持されており、移動しない。しかも、先端カバー 80 が後退することで、ケーシング 150 に係合させているボール 205 の外周をガイド孔 210 の小径な部分 210B が覆うのでボール 205 は径方向外側に移動できなくなる。その結果、ケーシング 150 が移動が防止された状態で、曲針 120 の先端に装着されている着脱針 121 がケーシング 150 内に挿入される。収容孔 163 内では、線バネ 165 によって着脱針 121 がケーシング 150 に係止される。

鉗子操作ワイヤ 15 を引ききつたら、鉗子操作部 13 を前進させる。先端カバー 80 は、筒部 81 の外側に設けられたコイルバネ 83 の復元力で元の位置に移動を開始する。このとき、スリット 92 の大径部 92A に入り込んだボール 102 で筒部 81 とロッド 100 とが連結されているので、先端カバー 80 とロッド 100 とが一体的に前進する。したがって、鉗子部材 115, 131 が開くことなく前進し、鉗子部材 115 に装着されている曲針 120 がケーシング 150 から離れるように平行移動する。

【0085】

この平行移動より曲針 120 から着脱針 121 が外れる。図 24 に示すように、着脱針 121 は、ケーシング 150 に収容されたままで留まり、曲針 120 がケーシング 150 から離れる。このとき、鉗子部材 115, 131 はまだ開いていないので、曲針 120 とケーシング 150 とが干渉することはない。その後、先端カバー 80 の筒部 81 と共に前進するボール 102 は、解除部材 77 に当接し、解除部材 77 の基端のテープ面によってロッド 100 内に押し込まれる。これによって、ロッド 100 と筒部 81 との係合が解除され、先端カバー 80 に対してロッド 100 を前進できるようになる。その結果、鉗子操作部 13 を前進させると、鉗子部材 115, 131 を開けるようになる。図 25 に示すように、鉗子部材 115, 131 が開かれることで、曲針 120 が組織から引き抜かれる。縫合糸 125 は、組織を貫通した状態でループ状に残る。

【0086】

縫合糸 125 を締め付けるときには、フックシース 21 を前進させる。フックシース 21 が先端爪部 211 を押し、先端爪部 211 がケーシング 150 を先端カバー 80 から組織に向けて押し出す。先端カバー 80 は、元の位置に戻っているので、ボール 205 の周囲にはガイド孔 210 の拡径された部分 210A があり、板バネ 206 が弾性変形してボール 205 が凹部 202 から外れて、ケーシング 150 とケーシング支持部 86 との係合が解除される。ケーシング 150 をケーシング支持部 86 から突出させたら、フック操作部 14 を後退させて、フック 212 を後退させる。フック 212 に係合させてある縫合糸 125 が引っ張られるので、組織を貫通する縫合糸 125 のループが絞られる。フック操作部 14 のハンドル 16 は、鉗子操作部 13 を越えて引くことができるので、ケーシング 150 を組織に当接させるまで縫合糸 125 を引っ張ることができる。その結果、図 26 に示すように、カートリッジ 153 で開口 S0 が縫合される。フック 212 の係合を解除したり、ケーシング 150 から延出した縫合糸 125 を内視鏡 4 の作業用チャンネルに通した公知の糸切用処置具で切断することで、カートリッジ 153 が開口 S0 を縫合した状態で体内に留置される。

【0087】

この実施態様では、第一係止部材であるピン 75 を設けることで鉗子操作ワイヤ 15 を後退させる過程で先端保持部 71 と先端カバー 80 との係合を解除できるように構成したので、鉗子操作ワイヤ 15 を引いて鉗子部材 115, 131 を閉じる動作に連動して着脱針 121 をケーシング 150 内に挿入させることができる。従来の操作部は構造が複雑で

10

20

30

40

50

あり、操作に熟練を要したが、この実施態様では、鉗子操作部 13 の一連の動作で着脱針 121 の係合までができるようになるので、操作が簡単になる。即ち、例えば、U S 2 0 0 3 - 0 1 8 1 9 2 4 A 1 に記載された処置具の場合、着脱針をケーシングに係合させるためにケーシングを保持するフックシースの進退操作が必要で、そのためには操作部を持ち替える必要があった。また、着脱針がケーシングに係合するためには、着脱針とケーシングの長手方向中心軸を一致させる必要があり、術者が術中に確認しなければならなかつた。これに対して、この実施態様では、着脱針 121 の先端がケーシング 150 に係合し得る状態になったときに先端保持部 71 と先端カバー 80 との係合を解除できるようにすることで、鉗子部材 115, 131 を閉じる動作に連動して着脱針 121 をケーシング 150 内に挿入させることができるために、操作性が向上する。

10

【0088】

また、処置具の一例として、この実施態様では、縫合器を開示したが、これに限定されずに鉗子部材 115, 131 の形状が異なる生検鉗子や把持鉗子などに応用することも可能である。生検鉗子に応用する場合には、手元側の操作で組織を掴む操作と組織を引きちぎる操作とを一連の動作して実施することが可能になる。また、把持鉗子に応用する場合には、手元側の操作で組織を掴む操作と組織を移動させる動作とを一連の動作として実施することが可能になる。

【0089】

第二の係止部材であるボール 102 を設けて鉗子部材 115, 131 が開く前に、鉗子部材 115, 131 のリンク機構と先端カバー 80 とを一体に前進させるように構成したので、曲針 120 がケーシング 150 から完全に離脱するまで鉗子部材 115, 131 を開かないようにできる。曲針 120 とケーシング 150 とが干渉しなくなるので、鉗子部材 115, 131 の開閉動作が確実になる。さらに、鉗子操作部 13 の一連の動作で曲針 120 からの着脱針 121 の取り外しと、鉗子部材 115, 131 を開く動作とができるようになるので、操作が簡単になる。

20

ケーシング 150 とケーシング支持部 86 と係合させるボール 205 を第三の係止部材として設け、先端カバー 80 のガイド孔 210 でボール 205 の係合を制御するようにしたので、ケーシング 150 を確実に固定でき、ケーシング 150 に着脱針 121 を係合させ易い。

【0090】

鉗子部材 115, 131 に先端カバー 80 の先端面 80A に当接するストップ 151, 152 を設けたので、鉗子部材 115, 131 を閉じたときに、曲針 120 の軸ずれを防止できる。曲針 120 の軸がずれるとケーシング 150 に着脱針 121 を挿入し難くなったり、曲針 120 から着脱針 121 を外し難くなったりするが、この実施態様では、このような課題が解決される。

30

【0091】

挿入部 3 の経路中に進退操作部 25 及びスコープホルダ 26 を設け、フックシース 21 のみ、又は両シース 21, 22 を同時に進退させるようにしたので、従来の操作部の構成に比べて操作が容易になる。術者が進退させるシースを観念し易くなり、操作を習熟し易くなる。また、進退操作部 25 は操作本体 10 から離れているので、操作を分担し易い。

40

操作部 2 は、鉗子部材 115, 131 の操作を行う操作部（鉗子操作部 13）と、フック 212 の操作をする操作部（フック操作部 14）とが一体に設けられているので、操作部をコンパクトにでき、取り扱いが容易になる。フック操作部 14 を先端側に配置し、ハンドル 16 の間に鉗子操作部 13 が入り込めるようにしたので、フック操作部 14 のストロークを大きくすることができ、縫合糸 125 の締め付けが楽になる。

【0092】

ここで、縫合器 1 の種々の変形例を示す。

図 27 に示すように、先端爪部 301 は、フックシース 21 の先端部が固定され、内部にフック操作ワイヤ 18 が引き込まれている。さらに、ケーシング支持部 86（先端部を径方向外側に少し開いてケーシング 150 を受け入れ可能にしてある）にも固定されてい

50

る。先端爪部 301 の先端には、爪部 302 が一体に形成されており、ケーシング 150 の基端部を係止可能である。この先端爪部 301 は、図 9 に示すような先端爪部 211 と、先端爪部 211 を受けるケーシング支持部 86 の段差 86A とを一体に成形したものであり、製造原価及び組み立て工数の削減が図れる。

【0093】

図 28 に示すように、先端保持部 71 と、ブリッジ部 85 と、ケーシング支持部 86 とを一体に成形した支持部材 310 を使用しても良い。支持部材 310 は、全体としてクラシック状に屈曲しており、先端保持部 71 と、ケーシング支持部 86 とを別体で構成する場合に比べて、部品のコストや、組み立てのコストを低減できる。なお、製造方法としては、金属射出成形、ターニングセンタ加工、モールディング、鋳造、鍛造が使用できる。

10

【0094】

図 29 に示すように、受け部 320 で、コイルシース 41 の先端部が固定されるアウター部材 321 に係合する部分に切り欠き部 322 を設けても良い。受け部 320 は、内視鏡 4 の先端部を縫合器 323 に固定するために用いられる。切り欠き部 322 によって、受け部 320 はアウター部材 321 を略 C 字の断面形状で保持する。切り欠き部 322 の位置は、内視鏡 4 と縫合器 323 を組み合わせてオーバーチューブ 6 に挿入したときに、オーバーチューブ 6 の内面に接触または近接する位置である。この位置で受け部 320 を切り欠くことで、内視鏡 4 と縫合器 323 を合わせた外径を減少させてオーバーチューブ 6 への挿入を容易することができる。なお、この縫合器 323 は、ケーシング 150 を係合させる先端爪部 301 をシース 326 によって進退させる構成を有する。先端爪部 301 は、先端カバー 80 及びこれと一体化されたケーシング保持部 325 の内部で進退動作する。

20

【0095】

図 30 に示すように、受け部 320 においてアウター部材 321 を保持する保持部 330 は、断面が C 字形になるように切り欠き部 322 を有すると共に、先端側に向けて開くようなテープ面 331 を設けてある。テープ面 331 は、コイルシース 42 の軸線 CL を中心軸とする曲面形状を有する。フックシース 21 と鉗子シース 22 を操作して先端カバー 80 を後退させると、ケーシング保持部 325 の基端部が受け部 320 に引っ掛からないようになるので、進退をスムーズに行えるようになる。

30

なお、第一係止部材は、図 9 に示す球形のピン 75 の代わりに、図 31 に示すように、略円柱形のピン 75A に変更しても良い。円柱形のピン 75A を使用すると、孔 72 との嵌合長が増えて第 1 の係止部材が操作中に外れ難くなる。第 1 の係止部材の係合が解除されるのに必要な力量が安定するので、組織を穿刺している途中で第一係止部材が外れなくなる。

【0096】

(第 2 の実施態様)

図 32 に第 2 の実施態様の縫合器を内視鏡と共にオーバーチューブに通した図を示す。内視鏡用処置具である縫合器 501 (アブリケータ) は、術者が操作する操作部 2 から長尺の挿入部 3 が伸びている。操作部 2 は、細長の操作本体 10 に鉗子操作部 13 と、フック操作部 14 とがそれぞれ独立してスライド自在に取り付けられている。

40

【0097】

図 2 の領域 L を拡大した断面図である図 33 に示すように、操作本体 10 の先端には、フック操作ワイヤ 18 及びフックシース 21 と、鉗子操作ワイヤ 15 及び鉗子シース 22 が挿入されている。

フックシース 21 には、シース固定パイプ 511 がロー付け固定されている。シース固定パイプ 511 の端部は、その一部が軸線からオフセットした平面でカットされ、断面視で D 形状になるような切り欠き 512, 513 が軸線方向に沿って 2ヶ所形成されている。切り欠き 512, 513 の間に残された部分 514 は、基端側の壁面が先端に向かって開くように傾斜している。部分 514 の先端側の壁面は、軸線に略垂直である。切り欠き 513 の先端側の壁面は、先端かつ径方向外側に向けて傾斜させており、シース固定パイ

50

プ511を挿入するときに引っ掛からないようにしてある。操作本体10の先端部は、シース固定パイプ511を挿入可能な孔515が形成されている。孔515は、シース固定パイプ511の端部が突き当たる壁部516を有し、この壁部516から先が断面観で略D字形の孔515Aになっている。この孔515Aの外形は、シース固定パイプ511の切り欠かれた部分の断面形状に略等しい。さらに、孔515Aより先端側には、弾性変形可能なフック517が孔515の周壁を利用して形成されている。フック517は、切り欠き513に係合可能に突出しているので、シース固定パイプ511は抜けない。

【0098】

シース固定パイプ511を操作本体10に挿入し、端部を壁部516に突き当てるとき、10
切り欠き512が略D字形の孔515Aに収まり、軸線回りの回転が規制される。これと同時に、切り欠き513には、フック517が挿入される。フック517は、シース固定パイプ511が引っ張れたとき、シース固定パイプ511の部分514の壁部に引っ掛かるので、フックシース21の抜けを防止する。なお、シース固定パイプ511は、操作本体10の先端から所定長だけ突出し、フックシース21の折れを防止する機能も有する。

フックシース21内に進退自在に通されたフック操作ワイヤ18は壁部516を越えて引き出され、Oリング518内を通った後に、フック操作部14に挿入される。

【0099】

図34と、図35に示すように、フック操作部14は、フック操作ワイヤ18が通る経路を越えて延びる一対の爪519を有し、爪519の間を通ってフック操作ワイヤ18が内部に挿入される。フック操作ワイヤ18の端部には、ワイヤ固定パイプ520がカシメ固定されている。ワイヤ固定パイプ520をフック操作部14に係止させることで、抜け止めされる。ワイヤ固定パイプ520は、フック操作部14の外周側から内部に向けて形成したスリット521内に配置されている。スリット521の長さは、ワイヤ固定パイプ520の長さに略等しく、スリット521の前後方向の壁部521A、521Bでワイヤ固定パイプ520の進退が規制される。

【0100】

さらに、スリット521には、係止帶523が挿入されている。係止帶523は、略U字形で、開放端側が開いている。係止帶523の湾曲した部分は、ワイヤ固定パイプ520の外周面でフック操作部14の中心側の側面に面接触し、ここからフック操作部14の外周に向かって延び、その端部がワイヤ固定パイプ520が通された位置より径方向外側においてフック操作部14に固定されている。これによって、ワイヤ固定パイプ520の径方向内側への移動が防止される。

【0101】

ワイヤ固定パイプ520の径方向外側への移動は、爪519のスリットの端部にフック操作ワイヤ18が係止されて規制される。このようにしてフック操作ワイヤ18をフック操作部14に固定したので、フック操作ワイヤ18の押し出し抵抗が大きくなつてフック操作ワイヤ18が変形してもフック操作部14から外れなくなる。

【0102】

図33に示すように、鉗子シース22の端部には、真鍮性のシース固定パイプ525がカシメ固定されている。シース固定パイプ525は、先端側の外周を拡径させて係止部525Aが形成されている。係止部525Aを操作本体10側に形成された溝526に挿入すると、鉗子シース22を操作本体10に係止できる。シース固定パイプ525は、鉗子シース22を係止部525A側から通し、基端側からカシメて固定する。係止部525Aが先端側に形成されているので、カシメ工具が入れ易くなる。また、シース固定パイプ525を真鍮で製造したのでステンレスに比べて切削加工が容易で、原価を低減できる。

図36に示すように、フックシース21と鉗子シース22は、進退操作部25とスコープホルダ26のそれぞれに順番に通されている。鉗子シース22は、進退操作部25に固定されている。フックシース21は、進退操作部25内に収容されたOリング530で摺動抵抗を増大させている。Oリング530の収容部531は、長さ方向に2つ形成されており、その一方のみにOリング530が収容されているが、両方の収容部531にOリン

10

20

30

30

40

50

グ530を収容しても良い。

【0103】

また、スコープホルダ26に通された鉗子シース22は、収容部532内のOリング530で摺動抵抗を増大させてある。収容部532は、長さ方向に2つ形成されており、その各々にOリング530が収容されているが、一方のみに収容しても良い。鉗子シース22は、進退操作部25内に収容される部分に、パイプ533がカシメ固定されている。パイプ533は、進退操作部25の溝に嵌合している。

【0104】

ここで、進退操作部25とスコープホルダ26の間に露出しているフックシース21を掴んで進退させると、フックシース21のブレーキとして機能するOリング530が1個なのに対し、鉗子シース22のブレーキとして機能するOリング530が2個であり、鉗子シース22の方が摺動抵抗が大きい。このため、フックシース21のみが移動し、鉗子シース22は移動しない。

2つのシース21, 22を同時に移動させたいときは、進退操作部25を掴んで進退させる。パイプ533で鉗子シース22と進退操作部25は係合しているので、スコープホルダ26内の2つのOリング530のブレーキ力に打ち勝つような進退力を与える。フックシース21は、進退操作部25内のOリング530の摺動抵抗によって進退操作部25と一緒に移動する。

【0105】

進退操作部25に摺動抵抗の調整部材として、Oリング530を使用することで、シース21, 22を進退させると適度なブレーキを安価に実現できる。シース21, 22との摺動抵抗が小さいOリングを使用する場合などには、Oリングを3つ以上使用しても良い。ブレーキ性能を確保しつつ、Oリングの耐久性を向上できる。また、Oリングの代わりに、シリコーンなどの樹脂製のチューブを使用しても良い。

なお、進退操作部25を前進させるときに鉗子シース22が曲がってフックシース21のみが前進しないように、鉗子シース22のコイルの素線径を太くして硬度を高めている。この場合に好適な鉗子シース22の硬度は、組織に縫合器501を押し付けたときに、鉗子シース22が座屈しない程度の硬さとする。

【0106】

また、スコープホルダ26を掴んでフックシース21を押し込むときに、フックシース21が撓まないように、フックシース21のコイルの素線径を太くしている。これによって、フックシース21をスムーズに押し込むことができる。さらに、フックシース21と、フック操作ワイヤ18の間のクリアランスを小さくし、フック操作ワイヤ18がフックシース21に摺動するようにした。フックシース21とフック操作ワイヤ18の間のクリアランスが大きいと、フック操作ワイヤ18がフックシース21内で撓んで蛇行することがある。この場合、フック操作ワイヤ18が蛇行した分だけフック操作部14の操作ストロークを大きくしなければならなくなる。これに対して、この縫合器501は、クリアランスを小さくしたのでストローク量が小さくなり、フック操作ワイヤ18の操作性が向上する。

【0107】

ここで、鉗子シース22とフックシース21は、決められた順番でスコープホルダ26に挿入されている。内視鏡4を左手で持ち、右手でフックシース21及び鉗子シース22を操作するときに、術者の右側にフックシース21が配置され、術者の左側に鉗子シース22が配置される。その結果、図37に示す内視鏡4の画像535で、右側にフック、左側に曲針120が配置されるようになる。術者の左右と画面上の左右が一致するので、術者が操作し易くなる。

【0108】

図36に示すように、フックシース21及び鉗子シース22は、スコープホルダ26内で、コイルシース41及びコイルシース42にそれぞれ挿入される。これらコイルシース41, 42は、平板を密巻きしたコイルからなる。スコープホルダ26には、これらコイ

10

20

30

40

50

ルシース 4 1 , 4 2 の抜け止めとして、係止部材 3 4 0 , 3 4 1 が嵌め込まれている。係止部材 5 4 0 , 5 4 1 は、スコープホルダ 2 6 側に設けられた凹部に嵌め込まれており、2つの突起 5 4 2 がコイルシース 4 1 , 4 2 の長さ方向に離間して設けられている。コイルシース 4 1 を挟んで配置される2つの係止部材 5 4 0 , 5 4 1 では、突起 5 4 2 が長さ方向の交互に配置されている。同様に、コイルシース 4 2 を挟んで配置される2つの係止部材 5 4 0 , 5 4 1 では、突起 5 4 2 が長さ方向の交互に配置されている。各突起 5 4 2 は、コイルの素線の間に進入するので、コイルシース 4 1 , 4 2 の抜け止めとなる。コイルシース 4 1 , 4 2 を固定するときは、スコープホルダ 2 6 に係止部材 5 4 0 , 5 4 1 を嵌め込んでおき、フックシース 2 1 と鉗子シース 2 2 をスコープホルダ 2 6 の貫通溝に通した状態で、スコープホルダ 2 6 からのコイルシース 4 1 , 4 2 の突出量を調整する。位置決めをしたら、コイルシース 4 1 , 4 2 を押し込んで突起 5 4 2 に係合させる。このようにすると、組立時間を短縮できると共に、コイルシース 4 1 , 4 2 の長さ調整が容易になる。

【 0 1 0 9 】

フックシース 2 1 の外周は、被覆しておらず、フックシース 2 1 とコイルシース 4 1 の2重構造になっている。これらシース 2 1 , 4 1 は、ステンレスから製造され、被覆がないことでシース 2 1 , 4 1 間の滑りが良好になる。内視鏡 4 にアングルをかけて湾曲させているときでもフックシース 2 1 を容易に進退させることができる。

【 0 1 1 0 】

図 3 8 に示すように、フックシース 2 1 を手元側のコイル 2 1 A と、先端側のコイル 2 1 B で素線径を異ならせている。手元側のコイル 2 1 A の素線径を太くすることで、フックシース 2 1 を引っ張ったときにコイルが伸びないようになる。また、先端側のコイル 2 1 B の素線径を細くすることで、可撓性が向上するので内視鏡 4 にアングルをかけ易くなる。さらに、アングルをかけた状態でフックシース 2 1 を軽い力で摺動できる。図 3 8 に示すように、コイルシース 4 1 の手元側を板厚の大きい平コイル 4 1 A にし、先端側を板厚の薄い平コイル 4 1 B にした。鉗子シース 2 2 を前進させたときにコイルシース 4 1 が伸び難くなつて、鉗子シース 2 2 の操作性が向上し、先端側で内視鏡 4 のアングルをかけ易くなる。平コイル 4 1 B を用いずに、板厚の大きい平コイル 4 1 A を先端まで用いれば、さらにコイルシースを延び難くできる。なお、各コイル 2 1 A , 2 1 B , 4 1 A , 4 1 B の境界は、溶接によって行っている。

【 0 1 1 1 】

鉗子シース 2 2 の外周は、被覆しておらず、鉗子シース 2 2 とコイルシース 4 2 の2重構造になっている。これらシース 2 2 , 4 2 をステンレスから製造することで、シース 2 2 , 4 2 間の滑りが良好になる。図 3 8 に示すように、鉗子シース 2 2 を手元側のコイル 2 2 A の素線径を太くして、鉗子シース 2 2 を引っ張ったときにコイルが伸びないようにしている。また、先端側のコイル 2 2 B の素線径を細くして、内視鏡 4 にアングルをかけ易くしている。さらに、アングルをかけた状態で鉗子シース 2 2 を軽い力で摺動できる。

【 0 1 1 2 】

ここで、コイルシース 4 1 とフックシース 2 1 の間のクリアランスを小さくして、体内に送気した気体がシース 2 1 , 4 1 の間を通って体外に漏れないようになっている。コイルシース 4 2 と鉗子シース 2 2 の間のクリアランを同様に小さくなっている。気密性が向上して、例えば、胃を膨らませるときに空気が漏れ難くなり、短時間で膨らませることが可能になる。一端膨らませた胃がすぐに萎まないようになる。送気の回数や時間が減って、処置が容易になり、術者のストレスを軽減できる。

【 0 1 1 3 】

図 3 2 及び図 3 8 、図 4 0 、図 4 1 に示すように、コイルシース 4 1 , 4 2 の先端は、スコープ受部 5 5 0 に溶接されている。スコープ受部 5 5 0 は、コイルシース 4 1 , 4 2 の1本ずつ接続される2つの筒部 5 5 1 , 5 5 2 と、内視鏡 4 を受ける筒部 5 5 2 とが先端側の連結部 5 5 4 で一体化され、各筒部 5 5 1 ~ 5 5 3 が略平行に配置されている。3つの筒部 5 5 1 ~ 5 5 3 を一体化したので、2つの筒部 5 5 1 , 5 5 2 の平行度が高くな

10

20

30

40

50

って処置部7の突没が容易になる。

【0114】

図40に示すように、樹脂製のフード555は、内環556に取り付けられ、内環556と筒部553は溶接で一体化されている。したがって、各部材の加工が容易になる。内環556の内径は、フード555の内径に略等しく、基端面556Aは内径を拡げるように面取りされている。内環556の外径はフード555の内径より大きく、溝556Bが環状に形成されている。フード555は、内視鏡4を保持できる範囲内で内環556から自然に外れない大きさのものが使用される。組立時のフード555の取り付けが容易になって、組立工数を削減できる。フード555を取り付けるときは、内環556を嵌めて、溝354Bにフード555の先端部を嵌合させる。次に、内環556の先端面と筒部553とをレーザ溶接等で一体化する。内環556の溝556Bの深さと、フード555の嵌合高さとを十分に確保することで、フード555の取り付け強度が向上する。

【0115】

図41に示すように、筒部552の先端の開口部552Aは、スコープ受部550の回転軸C1を中心とする円弧形にカットされおり、略C字形になっている。スコープ受部550の外形が小さくなっている。オーバーチューブ6に挿入し易くなる。処置部7が傾いたときにも引き込みが容易になる。

【0116】

図38及び図40に示すように、処置部7は、スコープ受部550に支持される先端カバー560を有し、先端カバー560に一対の鉗子部材115, 131が開閉自在に支持されている。さらに、先端カバー560には、鉗子部材115に装着された着脱針561を受け取るケーシング150が突没に収容されている。先端カバー560は、鉗子部材115, 131を開いた状態から着脱針561を受け取る時までの間、針先が内視鏡4の画面に確実に治まるように、長さが調整されている。これによって、例えば、図37に示すように、内視鏡4の画像535では、開いた一対の鉗子部材115, 131と着脱針561が画面の下方に表示される。このような配置にすることで、一対の鉗子部材115, 131が閉じるまでの間、着脱針561の軌跡を画像535で確認することができる。術者は、着脱針561を常に確認しながら処置を行えるので、処置の確実性を向上できる。

【0117】

図38及び図40、図42に示すように、先端カバー560は、鉗子シース22がレーザ等で溶接される鉗子受部571と、フックシース21がレーザ等で溶接されるケーシング支持部572とが、連結部573で連結された一体構成を有する。鉗子受部571内には、鉗子操作ワイヤ15に連結されたロッド575を含んで構成されるリンク機構576が設けられている。ロッド575の先端には、ピン110で一対のリンク部材111, 112が連結されている。リンク部材111は、ピン113で第一の鉗子部材115に連結されている。第一の鉗子部材115は、ピン連結された一端部から曲針120が固定された他端部まで延び、その途中においてピン116で先端カバー560に回転自在に支持されている。曲針120の先端には、着脱針561が装着されている。

【0118】

他方のリンク部材112の他端部は、ピン130で中間部材131Aの基端側と回転自在に連結されている。中間部材131Aの先端側はピン132で先端カバー560に回転自在に支持されている。

鉗子部材131において、先端カバー560にピン132で支持される部分131Cは、先端カバー560の内側に配置されている。鉗子部材131は、チャージ用バネ577で鉗子部材115, 131を閉じたときに鉗子部材131の先端部131Bを完全に閉じるように付勢される。チャージ用バネ577は、ピン132に摺動可能にコイル状に巻かれている。チャージ用バネ577の端部577Aは、一対の鉗子部材115, 131を閉じたときにリンク部材112の他端部112A(図40参照)に当接する。チャージ用バネ577の他方の端部は、鉗子部材131の部分131Cに当接する。チャージ用バネ577は、ピン132に摺動しつつ回転できる程度に巻かれており、ピン132に対して殆

10

20

30

40

50

ど傾くことがないので、リンク部材 112 や、鉗子部材 131 から外れない。

【0119】

図 42 に示すように、鉗子部材 115, 131 を開いたときに、チャージ用バネ 577 の端部 577A は、先端カバー 560 から組織に向かって突出する。他端部 577A は、略 U 字形に折り曲げられて湾曲している部分が先端に向かうので、処置部 7 を組織に押し付けても組織に刺さることはない。

【0120】

図 41 に示す状態では、ロッド 575 からピン 116, 132 までの距離に対して、リンク部材 111, 112 が長いので、ロッド 575 はこの位置より先端に移動できない。このため、第 1 の実施の形態のようなピンをロッドに設けて、先端カバーにガイド孔を設ける必要がなくなる。なお、他の実施態様で記載する装着装置の位置決めに使用する場合には、先端カバー 560 の片側のみにガイド孔を設けても良い。

【0121】

ここで、曲針 120 は、第一の鉗子部材 115 に形成された断面円形の孔 115D に挿入され、溶接で固定されている。曲針 120 の断面形状も略円形になっており、両者の位置出しは不図示の治具で行う。従来のように、曲針 120 の固定部の断面を D 字形にカットして位置出しをする場合に比べて加工工数を削減できる。

フック操作ワイヤ 18 の先端には、フック 581 が固定されている。フック 581 は、引き込んだ状態ではフックシース 21 内に収容される。このときにフック 581 とフックシース 21 の間の摺動抵抗が大きいと、フック 581 の動きが悪くなる。さらに、内視鏡 4 を湾曲したときにフック 581 の動きが重くなる。このため、フック 581 とフックシース 21 の間のクリアランスを大きくして、フック 581 の進退を小さい力で行えるようにしてある。なお、クリアランスは、0mm より大きく、0.1mm 以下であることが望ましい。この範囲であれば、フック 581 の動作が良好で、かつフック 581 から縫合糸 125 が外れることもない。

【0122】

図 43 及び図 44 に示すように、フック 581 は、先端部の幅を減少させた係合部 582 を有する。係合部 582 は、フックシース 21 との間で縫合糸 125 が通過可能な大きさで、基端側に向かう返し 582A によって縫合糸 125 を引っかけることができる。係合部 582 を製造するときは、テープを付けた刃を使用したエンドミルによる切削加工を行う。この際に、エンドミルの外径が縫合糸 125 に略等しい部分を使って、基端側から斜めに切削する。これによって形成される溝 583 の基端部は、オーバーハングした顎 584 が形成される。この顎 584 は、フック 581 の軸線からオフセットした位置で、かつ周方向で係合部 582 の返し 582A と同じ側に配置されている。コイルシース 41 からフック 581 を押し出したときに、この顎 584 に縫合糸 125 が引っ掛かるので、フック 581 を進退させる過程で縫合糸 125 を抜け難くできる。また、コイルシース 41 が曲がっているときでも顎 584 によって縫合糸 125 の抜け落ちが防止される。フック 581 を製造する際には、大きくカッターテープを付けた刃を使用したエンドミルで、縫合糸 125 を通す溝 583 を形成する際に、エンドミルの拡径部を押し当てて、溝 583 の周囲にフック 581 の幅を減少させるような面取り 585 を形成している。溝 583 と面取り 585 の加工を一度で行えるので、フック 581 を製造するときの製造コストを低減できる。

【0123】

このようなフック 581 は、例えば、SUS420F2 材のように、切削性が良好な材料を切削加工することで製造されている。これによって、加工時間を短縮し、加工刃物の耐久性を向上できる。

【0124】

図 38 に示すように、フックシース 21 は、先端カバー 560 のケーシング支持部 372 内に収容された支持部材 591 にレーザ等で溶接されている。支持部材 591 は、先端にケーシング 150 を保持する突部が設けられ、内部にフック 581 を通す貫通孔が形成

10

20

30

40

50

されている。さらに、ケーシング 150 に係合する一対のアーム 592 が溶接されている。アーム 592 は、細長形状を有する弾性部材から製造されており、支持部材 591 に溶接された根元部分を起点にして先端側が径方向外側に開くように曲げられている。アーム 592 の先端部は、内側に屈曲されている。溶接後にアーム 592 の曲げ加工を行うと、組立時間を削減できる。アーム 592 は、支持部材 591 の凹部に溶接されているので、アーム 592 が溶接された部分の支持部材 591 の外径は、他の部分と略等しく、ケーシング支持部 572 に対してスムーズに進退できる。

【0125】

ケーシング支持部 572 は、基端が支持部材 591 に当接可能に縮径させられており、ここから支持部材 591 の外径に略等しい内径を有して軸線方向に延び、その後、さらに拡径して先端に開口している。なお、内孔の先端側には、スペーサ 601 が挿入されているので、内径が拡げられた部分は、一部分のみになっている。内径が拡げられた部分では、支持部材 591 の一対のアーム 592 が弾性力によって復元して開き、ケーシング 150 の凹部 202 との係合が解消される。スペーサ 601 が挿入された部分では、アーム 592 が閉じられて、ケーシング 150 の凹部 202 に係合する。スペーサ 601 が挿入された部分は、一対の鉗子部材 115, 131 を閉じた後、曲針 120 をケーシング 150 から引き抜くときの位置に相当する。したがって、曲針 120 を引き抜くときは、アーム 592 がスペーサ 601 に押圧されることで弾性変形してケーシング 150 に係合し、ケーシング支持部 572 からの抜け落ちを防止する。

【0126】

ここで、ケーシング 150 を装着するときは、支持部材 591 が基端側にあるので、一対のアーム 592 はケーシング 150 を受け入れ可能に開いている。したがって、フック 581 をループ 125A に引っ掛け、フック 581 を引き込むだけで、先端カバー 560 への装着が終了する。ケーシング 150 を装着するときの手間が削減される。

【0127】

図 45 に示すように、カートリッジ（あるいは留置具とも称する）153 は、着脱針 561 と、着脱針 561 にカシメ固定された縫合糸 125 と、縫合糸 125 が通されたケーシング 150 とを有する。着脱針 561 は、先端に銳利な端部になっており、基端部に曲針 120 に嵌入可能なすり割り 610 が形成されている。すり割り 610 は、曲針 120 の内径に寸法誤差があったときでも着脱針 561 の保持や、離脱が適度な力量で行えるように、その寸法が定められている。例えば、着脱針 561 の全長が 5mm 程度の場合に、すり割り 610 の長さを 1.4mm 程度にすると、バネ定数が下がって、着脱針 561 と曲針 120 の着脱力量のばらつきを押さえられる。なお、着脱針 561 には、曲針 120 の先端面に当接する当接部 611 が設けられているが、すり割り 610 は当接部 611 の形成位置より基端側で止まっている。曲針 120 に挿入される部分の一部にすり割り 610 を設けないことで、着脱針 561 のぐらつきを防止し、曲針 120 の軸線と着脱針 561 の軸線を一致させやすくなる。

【0128】

図 45 及び図 46 に示すように、着脱針 561 の基端は、すり割り 610 を形成するスリットに直交する平面でカットすることで、この方向の長さを短くしている。カットされた端面 612 間の距離は、曲針 120 の孔が設計値の公差を含む最小径であった場合でもすり割り 610 が撓むことで挿入可能な大きさである。すり割り 610 によって幅を縮小可能な方向の長さは、端面 612 間の距離より長いが、この方向はすり割り 610 によって曲針 120 の孔径に合わせて弹性的に変形可能である。着脱針 121 の端部を部分的にカットすることで、曲針 120 の寸法誤差を許容して、着脱針 561 を曲針 120 に軽い圧入嵌合で確実に装着できる。

【0129】

図 45 に示すように、縫合糸 125 は、ケーシング 150 内に通され、一方の端部が着脱針 561 に固定され、他の方の端部で二重引き解け結びによるループ 125A を形成している。着脱針 561 からケーシング 150 に至るまでの縫合糸 125 の長さは、35m

10

20

30

40

50

m程度であり、組織を緊縛するに必要、かつ十分な長さである。また、ケーシング150から引き出された部分の長さは、ループ125Aの端に至るまで10mm程度である。これによって、カートリッジ153を装着したときにフック581を突出させた位置から緊縛位置までフック581のストローク量を減らせる。縫合糸125の長さを最適化することで、手元側のフック操作部14のストローク量を小さくでき、操作が容易になる。ケーシング150から引き出された部分の長さを短くすることで、ケーシング150を押し出すときに縫合糸125がくしゃくしゃに押し潰されることが起き難くなり、フックシース21内で引っ掛けからないようになる。

【0130】

さらに、ループ125Aを形成した後に残る縫合糸125の端部125Bの長さを2m以上にしている。これによって、ケーシング150をリリースするときに、縫合糸125の端部125Bがフックシース21の内面に引っ掛けたり、擦れたりしなくなる。ケーシング150の進退をスムーズに行える。

【0131】

図38及び図45に示すように、ケーシング150は、2ピース構造を有する。基端側の部材621は、支持部材591に係合可能で内部に線バネ165が収容されている。先端側の部材622は、着脱針561の基端部を収容可能な貫通孔623が形成されている。線バネ165は、平面視で略U字形を有し、両端部165Aが着脱針561の挿入方向に略垂直に折り曲げられている。折り曲げられた一対の端部165Aの間の距離は、着脱針561がカシメられた縮径部561Aの外径に略等しく、着脱針561の基端側の当接部611の外径より小さい。図45及び47に示すように、先端側の部材622には、貫通孔623と共に、線バネ165を挿入可能な孔624が形成されている。この孔624は、線バネ165の略U字形の部分を挿入可能な扁平形状を有する。線バネ165を挿入するときは、一対の端部165Aが貫通孔623の外径以下に近接するように変形させて、孔623, 624から挿入する。先端側の部材622と基端側の部材621の間には、端部165Aを広げられるスペース625があるので、このスペース625まで線バネ165を挿入すると、端部165Aが開き、以降は線バネ165が抜けなくなる。着脱針561が挿入されるときは、着脱針561の先端で端部165Aが押し広げられる。着脱針561の縮径部561Aでは、端部165Aが復元して閉じて着脱針561に係合する。この状態の線バネ165の端部165Aは、先端側の部材622の壁面に引っ掛かるので、着脱針561を引っ張っても線バネ165が着脱針561を係止する。したがって、着脱針561がケーシング150から外れることはない。線バネ165を先端側から挿入する構造にすることで、ケーシング150の先端側の部材621と基端側の部材622を一体構造にすることが可能になる。したがって、着脱針561を確実に収容することができる。

【0132】

従来は、ケーシングを2部材から構成する際は、接着や超音波溶着で一体化させている。この場合、接合部分で分離されると、着脱針561の先端側が露出して組織に接触してダメージを与える可能性がある。この実施態様では、ケーシング150を一体化して分離しない構造にしたので、線バネ165を着脱針561を受ける先端の開口側から、つぼめながら挿入して組み立て、アンダーカットになる部分で線バネ165を広げて抜けなくなる構造にしている。

【0133】

カートリッジ153で組織を緊縛するときは、一対の鉗子部材115, 131を閉じ、曲針120を組織に穿通させる。図48に示すように、着脱針561が、手元側に向けて、かつケーシング150と同軸上に配置される。手元側でフックシース21を前進させると、図49に示すようにケーシング150内に着脱針561が挿入される。このとき、スペーサ601に押されて一対のアーム392が閉じて凹部202を締め付けるので、スペーサ601が落下したり、軸がずれたりしない。着脱針561が線バネ165によって係止されたら、手元側でフックシース21を引き戻す。図50に示すように、着脱針561

10

20

30

40

50

が曲針 120 から外れてケーシング 150 と共に、先端カバー 560 内に引き込まれる。

【0134】

その後、一対の鉗子部材 115, 131 を開き、フックシース 21 を前進させる。図 50 に示すように、ケーシング 150 を先端カバー 560 より先に突出させたら、手元側のフック操作部 14 を引いて、フック 581 を後退させる。縫合糸 125 が引っ張られて、組織を締め付ける。組織を締め付けた後は、フックシース 21 を後退させて、フック 581 を前進させてケーシング 150 を支持部材 591 から外す。フック 581 を支持部材 591 から突出させて縫合糸 125 をフック 581 から外す。カートリッジ 153 が組織を緊縛した状態で留置される。

【0135】

(第3の実施態様)

図 52 に示すように、スコープホルダ 26 には、内視鏡操作部 4A に装着される受け部 701 が設けられている。受け部 701 は、断面が略 C 字形を有し、鉗子栓部 4B に合わせて切り欠き 702 が形成されている。スコープホルダ 26 を内視鏡 4 に装着するときは、受け部 701 を内視鏡操作部 4A に嵌めて、鉗子栓部 4B を跨がせた結束バンド 703 で締め付ける。結束バンド 703 は、細長のバンド部 704 の一方の端部に係止ヘッド部 705 が一体に設けられている。バンド部 704 には、ラックが長さ方向に沿って配設されている。結束バンド 703 は、受け部 701 の切り欠き 702 を挟んで配置される 2 つの取り付け部 707, 708 のそれぞれに係止される。

【0136】

一方の取り付け部 707 は、バンド部 704 は通すが、係止ヘッド部 705 は通さない挿入部 707A を有し、バンド部 704 のずれを防止する突起 707B が設けられている。図 53 に示すように、他方の取り付け部 708 は、バンド部 704 のずれを防止する突起 708A と、バンド部 704 を通す挿入部 708B が設けられている。さらに、挿入部 708B には、バンド部 704 のラックに係合するラチエット爪が設けられた係止部 708C が固定されている。ラチエット爪は、バンド部 704 を挿入する方向にはラックを係合せずに、バンド部 704 を引き戻す方向にはラックに係合する方向に形成されている。このスコープホルダ 26 では、鉗子栓部 4B を結束バンド 703 で締め付けて固定するようにしたので、内視鏡 4 の機種によらずにスコープホルダ 26 を取り付けられる。また、結束バンド 703 で締め付けることで、縫合器 1 を内視鏡 4 に強固に固定できる。

【0137】

この実施の形態の変形例について説明する。図 54 に示すスコープホルダ 26 は、受け部 701 の取り付け部材 710 の構成が異なる。取り付け部材 710 は、係止部 708D を有する。係止部 708D は、バンド部 704 の挿入方向と直交する方向にカットされ、ラチエット爪 711 が露出している。内視鏡 4 にスコープホルダ 26 を取り付けるときは、結束バンド 703 を取り付け部 707 から挿入し、バンド部 704 の他端を取り付け部 708 に通して引っ張る。スコープホルダ 26 を内視鏡 4 から取り外すときは、係止部 708D に通されたバンド部 704 を図 53 に矢印で示す挿入方向と略直交する方向にスライドさせ、カットされた面からバンド部 704 を引き出す。結束バンド 703 の再利用が可能になる。

【0138】

また、図 55 に示す結束バンド 712 を用いても良い。結束バンド 712 は、バンド部 704 の端部に略 V 字の切り込み 713 が形成されている。内視鏡 4 にスコープホルダ 26 を取り付けるときは、結束バンド 712 を取り付け部 707 から挿入する。図 56 に示すように、バンド部 704 の切り込み 713 を挿入部 707A に引っかける。バンド部 704 の他端を取り付け部材 710 を通して引っ張る。スコープホルダ 26 を内視鏡 4 から取り外すときは、係止部 708D に通されたバンド部 704 をスライドさせてバンド部 704 を引き出す。取り付け部 707 側は、切り欠き 513 を引っかけただけなので、結束バンド 712 は簡単に外れる。結束バンド 712 は、再利用できる。

【0139】

10

20

30

40

50

また、図57に示すように、受け部701の切り欠き702の周縁から弾性変形可能なロック部715を一体に延設させても良い。ロック部715は、鉗子栓部4Bに係止する爪715Aが突設されており、爪715Aの係脱を操作するレバー715Bが一体に設けられている。内視鏡4に装着するときは、レバー715Bを押してロック部715を変形させて爪715Aを開く。この状態で受け部701を取り付けたら、レバー715Bを離す。ロック部715が復元して爪715Aが鉗子栓部4Bに係止し、スコープホルダ26が固定される。レバー操作によるワンタッチでスコープホルダ26を内視鏡4に取り付けられる。なお、ロック部715は、受け部701と別体で構成しても良い。

【0140】

(第4の実施態様)

図58に示すように、2つのコイルシース41, 42と内視鏡4の内視鏡挿入部5とを束ねる弁体721は、第1の実施態様の弁体50に比べて大径の貫通孔722を有する。内視鏡挿入部5を通したときに、弁体721の内周面に接触し難くすることで内視鏡4を挿通させ易くなる。また、弁体721の圧入部723の径を第1の実施態様に比べて小さくしてある。内視鏡4を通して圧入部723が潰されても、内視鏡4との接触面積が小さくなるので、内視鏡4を挿通させ易くなる。この弁体721によれば、内視鏡4を挿通する作業が楽になる。

【0141】

また、弁体721をオーバーチューブ6に挿入するときの摺動抵抗を小さくするために、弁体721の外周の圧入部724の半径を小さくした。オーバーチューブ6内で圧入部724が潰されても接触面積を小さくできるので、挿入し易くなる。なお、これら圧入部724の大きさは、気密保持と摺動性のバランスが良好になる大きさに設定してある。

さらに、弁体721をオーバーチューブ6に挿入するときの摺動抵抗を小さくするために、弁体721を構成するゴムの硬度を例えば従来の50°から40°に落としている。オーバーチューブ6に挿入するのに必要な力量を低減でき、処置時間の削減や、作業ストレスの軽減ができる。

【0142】

(第5の実施態様)

図59(a)及び図60にカートリッジの変形例を示す。また、図61にこのカートリッジと共に使用されるフックを示す。

カートリッジ751は、ケーシング150に縫合糸125が通されており、縫合糸125に着脱針561が取り付けられている。縫合糸125は、基端側の部材621Aの孔190内でブレーキ部191に通された後に、引き出され、ケーシング150外で折り返されて再び部材621A内に引き込まれており、これによって縫合糸125のループ125Aを形成している。ケーシング150内に引き込まれた縫合糸125の端部は、孔190内に収容されたブレーキ部191にカシメ固定されている。さらに、結び目126を形成することで、抜け止めされている。縫合糸125を固定する手段は、カシメ固定と結び目126のどちらか一方でも良い。

このカートリッジ751では、縫合糸125のループ125Aが部材621A内まで延びているので、部材621Aから延出する縫合糸125が見かけ上2本になる。

【0143】

図61に示すフック581Aは、縫合糸125を通す部分の基端が先端に向かってせり出した、いわゆるオーバハング形状になっていないので、フック581Aを前進させると、縫合糸125がフック581Aとシース21の隙間に逃げて、フック581Aのみが前進する。フック581Aをさらに前進させてブレーキ部191に突き当てるとき、ケーシング150を確実に離脱させられる。なお、組織を緊縛するときは、図62に示すように、フック581Aを後退させる。フック581Aに縫合糸125のループ125Aが引っ掛かるので、縫合糸125を引き絞ることができる。

このようなフック581Aを用いると、ケーシング150を直接に押せるので、ケーシング150を確実に押し出すことができる。

10

20

30

40

50

【0144】

図59(a)に示す例では、ケーシング150の孔190内の軸線方向に結び目126を収容可能な空間190Aを設けているが、先端側の空間190Aを省略しても良い。この場合、図59(b)に示すように、結び目126は、手元側に折り返されて孔190内に収容される。

【0145】

(第6の実施態様)

図63には、内視鏡用処置具である縫合器801(アプリケータ)の処置部807の断面が示されている。なお、ケーシング150の保持構造は、第2の実施態様が使用できる。

図63及び図64に示すように、処置部807は、先端カバー810内に第一の鉗子部材である鉗子部材115を回動させる第一のリンク811と、第二の鉗子部材である鉗子部材131を回動させる第二のリンク812とが設けられている。

【0146】

第一のリンク811は、リンク部材111にピン821で連結ロッド822が進退自在に連結される。連結ロッド822は、入力部材であるロッド100と平行に延び、先端カバー810に支持されている。連結ロッド822の基端部は、連結ロッド822が挿通される第一の接続部823になっている。第一の接続部823は、内部に2枚の制御板824A, 824Bがロッド100の進退方向に前後して配置されている。これら制御板824A, 824Bは、第一の接続部823に設けられた2つのスリット825に傾倒自在に1つずつ挿入されている。各制御板824A, 824Bには、孔826が1つずつ形成されており、各孔826にロッド100が通されている。さらに、ロッド100に通されたコイルバネ827で制御板824A, 824B間を押圧させており、側面視でスリット825側が近接し、反対側が離れるように傾斜させてある。孔826は、制御板824A, 824Bが傾斜した状態ではロッド100に係合し、制御板824A, 824Bが軸線に垂直に立てられたときにはロッド100との間にクリアランスを形成できる大きさである。先端側の制御板824Aは、スリット828を通して反対側に突出している。

【0147】

第二のリンク812は、リンク部材112にピン831で連結ロッド832が進退自在に連結される。連結ロッド832は、ロッド100に対して第一のリンク811とは反対側で、ロッド100と平行に先端カバー810に支持されている。連結ロッド832は、第一のリンク811の第一の接続部823より先端側において、第二の接続部833を形成している。第二の接続部833は、ロッド100が進退自在に通されており、内部に2枚の制御板834A, 834Bがロッド100の進退方向に前後して配置されている。先端側の制御板834Aは、第一のリンク811の制御板824A, 824Bに対して、軸線回りに90°回転した方向に挿入され、第二の接続部833に形成された不図示のスリットに傾倒自在に通されている。制御板834Bは、制御板824A, 824Bに対して軸線回りに約180°回転した方向から挿入され、第二の接続部833のスリット835に傾倒自在に支持されている。各制御板834A, 834Bの孔836には、ロッド100が通されており、ロッド100に通されたコイルバネ837で互いに離れる方向に付勢されている。孔836は、制御板834A, 834Bが傾斜した状態でロッド100に係合し、制御板834A, 834Bが軸線に垂直に立てられたときにはロッド100との間にクリアランスを形成できる大きさである。制御板834Bは、スリット838を通して反対側に突出している。

【0148】

また、ロッド100よりもフックシース21側には、ロックアーム841が略平行に配置されている。ロックアーム841は、ピン132を長孔842に通して揺動自在に先端カバー810に支持されている。ロックアーム841は、連結ロッド832の第二の接続部833に先端側から係合可能な突起843と、制御板834Aに係合可能なラック844とを有し、ラック864の先の端部がロッド100に向かって鉤状に突出している。こ

のロックアーム 841 は、長孔 842 と突起 843 の間で押さえバネ 845 によって先端がロッド 100 に向かう方向に付勢されている。

【0149】

なお、先端カバー 830 は、第二の接続部 833 の先端側に制御板 834A を当接可能な突き当て部 851 が設けられている。また、図 63 に示す初期位置で、制御板 834B より基端側に、制御板 834B で連結ロッド 822 から突出する部分を当接可能な突き当て部 851 が設けられている。さらに、ロッド 100 の基端付近には、制御板 824B を当接可能な突き当て部 853 が設けられている。また、ロックアーム 841 が乗り上げ、制御板 824A とロックアーム 841 の間隔を開ける乗り上げ部 854 が設けられている。
10

【0150】

この縫合器 801 の動作について説明する。

開いた一対の鉗子部材 115, 131 を閉じるときは、ロッド 100 を後退させる。それぞれのリンク 811, 812 は、基端側の制御板 824B, 834B が斜めになることでロッド 100 に連結される。したがって、図 65 に示すように、ロッド 100 を引くに連れて一対の鉗子部材 115, 131 が閉方向に回動する。なお、ロックアーム 841 は、第二のリンク 812 の連結ロッド 822 が引き込まれることで、突起 843 と連結ロッド 822 の係合が外れる。押さえバネ 845 の付勢によって、ロックアーム 841 は、縫合器 801 の基端に向かう近位端側がロッド 100 に向けて回動する。しかしながら、ロックアーム 841 のラック 844 の向きは逃げる方向に形成してあるため、押さえバネ 845 の付勢でもロックアーム 841 が回動し、この方向に移動する制御板 824A には、係止しない。
20

【0151】

図 66 に示すように、一対の鉗子部材 115, 131 が初期状態に対してそれぞれ 90° 回動したところで、第二のリンク 812 の制御板 834B が先端カバー 810 の突き当て部 852 に当接する。制御板 834B は、突き当て部 852 に押されてコイルバネ 837 に抗して略水平に戻される。その結果、第二のリンク 812 とロッド 100 の連結が解消される。図 67 に示すように、ロッド 100 をさらに引くと、ロッド 100 に連結された鉗子部材 131 が回動せずに、鉗子部材 115 のみが回動する。

【0152】

図 68 に示すように、鉗子部材 115, 131 が閉じると、第一のリンク 811 の制御板 824B が突き当て部 853 に当接する。制御板 824B は、突き当て部 853 に押されてコイルバネ 827 に抗して略水平に戻される。その結果、第一のリンク 811 とロッド 100 の連結が解消される。この位置は、ロッド 100 が最も引かれた位置に相当する。同時に、制御板 824A は、ロックアーム 841 をロッド 100 が後退するときの移動方向に引っ掛けで移動させて、ロックアーム 841 は乗り上げ部 854 に乗り上げて、制御板 824A が移動してもラチエット爪 844 と干渉しない状態が保持される。
30

【0153】

一対の鉗子部材 115, 131 が閉じた状態からロッド 100 を前進させると、第二のリンク 812 は先端側の制御板 834A とロッド 100 の係合によってロッド 100 に連動し、鉗子部材 131 が開く。鉗子部材 131 が全開になる直前にロックアーム 841 は、連結ロッド 822 に乗り上げつつ、かつ押されて先端に向けて移動する。同時に、第一のリンク 811 は、ロックアーム 841 で傾斜させられた先端側の制御板 824A とロッド 100 の係合によってロッド 100 に連動するので、鉗子部材 115 が開く。図 69 に示すように、鉗子部材 131 が 90° 回転して開いたところでは、制御板 834A が先端側の突き当て部 851 に当接し、コイルバネ 837 に抗して略垂直に押し戻される。したがって、以降は、ロッド 100 を前進させても鉗子部材 131 は移動しない。鉗子部材 115 は、第一のリンク 811 が係合状態を保つので、90° を越えて約 180° まで開く。
40

【0154】

ここで、図67に示す位置からロッド100を途中で押し戻すと、鉗子部材115, 131を順番に開くことができる。図65に示すように、ロックアーム841のラック844が第一のリンク811の制御板824Aに係合して制御板824Aを水平にする。その結果、第一のリンク811とロッド100の連結が解消される。鉗子部材115は開かず、鉗子部材131のみが開く。図71に示すように、鉗子部材131が90°開いたときに、制御板834Aが突き当て部851に当接して第二のリンク812とロッド100の連結が解消される。

【0155】

この実施態様では、1つのロッド100に対して、2つの接続部823, 833を切り離し可能に接続し、ロッド100の進退方向に接続を断続させるポイントを各接続部823, 833ごとに設けたので、鉗子部材115, 131を独立に回動可能に構成したので、組織をつかみ直したり、刺入し直したりでき、狙った組織を確実に掴める。

【0156】

図72から図75を参照して、一対の鉗子部材115, 131の開閉動作のバリエーションを説明する。なお、各図において横軸は時間を示し、縦軸は開状態からの鉗子部材115, 131の回転角度とロッド100のストローク量を示す。ラインS1は、ロッド100のストローク量の変化の軌跡を示し、数字が大きいほど、手元側に引き戻したことになる。ラインS2はロッド100のストローク量に応じて変化する鉗子部材115の回転角度の軌跡を示す。ラインS3は、ロッド100のストローク量に応じて変化する鉗子部材131の回転角度の軌跡を示す。ラインS2, S3で示す回転角度は、各鉗子部材115, 131が完全に開いた位置を0°にしている。

【0157】

図72は、ラインS1に示すようにロッド100を最も前進させた位置から最も後退させた位置まで移動させ、かつ再び前進させた。ラインS2に示すように、鉗子部材115は、ロッド100に常に連動して動いた。ラインS3に示すように、鉗子部材131は、90°以上は回転しなかった。

【0158】

図73では、ロッド100を最も前進させた位置から引き戻し、一対の鉗子部材115, 131が90°閉じたところで、ロッド100を前進させた。ロッド100を前進させるときには、鉗子部材115は停止し、鉗子部材131はロッド100に対応して開いた。その後、ロッド100を引くと、一対の鉗子部材115, 131が共に閉方向に回動し、それぞれ180°、90°で停止した。

【0159】

図74では、ロッド100を最も前進させた位置から引き戻し、鉗子部材115が90°を越えて135°回転したところで、ロッド100を前進させた。ロッド100の移動に伴って鉗子部材131は開いたが、鉗子部材115は停止した。再びロッド100を引き戻すと、一対の鉗子部材115, 131が閉じた。

【0160】

図75では、ロッド100を最も前進させた位置から引き戻し、90°に至る前にロッド100の移動方向を前進に切り換えた。ロッド100の移動に伴って鉗子部材131は開いたが、鉗子部材115は停止する。再びロッド100を後退させると、一対の鉗子部材115, 131が閉じた。

【0161】

このような動作の例として、図73に対応する動作を図76から図81に具体的に示す。図76に示すように、開口の一方の側の組織に一方の鉗子部材115に取り付けられた曲針120が刺入し始める。図77に示すように、創傷部T1の一方の組織が一対の鉗子部材115, 131によって手繩りよせられ把持され、曲針120が組織を穿通する。この状態からロッド100を先端方向に移動させると、鉗子部材115を回動させるリンクとロッド100の係合が解除されるので、鉗子部材131のみが開く。図78に示すように、鉗子部材131が開くが、曲針120は組織を穿通したままである。縫合器801を

10

20

30

40

50

移動させ、図79に示すように、創傷部T1の反対側の組織に鉗子部材131を食い込ませる。ロッド100を基端方向に移動させると、曲針120側の鉗子部材115が停止したまま、鉗子部材131が閉じる。図80に示すように、鉗子部材131で手繩りよせられた組織が曲針120に穿通される。さらに、ロッド100を前進させると、図81に示すように、鉗子部材115側のリンクが接続され、一対の鉗子部材115, 131が閉じる。

【0162】

図73や図75では、回動可能範囲が大きい方の鉗子部材115を90°で停止させた状態で、回動可能範囲が小さい方の鉗子部材131を回動させることできる。曲針120を刺入し直すときに有効である。図73の時間3から時間5の間や、図75の時間4から時間7の間のように、一対の鉗子部材115, 131を開くようにロッド100を移動させたとき、回動範囲の大きい方の鉗子部材115は、回動範囲の小さい鉗子部材131が全開するまでは、停止している。10

【0163】

図73や図75では、回動可能範囲が大きい方の鉗子部材115を停止させた状態で、回動可能範囲が小さい方の鉗子部材131を開くことができる。鉗子部材131はチャージ用バネ577で付勢されることで組織を掴んでいるので、一対の鉗子部材115, 131を開くと、鉗子部材131より先に鉗子部材115が開いてしまい曲針120が抜けてしまうことがある。このような場合に、鉗子部材115を組織に刺入した状態で鉗子部材131を開くことができる。このように、一対の鉗子部材115, 131をロッド100で独立に動作させることができると、鉗子部材115に一度組織を穿刺させた後に、そのまま鉗子部材131のみ開いて再度別の組織も含めて咬み合わして穿刺することができる。また、このような構成により、狙った位置で狙った運針が可能になる。20

【0164】

(第7の実施態様)

図82及び図83に示す装着装置901は、2枚のベースプレート902, 903を張り合わせた内部に、カートリッジ153が収容されている。装着装置901は、細長の針保持部911と、ケーシング保持部912とを有し、針保持部911とケーシング保持部912がアーム部913で連結されている。この装着装置901は、図82に矢印で示す方向から縫合器1を装着して使用する。30

【0165】

ケーシング保持部912には、一対のロック部材921, 922が開閉自在に取り付けられている。ロック部材921, 922の端部には、突起921A, 922Aが形成されている。これら突起921A, 922Aは、縫合器1の先端カバー80のガイド孔80Cに挿入される。ガイド孔80Cが一方の側面のみに形成されている場合には、対応するロック部材921, 922のみに突起が形成される。

【0166】

図84及び図85に示すように、ベースプレート903は、針保持部911を形成するプレート931が図中に矢印で示す縫合器1の挿入方向に略沿って細長に延びている。その端部には、曲針120を受け入れ可能な受け入れ部932が凹設されている。受け入れ部932は、曲針120を受け入れ易いように、開口幅が徐々に拡がっている。受け入れ部932の奥には、着脱針561が収容されている。受け入れ部932には、縫合糸125を引き出すための切り欠き932Aが形成されている。着脱針561を弾性的に支持するために、プレート931には、ステー933が着脱針561に直交する方向に設けられている。さらに、着脱針561は、プレート931に装着された針ホルダ935に支持されている。針ホルダ935は、支持部935Aで片持ち支持されており、曲針120を受け入れ可能に、かつ着脱針561を芯出しして支持している。40

【0167】

プレート931の端部には、アーム部913を形成するプレート940が一体に、かつプレート931と直交する方向に延びている。プレート940の端部には、ケーシング保50

持部 912 を形成するプレート 941 が一体に接続されている。

プレート 941 は、スライド溝 943 が矢印の方向に沿って設けられている。スライド溝 943 には、ケーシング 150 を収容するホルダ 942 が配置される。スライド溝 943 の途中には、係止溝 944 がスライド溝 943 の長さ方向と略直交する方向に凹設されている。また、プレート 941 には、縫合器 1 を案内するためのガイド片 945 と、鉗子部材 131 を弾性的に押圧するアーム 946 が一体に延設されている。略中央に設けられた軸 947 には、ロック部材 922 が回動自在に支持される。プレート 941 は、プレート 931 と略平行に延びており、それぞれのプレート 931, 941 の近接する端部にガイド片 931A, 931B, 941A が立設されている。

【0168】

ベースプレート 902 は、針保持部 911 を構成するプレート 948 と、ケーシング保持部 912 を構成するプレート 949 と、アーム部 913 を構成するプレート 950 とを有する。ベースプレート 902 の内面の構成は、ベースプレート 903 と略同じ構成になっている。ただし、ベースプレート 902 には、ステー 933 は設けられていない。また、ガイド片 931A, 931B をスライド自在に受け入れる溝がプレート 903 に設けられ、ガイド片 941A をスライド自在に受け入れる溝がプレート 948 に形成されている。

【0169】

図 86 に示すように、ホルダ 942 は、ケーシング 150 を収容可能な本体部 951 にシリンドラ 952 が回転可能に挿入されている。

ホルダ 942 の本体部 951 には、ケーシング 150 が挿入されている。本体部 951 は、弾性変形可能な一対のアーム 953 でケーシング 150 を係止されており、ケーシング 150 の基端の一部がホルダ 942 の外に露出している。本体部 951 の外周には、突部 951A がフランジ状に設けられており、この突部 951A に突き当てるよう糸ホルダ 955 が装着されている。

【0170】

図 86 及び図 87 に示すように、糸ホルダ 955 は、断面が略 C 字形を有し、一部がシリンドラ 952 に合わせて円弧状に凹設されている。この円弧状の曲面 955A から内周面にかけて、縫合糸 125 を通す溝 956 が形成されている。また、中心軸を基準にして曲面 955A に対して反対側には、ケーシング 150 に略沿って延びるガイド部 957 が延設されている。ガイド部 957 の外周の肩部 957A には、縫合糸 125 が巻き回される。

【0171】

図 86 及び図 88 に示すように、縫合糸 125 は、ケーシング 150 から引き出され、ケーシング 150 の外周に 1 重に巻き回される。ループ 125A は、糸ホルダ 955 のガイド部 957 の肩部 957A に引き回された後に、溝 956 を通してからシリンドラ 952 に巻き掛けられる。ループ 125A の途中には、シリンドラ 952 に引っかける結び目 125C が形成されている。

シリンドラ 952 は、溝 961 が円筒の中央に向かって形成されている。この溝 961 は、縫合糸 125 を 1 本挿通可能であるが、結び目 125C は通過不能な幅を有する。シリンドラ 952 は、本体部 951 内に収容された不図示のネジリコイルバネで軸線回りに回転するよう付勢されている。図 86 に示すように、シリンドラ 952 は、その一部が本体部 951 の端部から突出しており、突出した部分 952A には、径方向外側に膨出するストッパ 962 が設けられている。ストッパ 962 は、ベースプレート 902 側の係止溝 944 内に挿入される。

【0172】

ホルダ 942 の長さは、ベースプレート 902 のスライド溝 943 の長さに比べて小さい。アーム部 913 側の端部とホルダ 942 の間には、コイルスプリング 965 が架け渡されており、ホルダ 942 は、プレート 940 側に常に付勢されている。しかしながら、初期状態ではストッパ 962 を係止溝 944 に係止させるので、ホルダ 942 がプレート

10

20

30

40

50

940側に引き寄せられることはない。

【0173】

図89に示すように、カートリッジ153を装着するときは、一対の鉗子部材115, 131を開いた状態で、フックシース21(留置具20の非処置側を牽引する牽引部材を収容しているシース)を前進させて、ケーシング支持部86内の先端爪部211(図10参照)を先端に突出させる。

図90及び図91に示すように、処置部7を装着装置901に押し付けると、ロック部材921, 922の突起921A, 922Aが縫合器1の先端カバー80のガイド溝80Cに嵌る。

【0174】

このとき鉗子部材115は、曲針120が針保持部911の受け入れ部932に入り込む。受け入れ部932は、奥に進むに従って開口径が小さくなるような円錐台形状を有するので、曲針120と受け入れ部932との間に微小な位置ずれがあった場合でも、曲針120は、受け入れ部932のテーパに倣って着脱針561に導かれる。曲針120は、針ホルダ935を押し退けながら、針ホルダ935で芯出しされた着脱針561に嵌入し始める。曲針120に押し退けられることで針ホルダ935は、片持ちされている部分935Aを支点として、ステー933を越えて移動し、曲針120の移動経路から退避する。このとき、ステー933の先端が針ホルダ935に当接して針ホルダ935が着脱針561側に戻らないように押さえ付ける。

【0175】

ここで、着脱針561は、受け入れ部932の開口端寄りに支持されているので、曲針120は着脱針561を押し込みながら嵌着する。針保持部911は、アーム部913が弾性変形することでケーシング保持部912に対して自由に移動できるが、ベースプレート903側のガイド片931A, 931B, 941Aは、ベースプレート902側の溝に沿ってしかスライドできないので、針保持部911の移動方向は縫合器1の挿入方向のみに規制される。したがって、曲針120の先端の軸線と着脱針561の軸線とがずれることなく、確実に装着される。

【0176】

一方、鉗子部材131は、ケーシング保持部912のアーム946に突き当たる。アーム946によって鉗子部材131が開方向に付勢される。これによって、鉗子部材131に遊びや、製造誤差があった場合でも、一対の鉗子部材115, 131がカートリッジ153の装着に適した状態に強制的に開かれる。

【0177】

図92に示すように、フック212を前進させて、ケーシング150をホルダ942内に押し込む。ケーシング150が完全に押し込まれると、ケーシング150の外周に巻きまわされていた縫合糸125のループ125Aが余るので、シリンドラ952がネジリコイルバネによって本体部951に対して回転する。ループ125Aがシリンドラ952に巻き取られることで、縫合糸125が引っ張られてフック212に巻き付く。

フック212を引き戻すと、縫合糸125が溝961に引っ掛けていることから、糸ホルダ955が縫合器1に引き寄せられる。ホルダ942は、ストップ962が係止溝944に引っ掛けしており、かつコイルスプリング965で反対側に付勢されている。このため、図93に示すように、糸ホルダ955のみが移動する。糸ホルダ955に引っ張るようにして縫合糸125がシリンドラ952から抜ける。

【0178】

シリンドラ952は、縫合糸125が外れることで、さらに回転し、本体部951から突出する部分952Aに設けられたストップ962が係止溝944から外れる。図94に示すように、コイルスプリング965が短縮し、ホルダ942がスライド溝943に沿って移動する。フック212は移動しないので、フック212に巻き付いた縫合糸125にテンションがかかる。フック212を引き戻すと、図95に示すように、縫合糸125を介してホルダ942が引っ張られる。フック212を引っ張る力と、コイルスプリング965

10

20

30

40

50

5 の引っ張り力がホルダ 942 のアーム 953 (図 86 参照) に作用する。フック 212 を所定長引いてケーシング 150 がケーシング支持部 86 に引き込まれると、ケーシング 150 と共にホルダ 942 が縫合器 1 側に移動する。この位置には、アーム 953 が開くことができる空間が確保されているので、アーム 953 がケーシング 150 から外れ、ケーシング 150 がホルダ 942 から離脱してケーシング支持部 86 内に収容される。ロッド部材 921, 922 を開いて縫合器 1 を後退させて図 96 に示すように装着装置 901 から引き離すと、カートリッジ 153 の装着が終了する。

【0179】

この実施態様では、装着装置 901 を使用することで、カートリッジ 153 の装着が容易になる。また、装着装置 901 は、フック 212 に縫合糸 125 が巻き付いた後に、ホルダ 942 がコイルスプリング 965 の付勢によって引っ張れるので、フック 212 に巻き付いた縫合糸 125 にテンションをかけた状態で、縫合糸 125 を縫合器 1 内に引き込むことができる。このため、フック 212 から縫合糸 125 が外れることがなく、カートリッジ 153 を確実に装着できる。なお、この装着装置 901 は、縫合器 501 にも使用できる。

【0180】

(第 8 の実施態様)

図 97 に示す装着装置 1001 は、2 枚のベースプレート 1002, 1003 を張り合わせた内部に、カートリッジ 153 が収容されている。図 98 に示すように、装着装置 1001 の内部には、溝 1009 が形成されており、ここにロッド 1010 が長さ方向に進退自在に収容されている。ロッド 1010 の先端には、係止部材 1071 が固定されおり、係止部材 1071 をケーシング 150 に挿入することでケーシング 150 を保持する。係止部材 1071 は、ケーシング 150 が軽い圧入状態になるようなゴム軸を用いることで抜け易くなっている。ロッド 1010 の外周には、コイルバネ 1012 が巻き回されている。コイルバネ 1012 の一端は、溝 1009 の端に係止されている。コイルバネ 1012 の他端は、ロッド 1010 に固定されている。ロッド 1010 は、コイルバネ 1012 が所定長に圧縮される位置で突起 1015 により係止されている。したがって、コイルバネ 1012 が圧縮された分だけロッド 1010 が図 98 の矢印方向に付勢されている。突起 1015 は、ベースプレート 1002 に一体に設けられたボタン 1014 から延設されている。ボタン 1014 は、ベースプレート 1002 の面に直交する方向に押圧可能であり、ボタン 1014 が押されると突起 1015 も同じ方向に移動する。

【0181】

ベースプレート 1002 には、受け部 1016 がさらに設けられている。受け部 1016 は、着脱針 561 を芯出ししつつ保持可能で、曲針 120 を受け入れ可能に開口端側の幅が拡がっている。受け部 1016 の反対側のベースプレート 1002 の端部には、アーム 1017 が突設されている。

なお、ベースプレート 1003 は、突起 1013、ボタン 1014 を有しない他は、ベースプレート 1002 と略同じ構成である。

【0182】

係止部材 1071 にカートリッジ 153 のケーシング 150 を嵌合させると、図 99 に示すように、ケーシング 150 がロッド 1010 に支持される。受け部 1016 には着脱針 561 が装着される。縫合糸 125 は、ベースプレート 1002, 1003 の隙間を通って引き回される。

【0183】

カートリッジ 153 を縫合器 1 に装着するときは、フック 212 にループ 125A を引っかけてからボタン 1014 を押す。図 100 に示すように、突起 1015 がロッド 1010 から外れ、ロッド 1010 が縫合器 1 から離れる方向に移動する。このとき、縫合糸 125 が引っ張られ、フック 212 とループ 125A の間にテンションがかかる。コイルバネ 1012 の作用によって、フック 212 からループ 125A が外れない。曲針 120 は、受部 1016 に進入して着脱針 561 に嵌合する。鉗子部材 131 は、アーム 1011

10

20

30

40

50

7に突き当たって押圧されるので、一対の鉗子部材115, 131は完全に開いた状態になる。

【0184】

フック212を引くと、縫合糸125、ケーシング150を介してロッド1010が引き寄せられる。図101に示すように、コイルバネ1012が圧縮されて、ロッド1010が突出し、ケーシング150が先端カバー80の中のケーシング保持部に引き込まれる。この後、縫合器1を引き離すと、ケーシング150と係止部材1011の係合が解消され、カートリッジ153が縫合器1に受け渡される。

このとき、フック212が自然に引き戻されるように、バネ等の弾性部材を使用するところ、操作部2側で指掛け用のリング17を基端側で引く操作が不要になる。図102に示すように、操作部2で、フック操作ワイヤ18を覆う補強パイプ1021の外周にバネ1022を配置し、フック操作部14を基端方向に付勢する。操作部2をこのような構成すると、実施態様に示される装着装置1001を用いずにカートリッジ153を装着する場合でも操作が楽になる。

【0185】

この実施態様では、フック212に最初にループ125Aを引っ掛けて、コイルバネ1012の力を利用してテンションをかけながらカートリッジ153を縫合器1に装着できるので、フック212からループ125Aが外れずに確実に装着できる。ボタン操作でテンションをかけることできるので、ゴム手袋をした状態でも簡単に操作できる。

【0186】

ここで、変形例を図103に示す。装着装置1101は、ロッド1010が進退自在に配置されている。カートリッジ153を装着するときは、フック212にループ125Aを引っかけてから、フック212を引き戻す。ロッド1010の引き摺り抵抗によって縫合糸125にテンションがかかる。このような装着装置1101では、簡単な構成でカートリッジ153を縫合器1に装着することが可能になる。

【0187】

以上、望ましい実施態様を説明したが、本発明は上記の実施態様に限定されることはない。例えば、実施態様では、柔軟性を有する挿入部を備えた軟性内視鏡用として記載されているが、挿入部がリジッドな硬性内視鏡に応用することも可能である。各実施態様の構成要素は、任意に組み合わせて使用することができる。また、前記した各部品の同士の接合には、レーザ溶接、ロー付け、半田付け、接着、圧入、カシメ及びこれらの接合方法の組み合わせによる接合などを使用できる。また、2部品で構成されるものは、圧接や成型で一体に製造しても良い。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で構成の付加、省略、置換、及びその他の交換が可能である。本発明は、上記の説明によって限定されることはなく、添付の特許請求の範囲によってのみ限定される。

【図面の簡単な説明】

【0188】

【図1】内視鏡及び内視鏡用処置具の一実施態様としての縫合器の概略構成を示す図である。

【図2】図1のA矢視であって、操作部の構成を示す図である。

【図3】挿入部の構成を示す一部断面図である。

【図4】図1のB-B線に沿って弁体をみた図である。

【図5】図4のC-C線に沿った断面図である。

【図6】縫合器の先端部分の拡大図である。

【図7】図6のD矢視図である。

【図8】図6のE矢視図である。

【図9】図7のF-F線に沿った断面図である。

【図10】鉗子部材を開いたときの断面図である。

【図11】図10のG矢視図である。

【図12】着脱針とケーシングと縫合糸を含む処置具を示す断面図である。

10

20

30

40

50

【図13】図12のH-H線に沿った断面図であり、着脱針を係止させた図である。

【図14】着脱針の係止を解除する装置の一例を示す図である。

【図15】図13のI-I線に沿った断面図である。

【図16】縫合方法を説明する図であって、鉗子部材を開口に向けて開いた断面図である。

【図17】鉗子部材を閉じて、開口を含む組織を挟み込んだ断面図である。

【図18】2回穿刺を確実に実行できる操作部の一態様を示す図である。

【図19】2回穿刺を確実に実行できる操作部の他の態様を示す図である。

【図20】図19のJ-J線に沿った断面図である。

【図21】図20のK-K線に沿った

10

【図22】図21の状態からストップ解除ボタンを押し込んだ図である。

【図23】先端カバー及び鉗子部材を引いて、着脱針をケーシング内に挿入した断面図である。

【図24】先端カバー及び鉗子部材を先端に向けて戻して、ケーシングに収容した着脱針を曲針から取り外した図である。

【図25】曲針から着脱針を取り外した後に、鉗子部材を開いた図である。

【図26】開口を縫合した状態で処置具を留置する図である。

【図27】先端爪部を一体に形成した断面図である。

【図28】先端保持部とブリッジ部とケーシング保持部とを一体に構成した図である。

【図29】他の形態の縫合器の先端部分を示し、受け部に切り欠きを設けた図である。

20

【図30】受け部に切り欠きと、テープ面を設けた図である。

【図31】第1の係止部材の変形例を示す図である。

【図32】内視鏡及び内視鏡用処置具の一実施態様としての縫合器の概略構成を示す図である。

【図33】図32の領域Lの断面図である。

【図34】図32の領域Mの断面図である。

【図35】図34のN-N線に沿った断面図である。

【図36】挿入部の構成を示す断面図である。

【図37】内視鏡画像を示す模式図である。

【図38】縫合器の先端部分の断面図である。

30

【図39】挿入部の構成を示す一部断面図である。

【図40】図38のP矢視図である。

【図41】図40のQ矢視図である。

【図42】一対の鉗子部材を開いた図である。

【図43】フックの拡大図である。

【図44】図43のR-R線に沿った断面図である。

【図45】カートリッジの構成を示す断面図である。

【図46】図45のS-S線に沿った断面図である。

【図47】ケーシングを着脱針の挿入方向からみた図である。

【図48】一対の鉗子部材を閉じて組織を持たした図である。

【図49】ケーシングを前進させて着脱針を収容した図である。

【図50】ケーシングを引き戻して着脱針を曲針から離脱させた図である。

【図51】一対の鉗子部材を開いてからケーシングを押し出した図である。

【図52】スコープホルダを内視鏡に装着した図である。

【図53】スコープホルダを半端側からみた図である。

【図54】スコープホルダの変形例を示す図である。

【図55】結束バンドの変形例を示す図である。

【図56】図55に示す結束バンドを用いるスコープホルダを示す図である。

【図57】ロック部材を一体に設けたスコープホルダの図である。

【図58】弁体の他の態様を示す断面図である。

40

50

【図59】(a)はカートリッジの変形例を示す側面視の断面図であり、(b)は(a)の変形例を示すカートリッジの断面図である。

【図60】図59(a)のカートリッジの平面視の断面図である。

【図61】フックの変形例を示し、縫合糸の先端部分を拡大した断面図である。

【図62】フックを引いて縫合糸を引っ張った図である。

【図63】鉗子部材が別々のリンクで駆動される縫合器の先端部の断面図である。

【図64】リンクの配置を説明するための斜視図である。

【図65】一対の鉗子部材を共に閉方向に回動させる過程を示す図である。

【図66】一対の鉗子部材が共に90°回動した図である。

【図67】閉じきった鉗子部材は停止し、閉じきっていない鉗子部材が135°回動した図である。 10

【図68】一対の鉗子部材が閉じた図である。

【図69】閉じた鉗子部材を開く方向に回動させた図である。

【図70】図67から鉗子部材を開く方向に回動させた図である。

【図71】鉗子部材を差動させた図である。

【図72】ロッドのストロークを変化させたときの一対の鉗子部材の挙動をグラフ化した図である。

【図73】ロッドのストロークを変化させたときの一対の鉗子部材の挙動をグラフ化した図である。 20

【図74】ロッドのストロークを変化させたときの一対の鉗子部材の挙動をグラフ化した図である。

【図75】ロッドのストロークを変化させたときの一対の鉗子部材の挙動をグラフ化した図である。 20

【図76】図72に対応する動作を説明する図である。

【図77】図72に対応する動作を説明する図である。

【図78】図72に対応する動作を説明する図である。

【図79】図72に対応する動作を説明する図である。

【図80】図72に対応する動作を説明する図である。

【図81】図72に対応する動作を説明する図である。

【図82】装着装置の外観を示す平面図である。 30

【図83】図82のT矢視図である。

【図84】装着部のベースプレートを一枚取り除いた図である。

【図85】ベースプレートの平面図である。

【図86】ホルダにカートリッジを装着した斜視図である。

【図87】糸ホルダの斜視図である。

【図88】カートリッジの断面図である。

【図89】縫合器にカートリッジを装着するときの動作を説明する図である。

【図90】縫合器を装着装置に係合させた図である。

【図91】縫合器を装着装置に係合させたときの外観図である。

【図92】フックでケーシングを押し込んだ図である。 40

【図93】フックを戻して、縫合糸を介して針ホルダを引っ張った図である。

【図94】ホルダがコイルバネに引っ張られて後退した図である。

【図95】フックで縫合糸を引いてホルダを引き寄せた図である。

【図96】ケーシングがホルダから外れた図である。

【図97】装着装置の他の形態を示す図である。

【図98】装着装置のベースプレートを一枚取り除いた図である。

【図99】カートリッジを装着する手順を説明する図であって、フックに縫合糸を引っかけた図である。

【図100】ボタンを押してロッドを後退させ、縫合糸にテンションをかけた図である。

【図101】フックで縫合糸を引っ張り、ロッドを引き寄せた図である。 50

【図102】操作部の例を示す図である。

【図103】装着装置の変形例を示す図である。


【符号の説明】

【0189】


1 , 3 2 3 , 5 0 1 , 8 0 1	縫合器（内視鏡用処置具）	
2	操作部	
3	挿入部	
4	内視鏡	
7	処置部	
1 3	鉗子操作部	10
1 4	フック操作部	
1 5	鉗子操作ワイヤ（操作部材）	
1 7	リング（指掛け部）	
2 0	留置具	
2 1	コイルシース	
2 2	鉗子シース	
2 5	進退操作部（第1のホルダ）	
2 6	スコープホルダ（第2のホルダ）	
3 2	第1の調整部材	
3 7	第2の調整部材	20
7 1	先端保持部	
7 5	ピン（第1の係止部材、先端係止部材）	
7 7	解除部材（鉗子解除部材）	
8 0	先端カバー	
8 6	ケーシング支持部	
1 0 0	ロッド（入力部）	
1 0 2	ボール（鉗子係止部材）	
1 0 5	解除部材（先端解除部材）	
1 1 5 , 1 3 1	鉗子部材	
1 2 0	曲針	30
1 2 1 , 5 6 1	着脱針	
1 2 5	縫合糸（糸状部材）	
1 2 5 A , 2 0 0	ループ（フック係合部）	
1 4 0	チャージ用バネ	
1 5 0	ケーシング	
1 5 1 , 1 5 2	ストッパー	
1 7 0	解除穴	
1 9 1	ブレーキ部	
1 9 2	弾性部材	
2 1 1	先端爪部	40
2 1 2	フック	
3 0 1	先端爪部	
3 0 2	爪部	
3 1 0	支持部材	
3 2 3	縫合器	
3 2 5	ケーシング保持部	
3 7 2	ケーシング支持部	
5 6 1	着脱針	
5 7 2	ケーシング支持部	
5 8 1	フック	50

5 9 1	支持部材	
5 9 2	アーム	
6 0 1	スペーサ	
6 2 5	スペース	
7 5 1	カートリッジ	
8 0 7	処置部	
8 1 1	第一のリンク	
8 1 2	第二のリンク	
8 2 3	第一の接続部	
8 2 4 A , 8 2 4 B , 8 3 4 A , 8 3 4 B	制御板	10
8 3 2	連結ロッド	
8 3 3	第二の接続部	
8 4 1	ロックアーム	
9 0 1	装着装置	
9 1 2	ケーシング保持部	
9 3 5	針ホルダ	
1 0 0 1	装着装置	
1 0 1 0	ロッド	
1 0 1 2	コイルバネ	
1 0 1 4	ボタン	20
1 1 0 1	装着装置	


【図1】

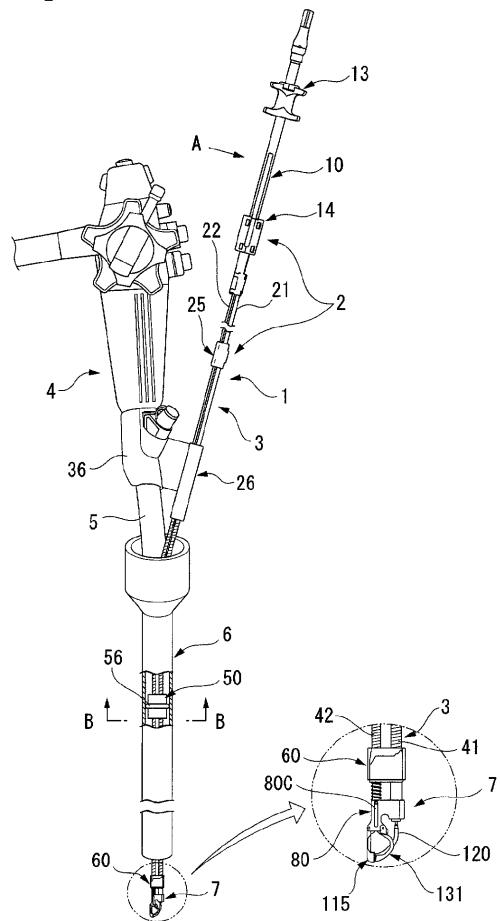


【図2】

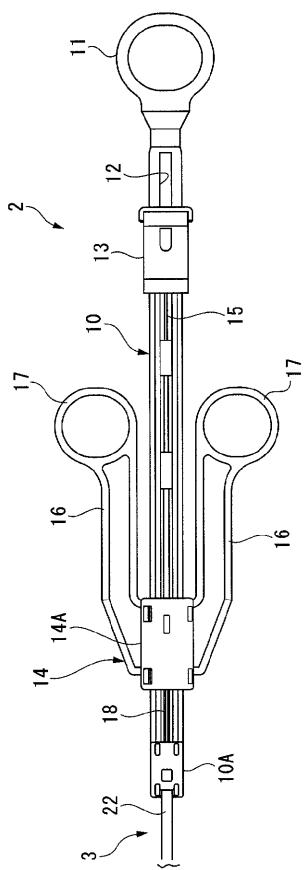


【 図 3 】

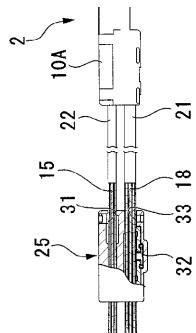


【 図 4 】

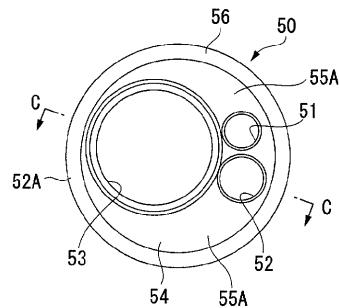


【 図 5 】

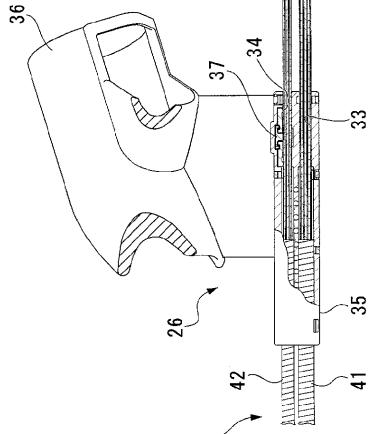


【 図 6 】

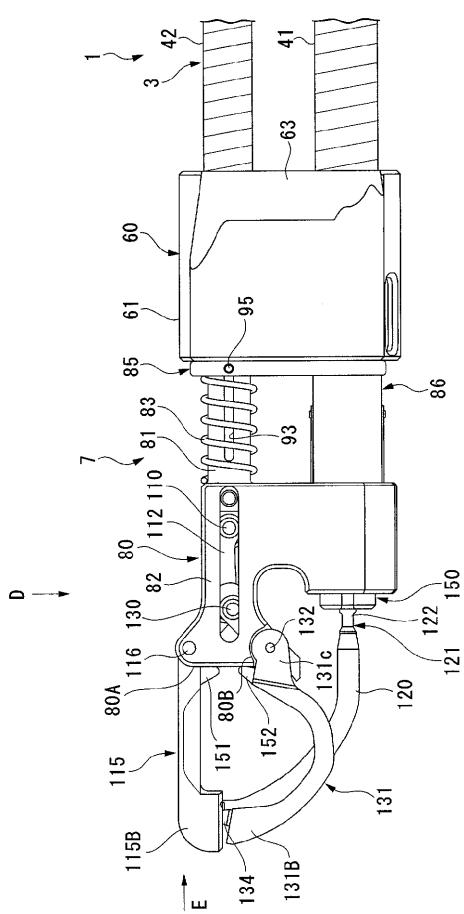


【 四 7 】

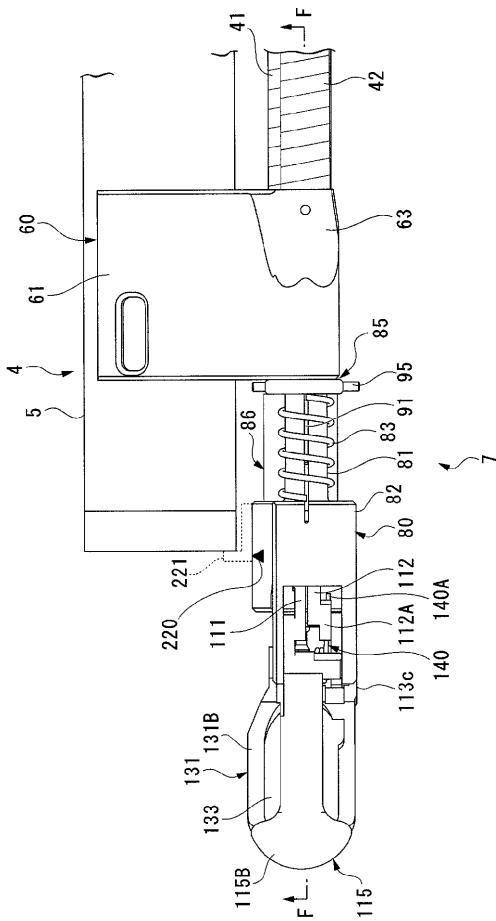


【 図 8 】

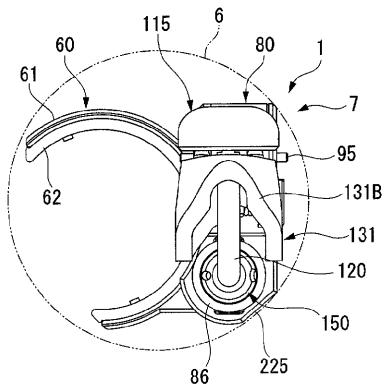


【 図 9 】

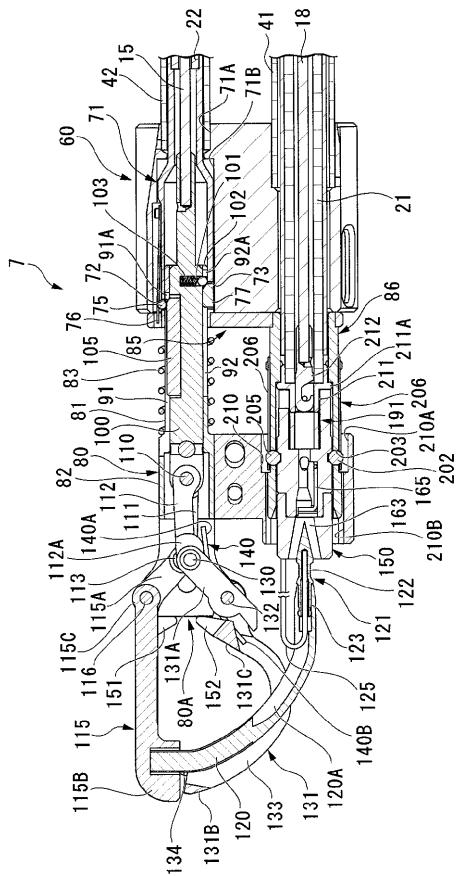


【 図 1 0 】

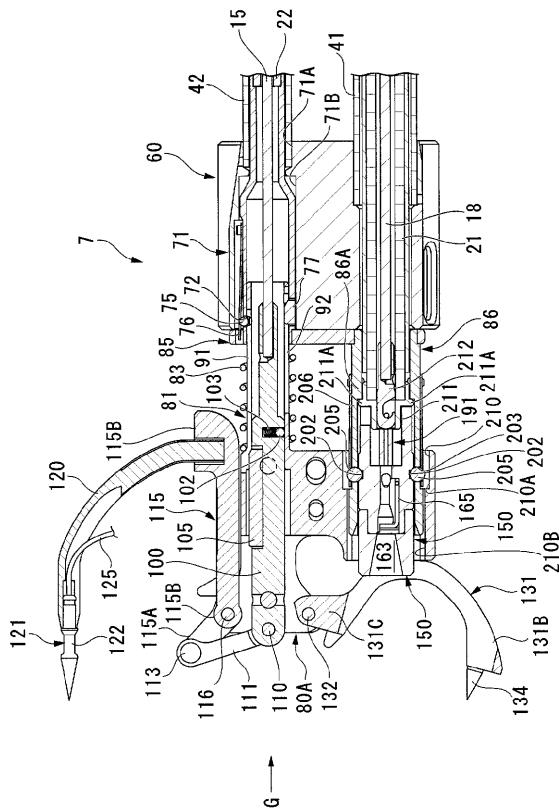


【 図 1 1 】

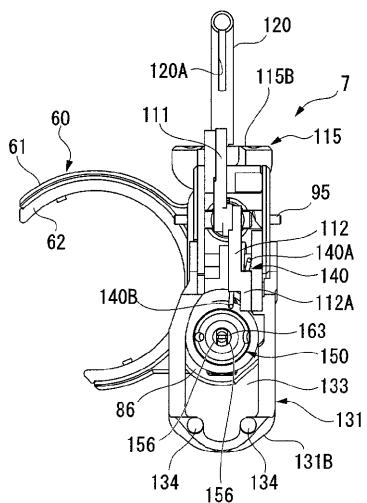


【図12】

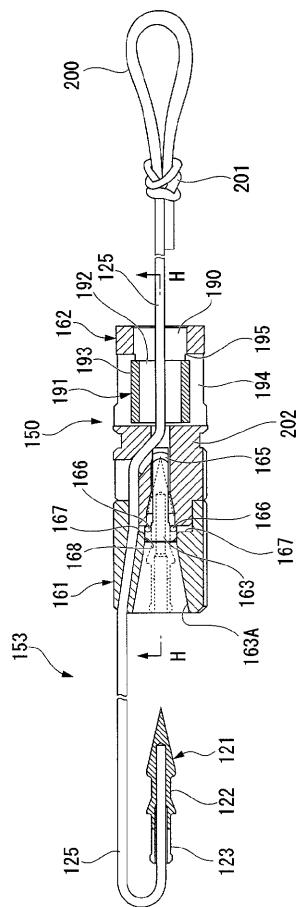


【図14】

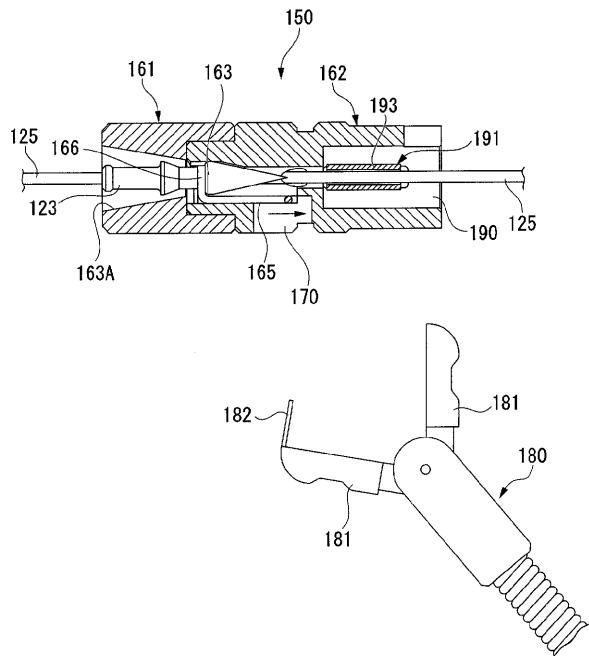


【 図 1 3 】

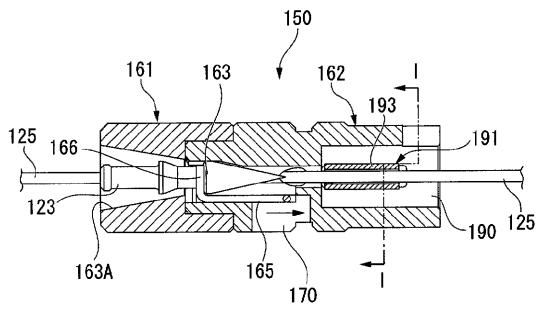


【 図 1 5 】




【図16】

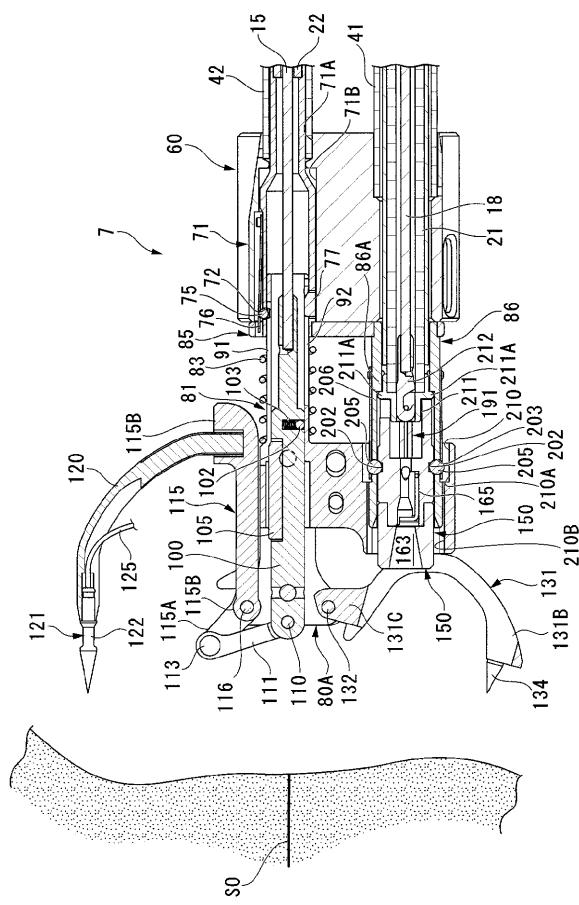


【図17】

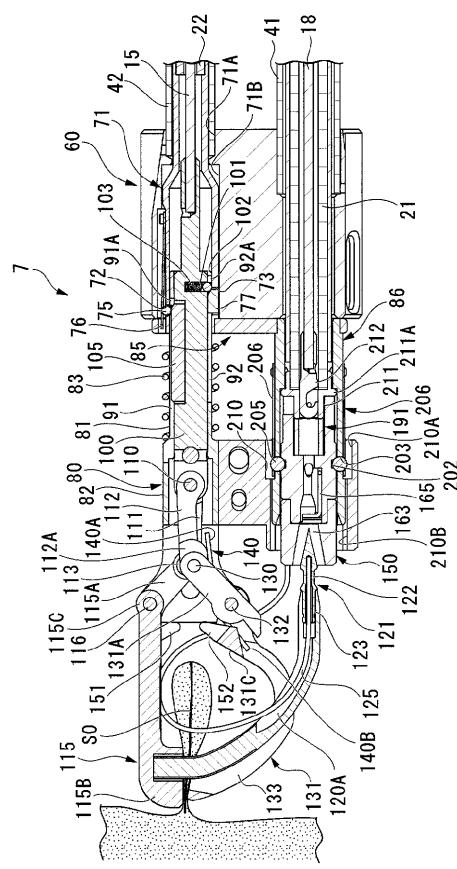


【図21】




【図22】




【図23】

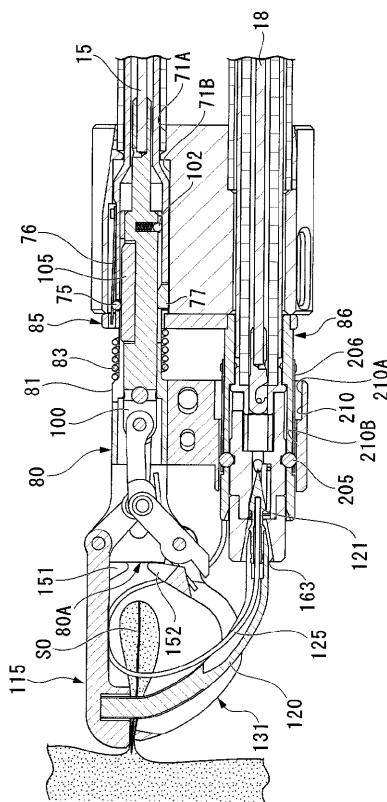


【図26】

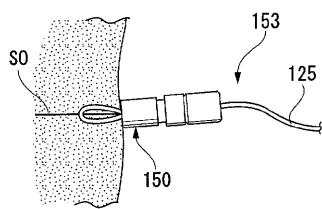


【図28】

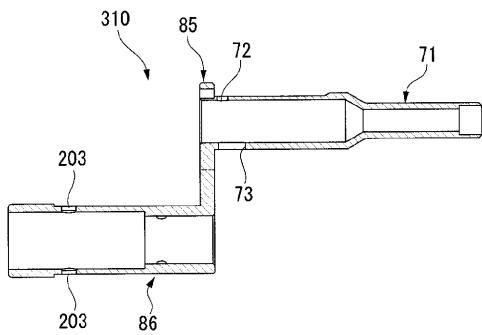


【図27】

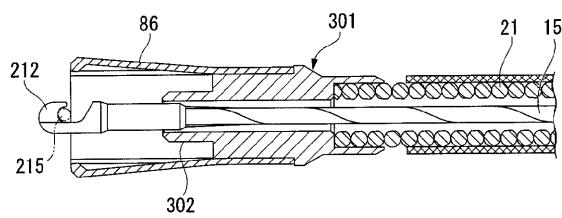


【図29】

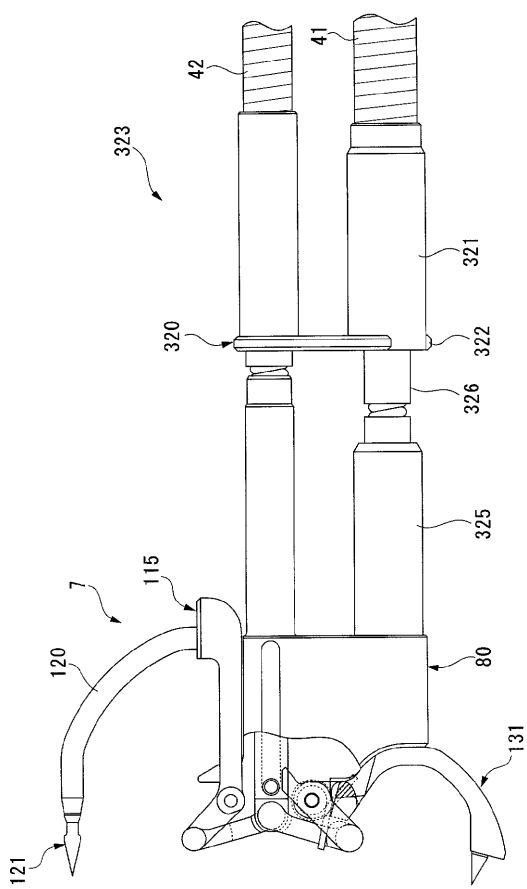


【図30】

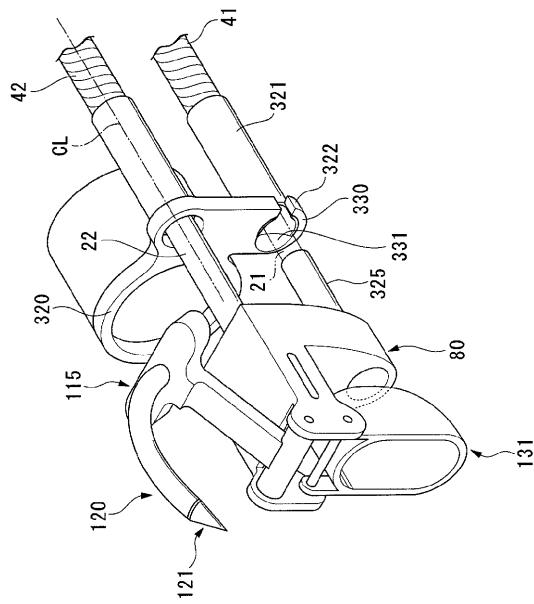


【図31】

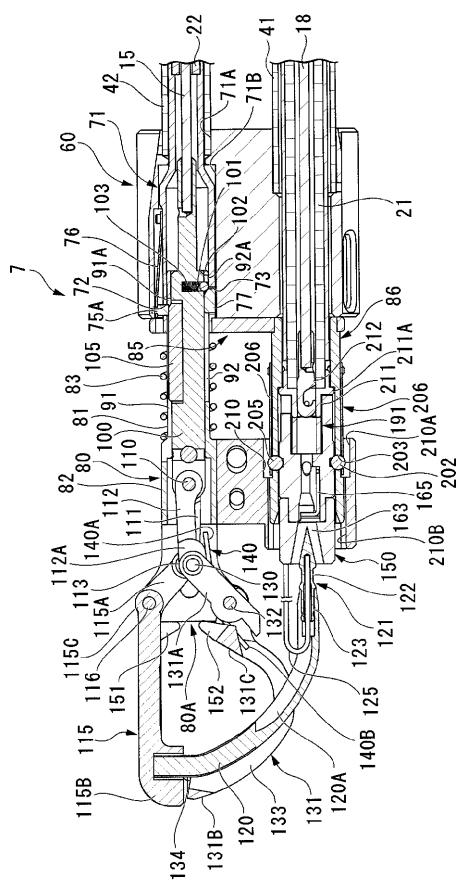


【 図 3 2 】

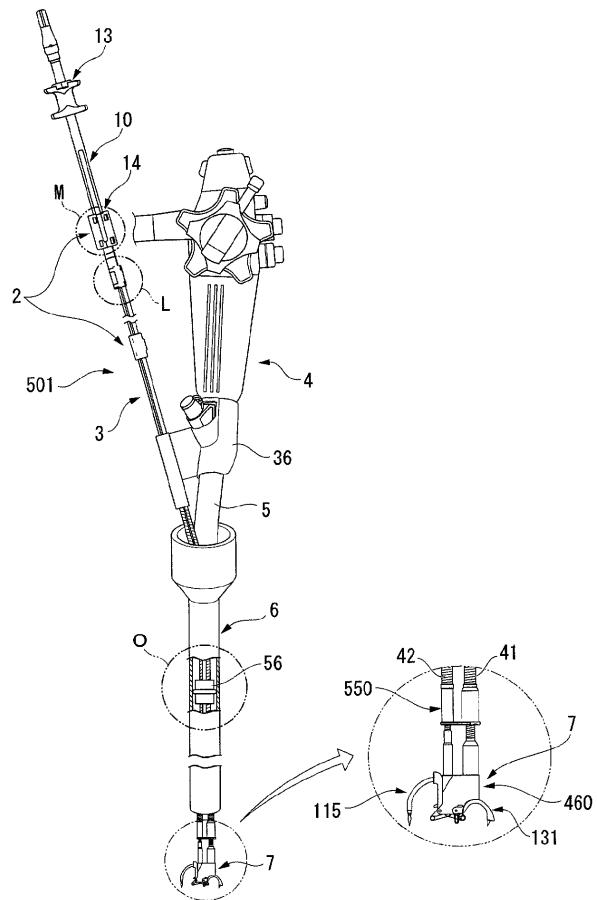


【図3-3】

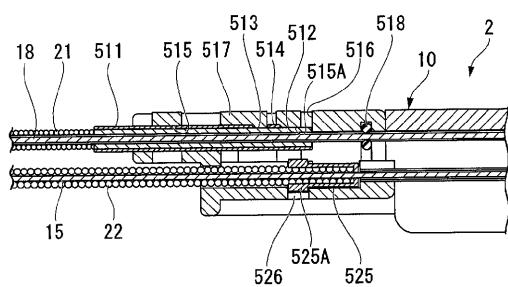


【 図 3 5 】

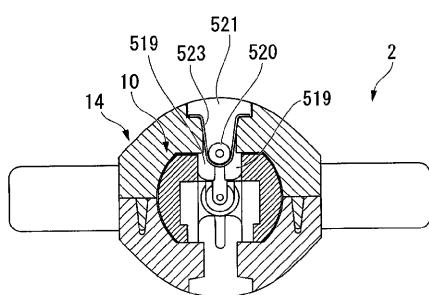


【図3-4】

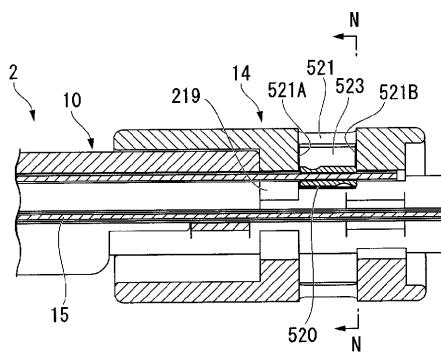


【図36】

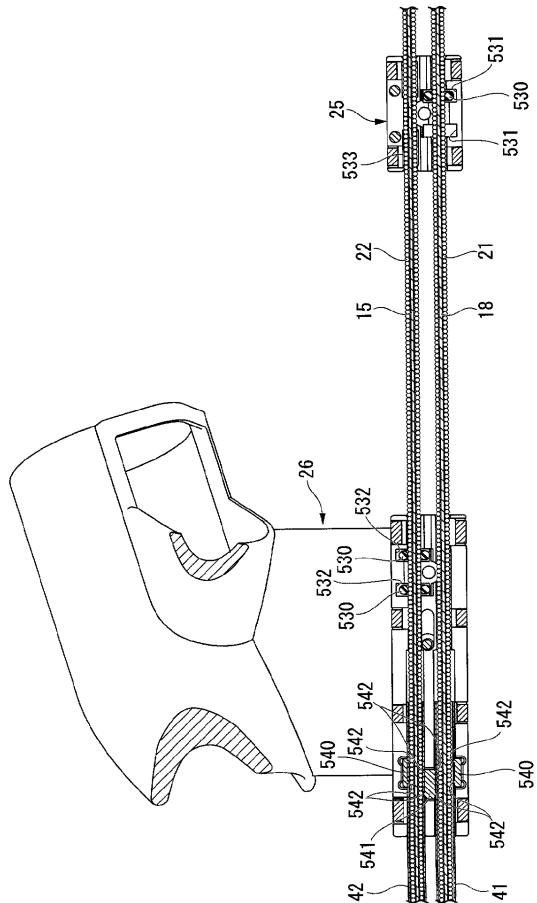


【 図 3 7 】

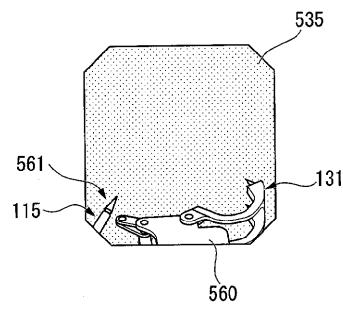


【図38】

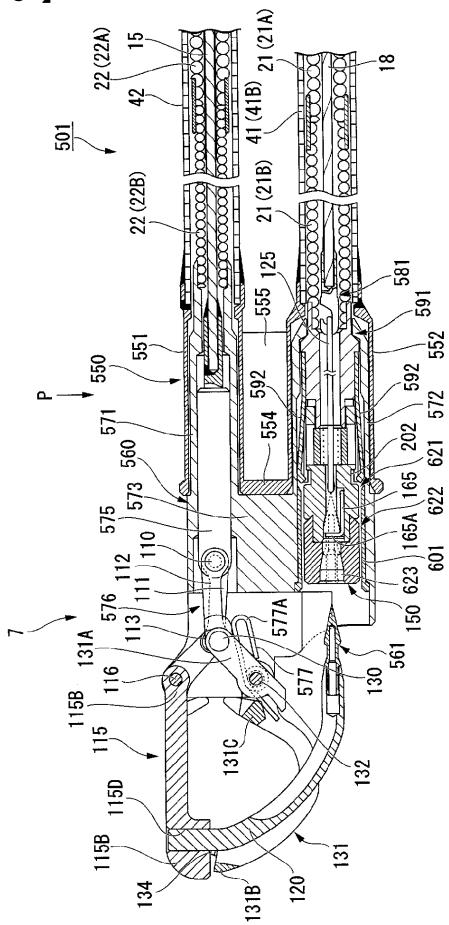


【 図 3 9 】

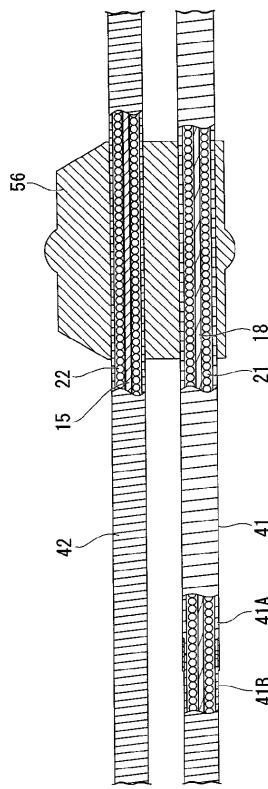


【図40】

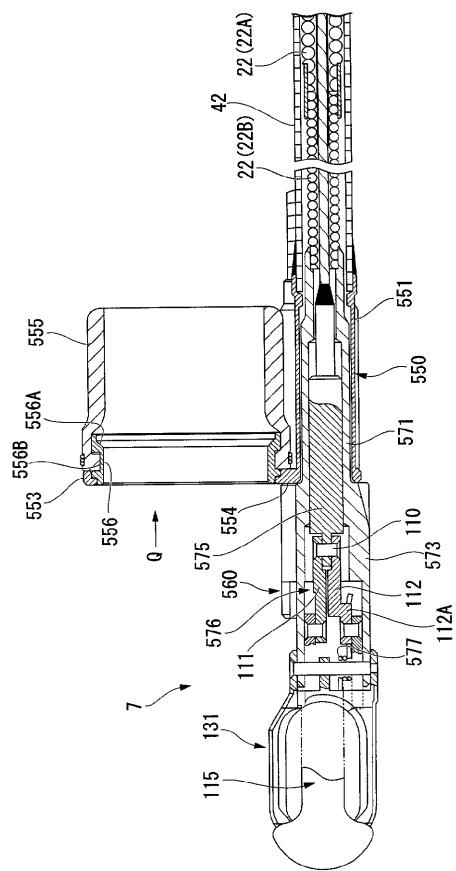


【図41】

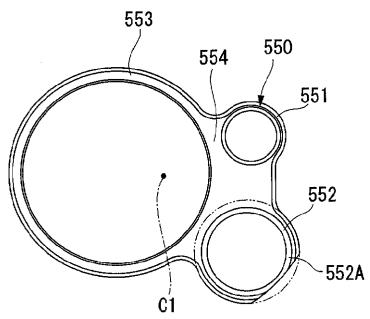


【図42】

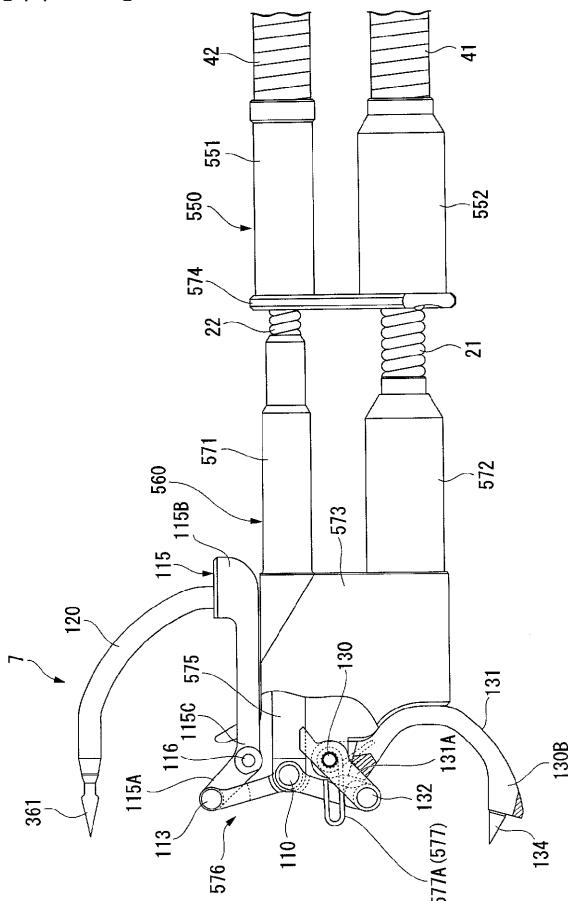


【図43】

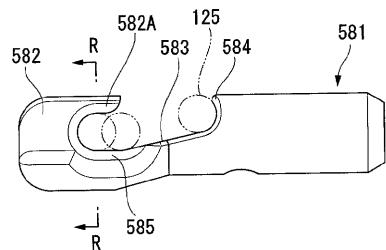


【図44】




【 図 4 5 】

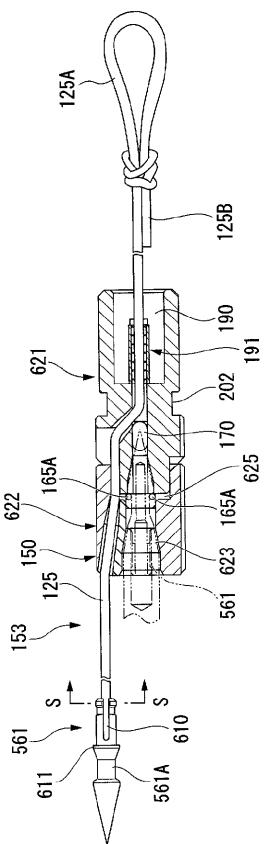


【 図 4 6 】




【図47】




【 図 4 8 】

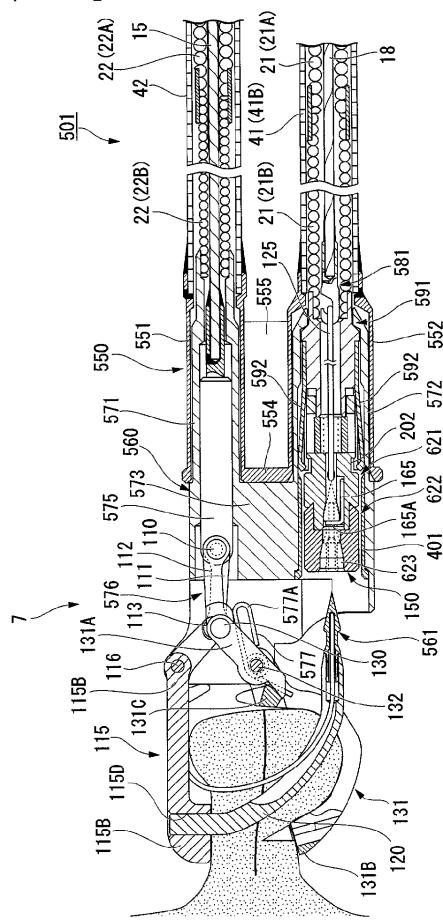


【 図 4 9 】

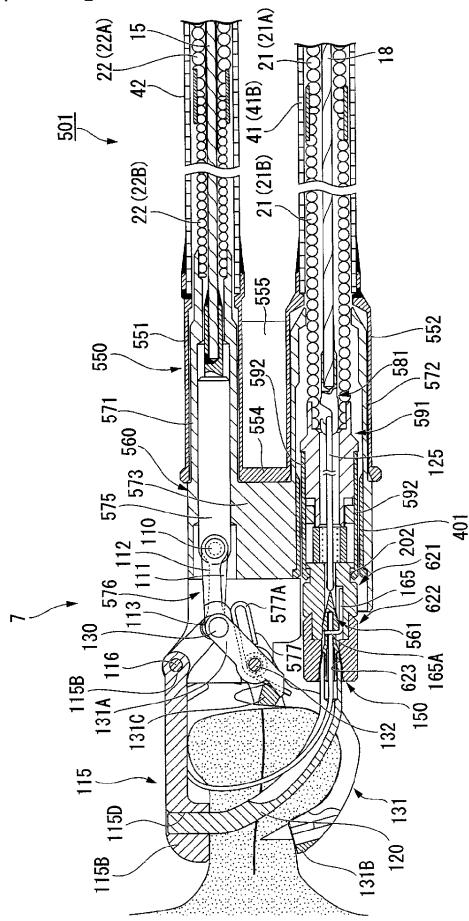


【図50】

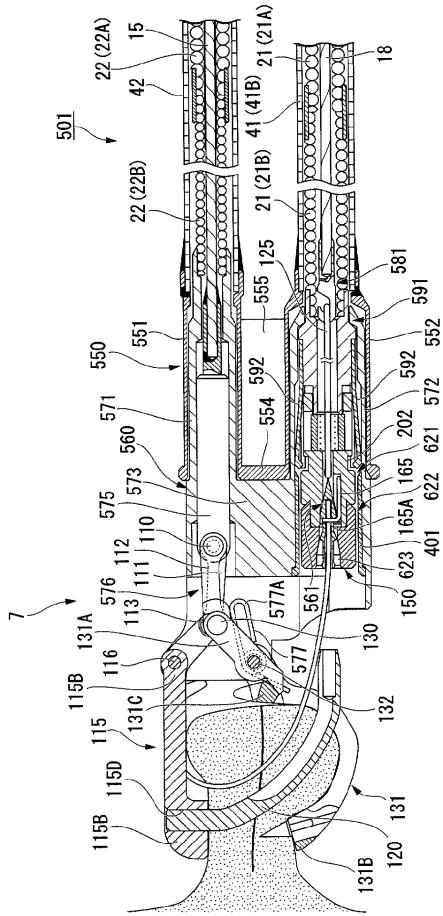


【図52】

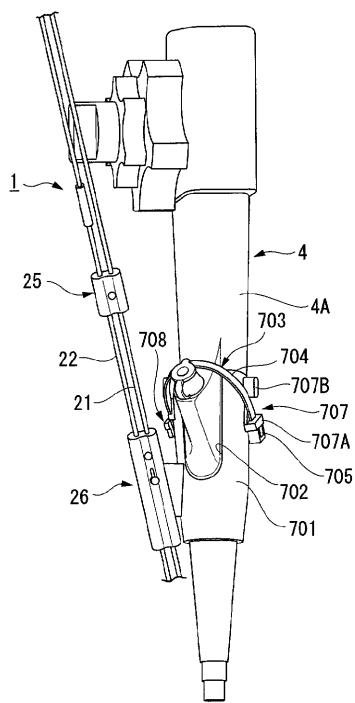


【 図 5 1 】

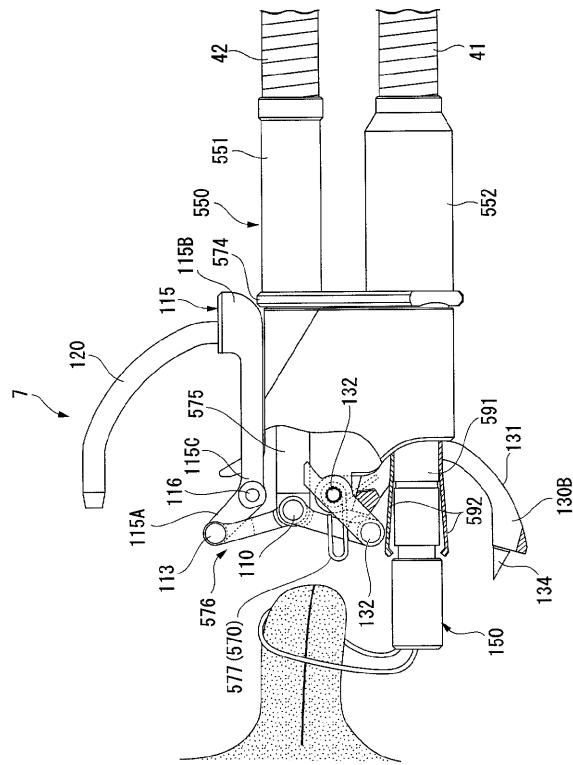


【図53】

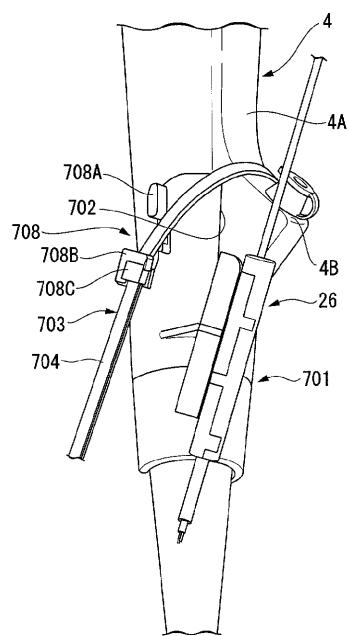


【図54】

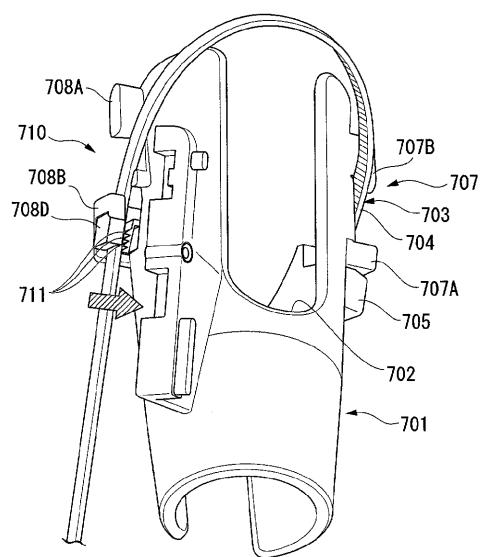


【図55】

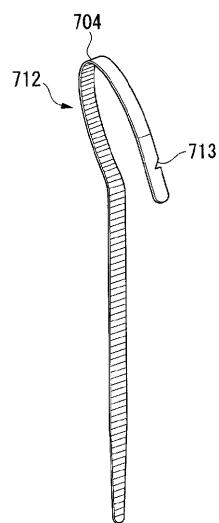


【図56】

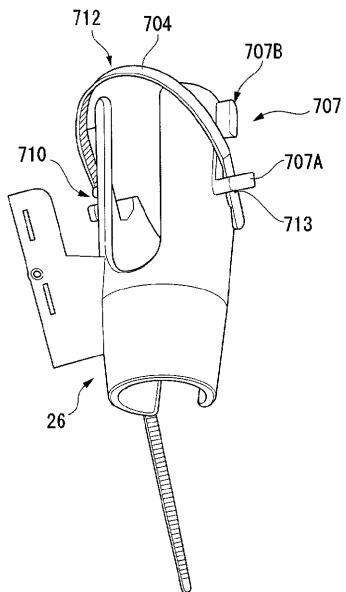


【図57】

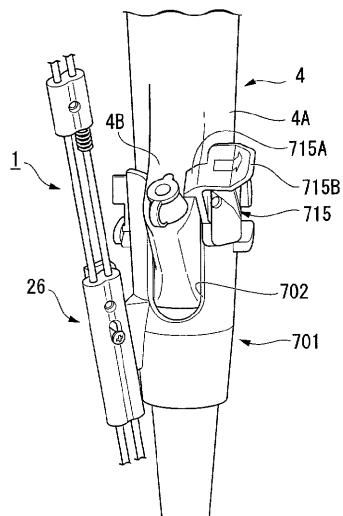


【 図 5 8 】

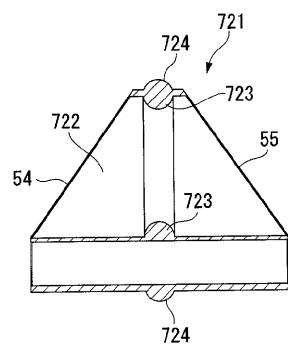


【図59】

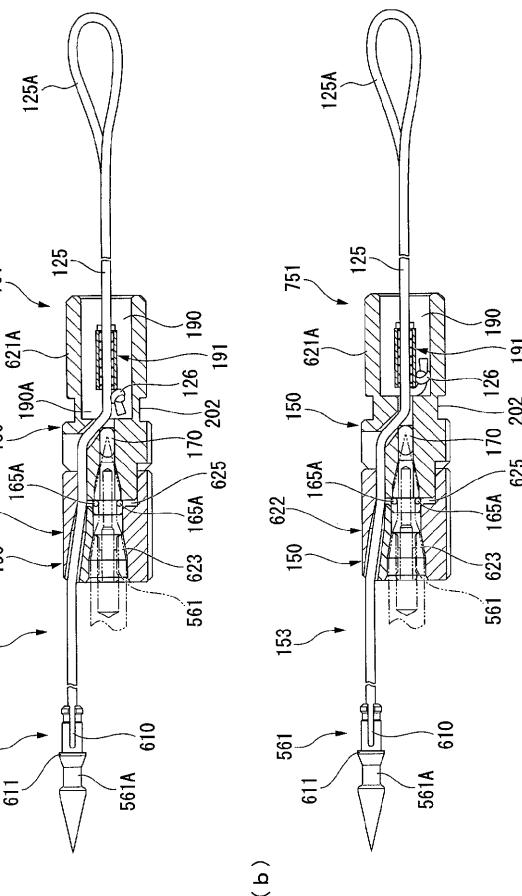


【図 60】

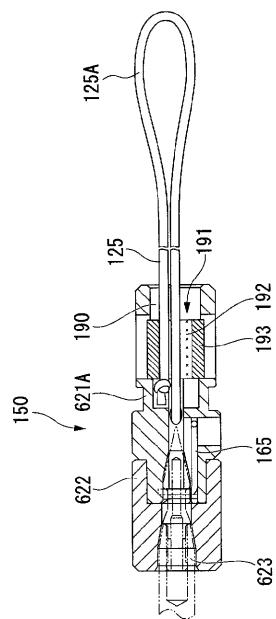


【 図 6 1 】

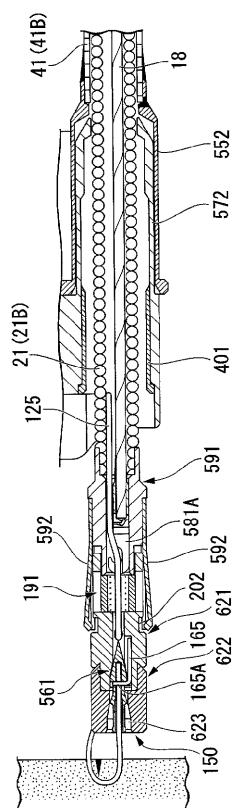


【図62】

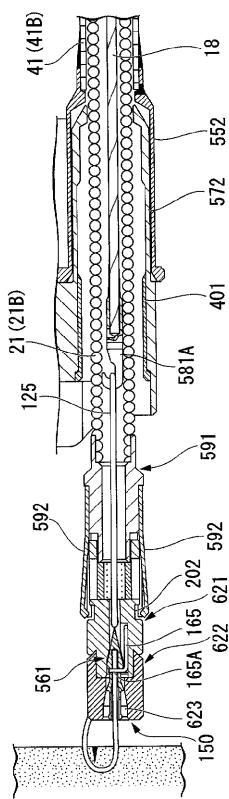


【 図 6 3 】

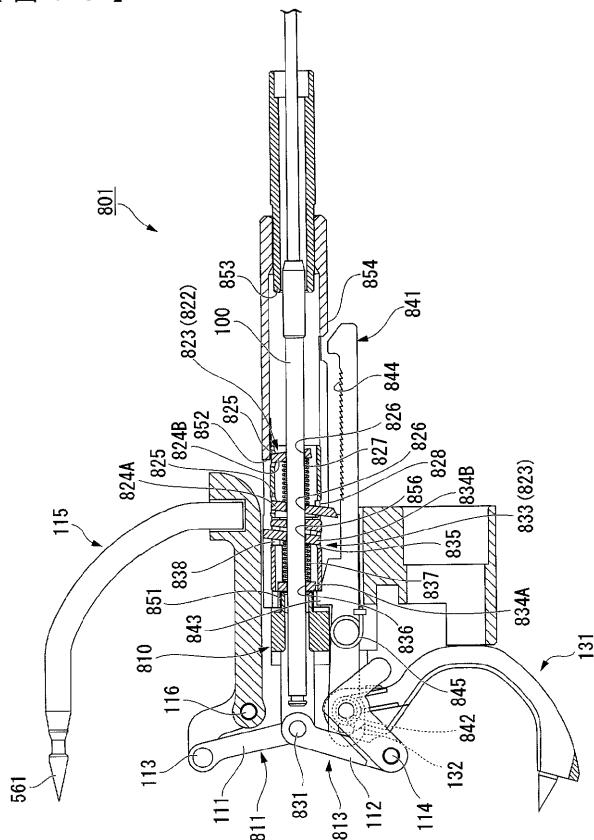


【図64】

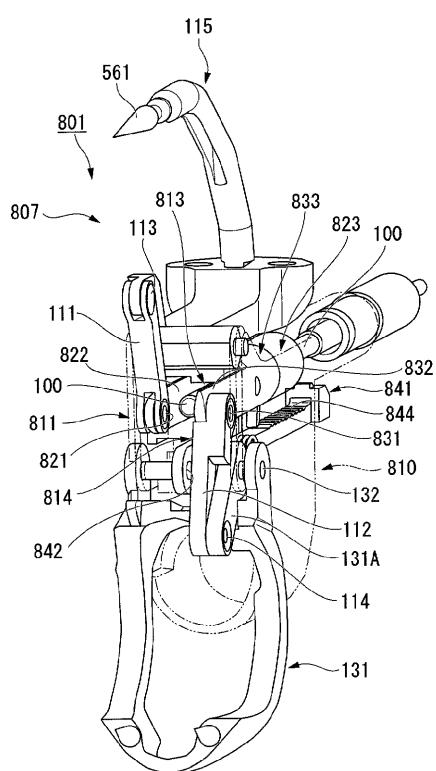


【図65】

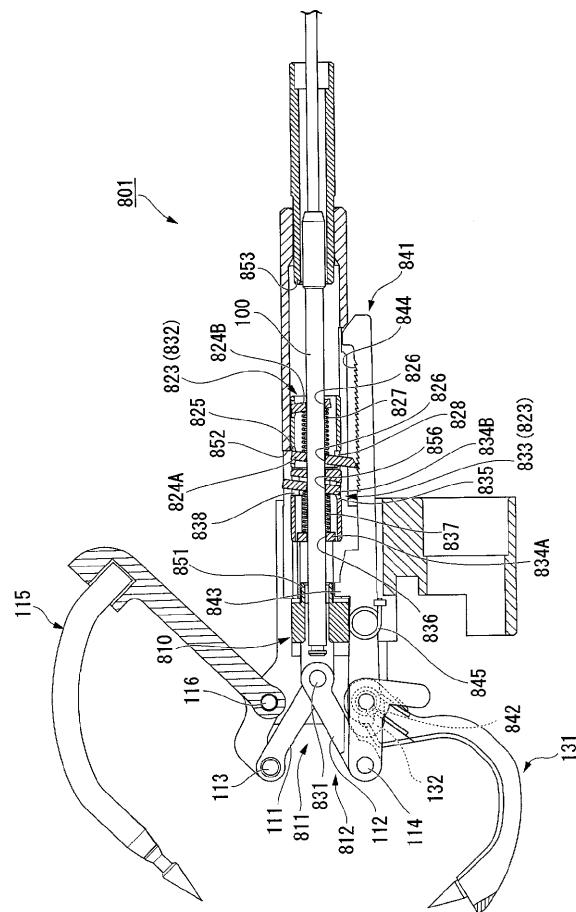


【図66】

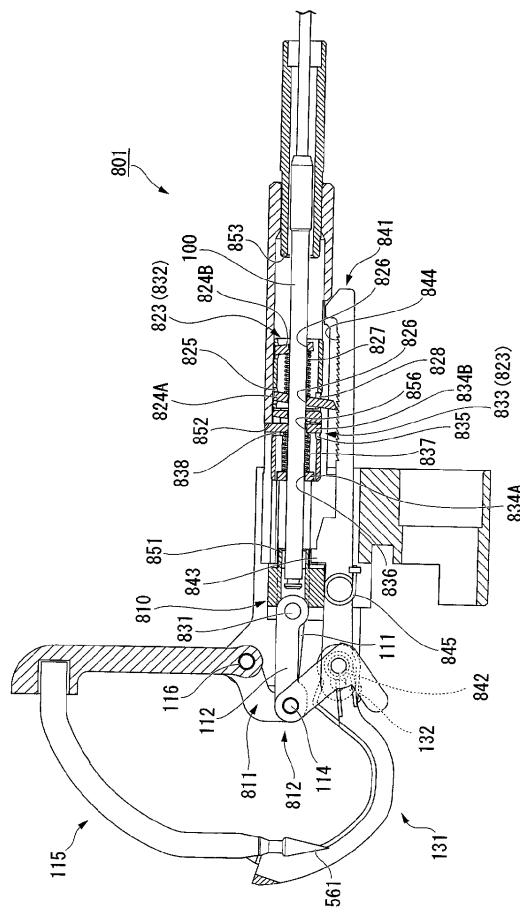


【図67】

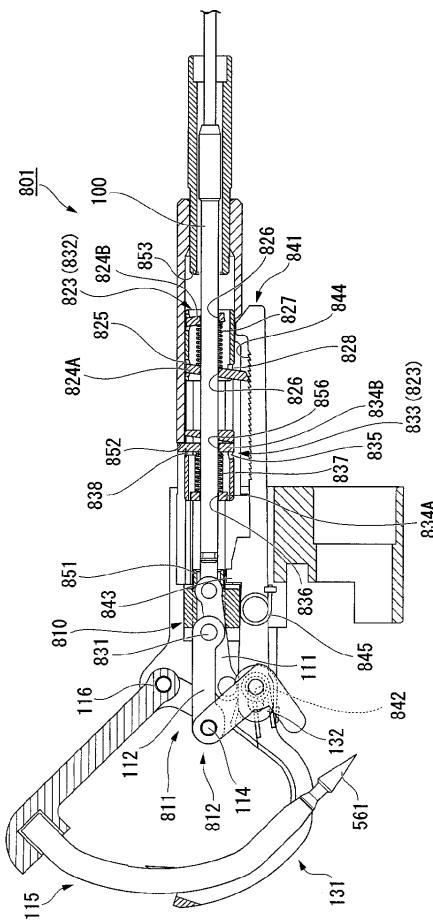


【図68】

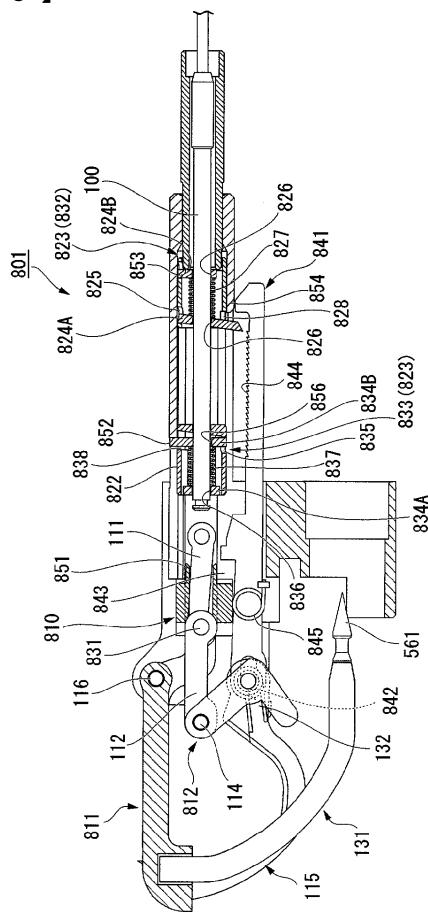


【図69】

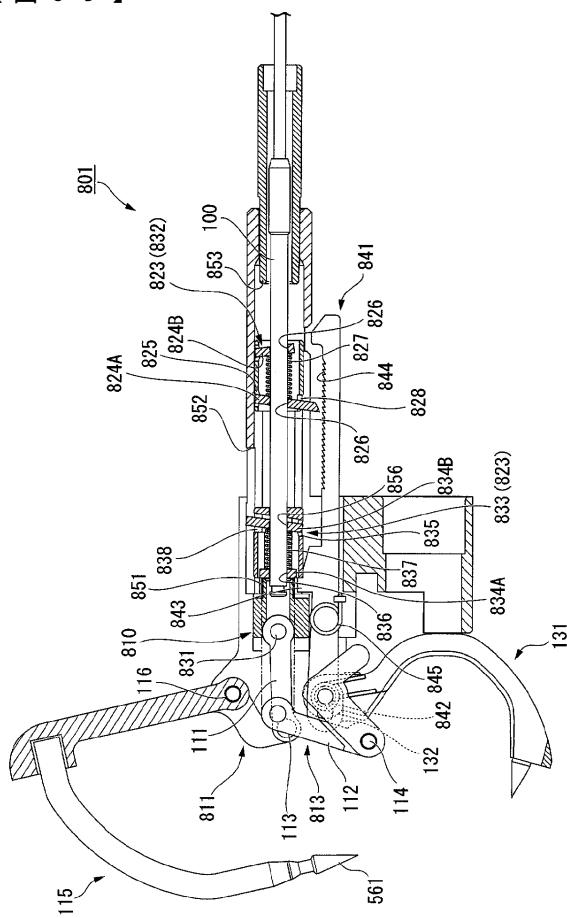


【図70】

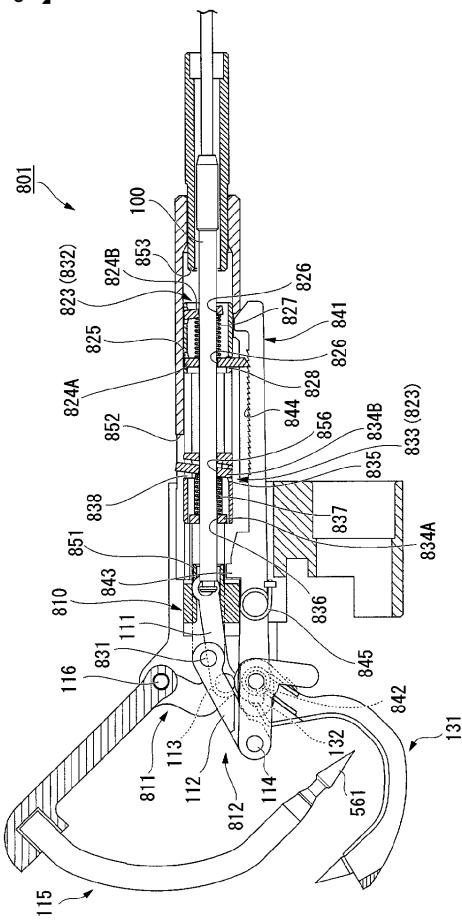


【図71】

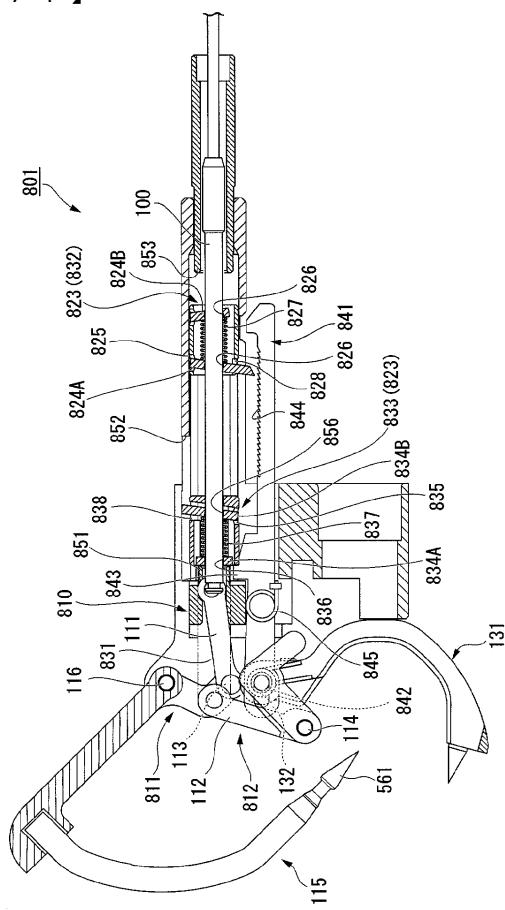


【図72】

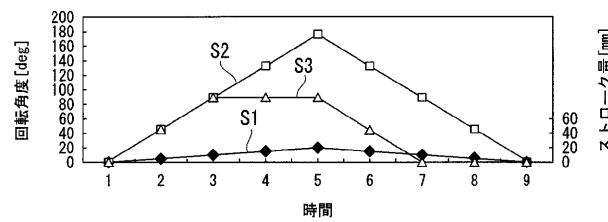


【図74】

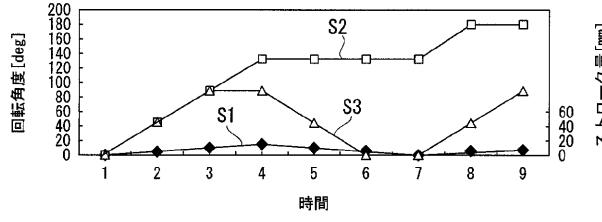


【図73】

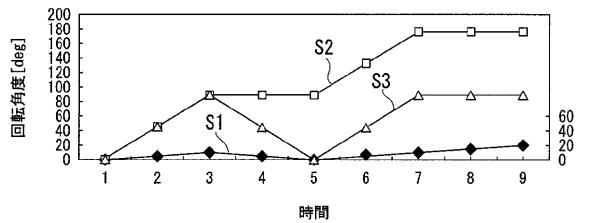


【図75】

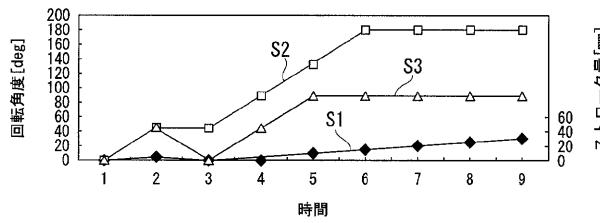


【図76】




【 図 7 7 】




【図78】




【 四 8 2 】

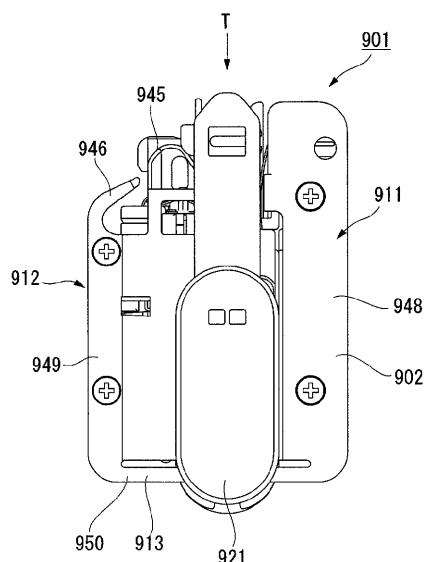


【図 8-3】

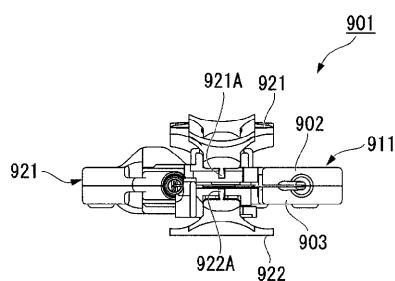


【 図 7 9 】

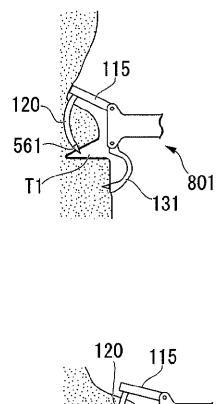


【 図 8 0 】




【 図 8 1 】




【 8 4 】

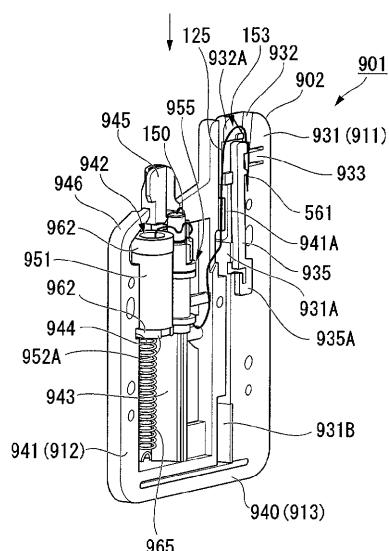


【図85】

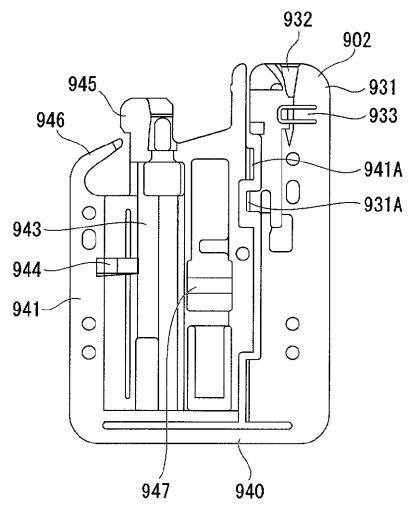


【図86】

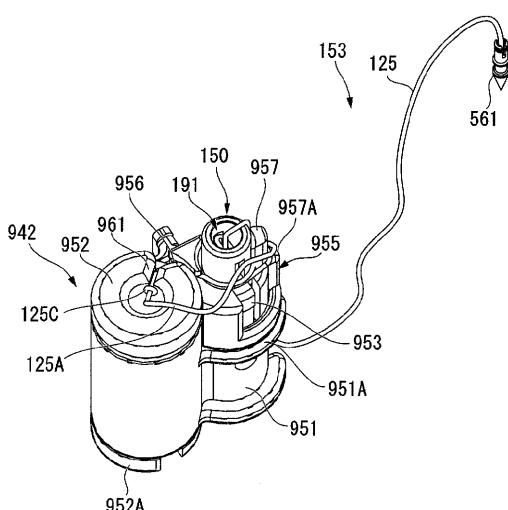


【図87】




【図88】

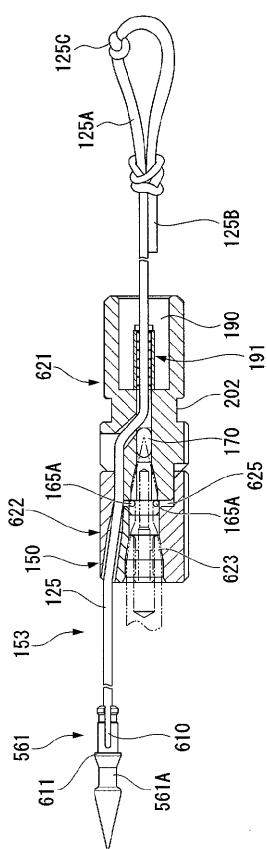


【図89】

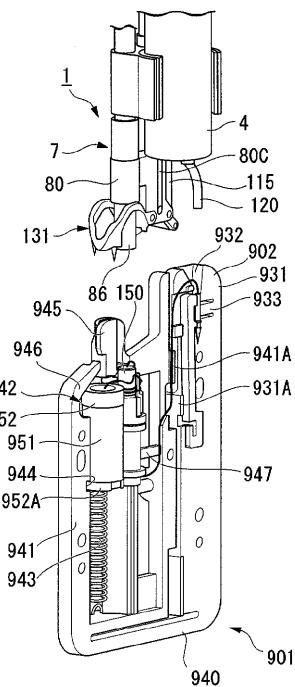


【図90】

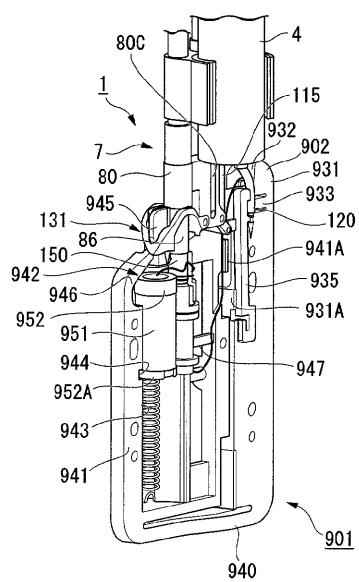


【図91】

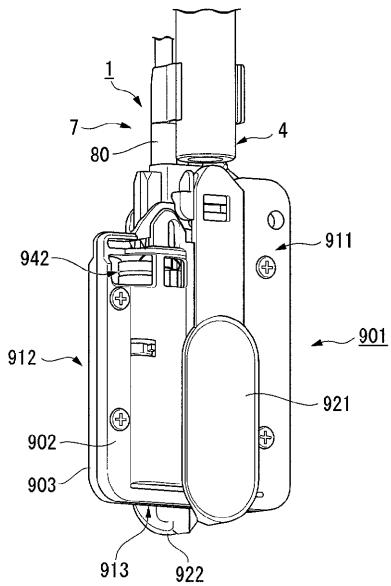


【図92】

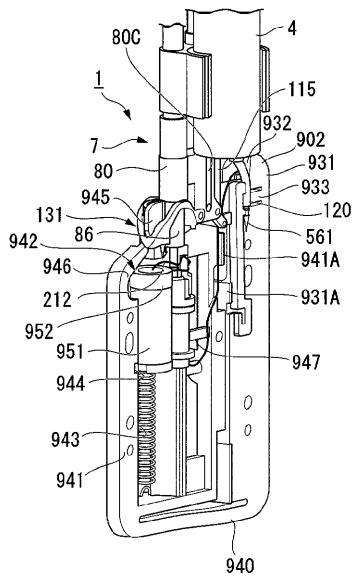


【図93】

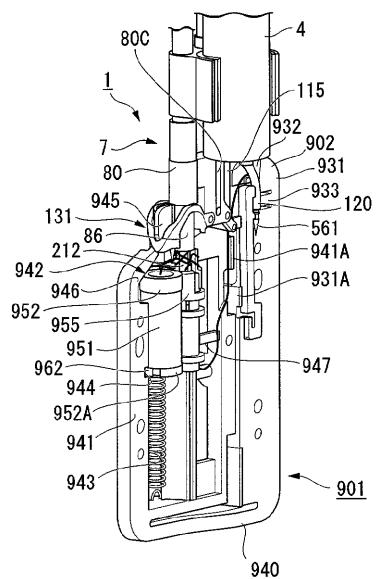


【 図 9 4 】

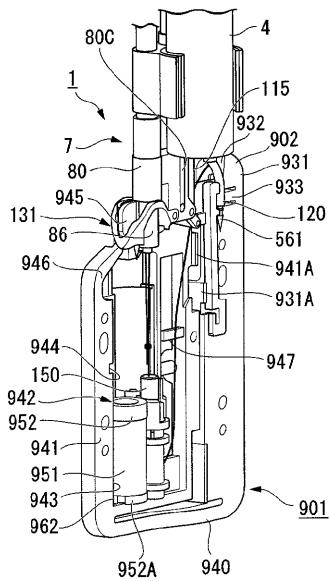


【 図 9 5 】

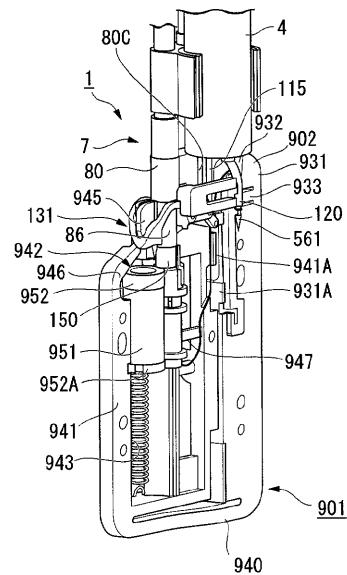


【図96】

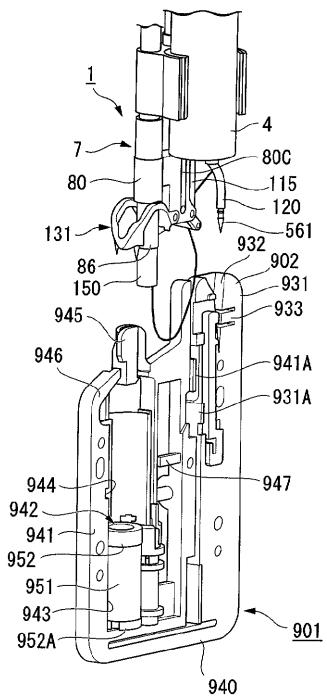


【 図 9 7 】

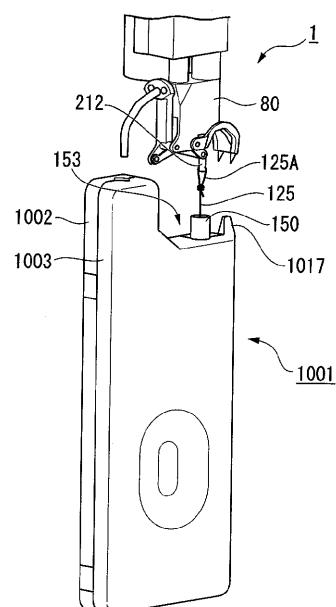


【図98】

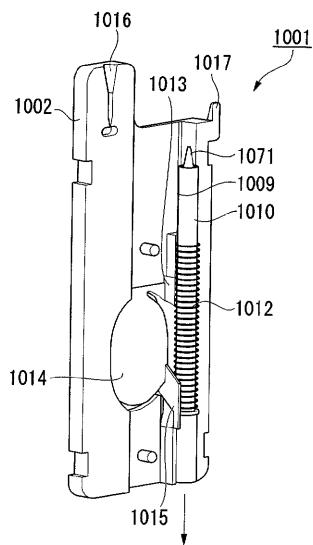


【図99】

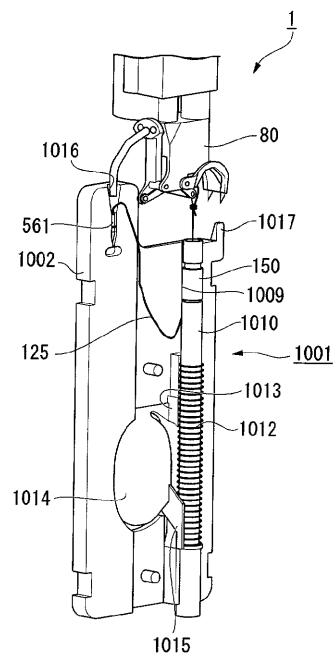


【図100】

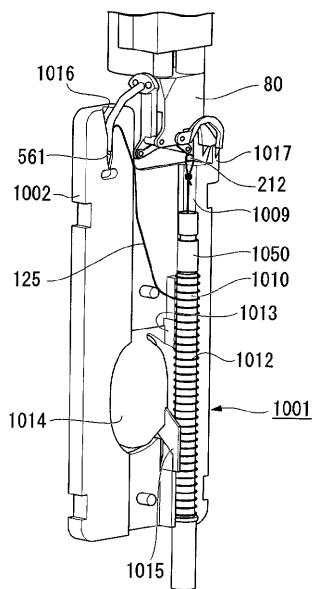


【図101】

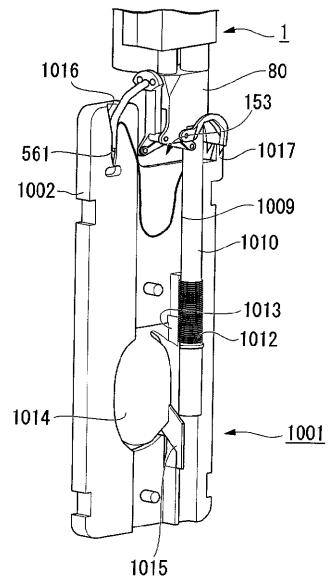

【図 102】

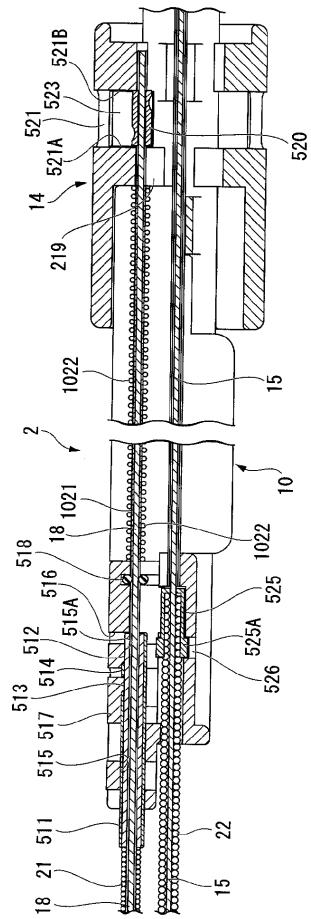

【図 103】

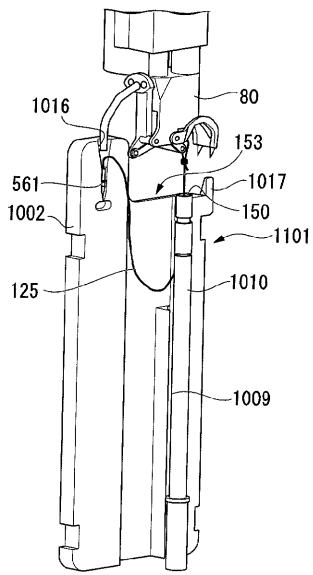

フロントページの続き

(72)発明者 竹本 昌太郎

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパスメディカルシステムズ株式会社内

(72)発明者 山本 哲也

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパスメディカルシステムズ株式会社内

(72)発明者 橋本 達銳

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパスメディカルシステムズ株式会社内

(72)発明者 松野 清孝

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリンパスメディカルシステムズ株式会社内

F ターム(参考) 4C060 AA04 BB01 GG22 GG29 GG40 MM24

4C061 GG15 GG22 HH56 JJ01

专利名称(译)	内窥镜治疗仪和留置仪器和安装装置		
公开(公告)号	JP2007185517A	公开(公告)日	2007-07-26
申请号	JP2007004561	申请日	2007-01-12
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯医疗株式会社		
申请(专利权)人(译)	オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
[标]发明人	竹本昌太郎 山本哲也 橋本達銳 松野清孝		
发明人	竹本 昌太郎 山本 哲也 橋本 達銳 松野 清孝		
IPC分类号	A61B17/28 A61B17/12 A61B17/00 A61B1/00		
CPC分类号	A61B17/0469 A61B17/0482 A61B17/0487 A61B17/29 A61B2017/0454 A61B2017/0464 A61B2017/06028		
FI分类号	A61B17/28.310 A61B17/12.320 A61B17/00.320 A61B1/00.334.D A61B1/00.620 A61B1/01.511 A61B1/018.515 A61B17/04 A61B17/06 A61B17/12 A61B17/28		
F-TERM分类号	4C060/AA04 4C060/BB01 4C060/GG22 4C060/GG29 4C060/GG40 4C060/MM24 4C061/GG15 4C061/GG22 4C061/HH56 4C061/JJ01 4C160/BB01 4C160/BB12 4C160/BB18 4C160/GG24 4C160/GG29 4C160/GG30 4C160/MM32 4C160/MM43 4C160/MM53 4C160/NN01 4C160/NN04 4C160/NN09 4C160/NN14 4C161/GG15 4C161/GG22 4C161/HH56 4C161/JJ01		
代理人(译)	塔奈澄夫 正和青山		
优先权	11/331962 2006-01-13 US		
其他公开文献	JP4981459B2		

摘要(译)

要解决的问题：为内窥镜的操作设备提供改进的可操作性。

ŽSOLUTION：操作部分7安装在插入人体的插入部分的尖端处，并且包括一对止动件115,131，由枢转轴支撑的尖端盖80，以枢转该对中的至少一部分为了能够自由地打开和关闭另一部分的力钳115,131，用于相对且可移动地将尖端盖80保持在插入部分的尖端方向和基端方向上的尖端保持部分71，用于销75的销75当打开压力杆115,131以保持对象时，通过将尖端盖80接合到尖端保持部71来防止相对移位；以及安装在用于打开和关闭压力杆115,131的操作线15上的释放部件105当至少部件115,131关闭时，释放尖端盖80和由销75接合的尖端保持部71的接合。Ž

