

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2008-170363

(P2008-170363A)

(43) 公開日 平成20年7月24日(2008.7.24)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO 1 N 21/17 (2006.01)	GO 1 N 21/17 6 3 0	2 F 0 6 8
A 6 1 B 1/00 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 3 0 0 D	2 G 0 5 9
A 6 1 B 10/00 (2006.01)	A 6 1 B 10/00 E	4 C 0 6 1
GO 1 B 17/06 (2006.01)	GO 1 B 17/06	4 C 6 0 1
A 6 1 B 8/00 (2006.01)	A 6 1 B 8/00	

審査請求 未請求 請求項の数 26 O L (全 41 頁)

(21) 出願番号 特願2007-5678 (P2007-5678)
 (22) 出願日 平成19年1月15日 (2007.1.15)

(71) 出願人 304050923
 オリンパスメディカルシステムズ株式会社
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
 (74) 代理人 100076233
 弁理士 伊藤 進
 (72) 発明者 五十嵐 誠
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ
 リンパスメディカルシステムズ株式会社内
 Fターム(参考) 2F068 AA38 CC07 DD11 FF03 FF28
 GG07 GG09 JJ12 KK14 LL25
 QQ10 QQ12 QQ31

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 被検体情報分析装置、内視鏡装置及び被検体情報分析方法

(57) 【要約】

【課題】被検体における検査対象部位の光の散乱情報を含む被検体の特性情報を容易に取得するための被検体情報分析装置、内視鏡装置及び被検体情報分析方法を提供する。

【解決手段】超音波発生部2は、所定の超音波送信軸に沿って被検体に超音波を発生し、照明光発生部3は、超音波が伝達される被検体内における検査対象部位に到達するように照明光を発生する。検査対象部位において周波数変調された光を反射光受光部4で受光し、その受光信号から周波数情報抽出部5による周波数情報の抽出、散乱情報抽出部6による検査対象部位に対する光の散乱情報の抽出等を経て、被検体の検査対象部位に対応する被検体の特性情報を生成する。

【選択図】図1

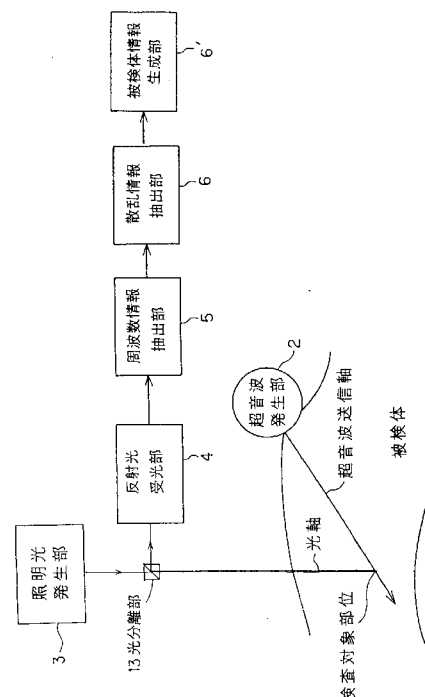

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、
前記超音波発生手段によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における
検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記照明光が到達した前記検査対象部位からの周波数変調された光を受光する受光手段
と、

前記周波数変調された光の周波数情報を光学的又は電氣的に抽出する周波数情報抽出手
段と、

前記周波数情報抽出手段で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記
検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達し
た前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、
を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

10

【請求項 2】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、
前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記超音波発生手段によ
って発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照
明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記照明光が到達した前
記検査対象部位から反射される光を受光可能に設けられた反射光受光手段と、

前記反射光受光手段で受光された受光信号から得られる周波数情報を抽出する周波数情
報抽出手段と、

前記周波数情報抽出手段で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記
検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達し
た前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、
を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

20

【請求項 3】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、
前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記超音波発生手段によ
って発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照
明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記照明光が到達した前
記検査対象部位から反射される光を受光可能に設けられた反射光受光手段と、

前記照明光発生手段によって発生される照明光と前記反射光受光手段によって受光され
た反射光とを干渉させて周波数情報を抽出する周波数情報抽出手段と、

前記周波数情報抽出手段で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記
検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達し
た前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、
を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

30

40

【請求項 4】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、
前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記超音波発生手段によ
って発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照
明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記照明光が到達した前
記検査対象部位から反射される光を受光可能に設けられた反射光受光手段と、

前記反射光受光手段で受光された反射光を分光する分光手段と、

50

前記分光手段で分光された分光結果に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

【請求項 5】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記超音波発生手段によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記照明光が到達した前記検査対象部位から反射される光を受光可能に設けられた反射光受光手段と、

前記反射光受光手段で受光した受光信号を周波数変換して周波数成分を抽出する周波数成分抽出手段と、

前記周波数成分抽出手段で抽出された周波数成分に基づき前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

【請求項 6】

前記周波数成分抽出手段は、フーリエ変換により周波数成分を抽出するフーリエ変換手段を有することを特徴とする請求項 5 記載の被検体情報分析装置。

【請求項 7】

前記周波数成分抽出手段は、ウェーブレット変換により周波数成分を抽出するウェーブレット変換手段を有することを特徴とする請求項 5 記載の被検体情報分析装置。

【請求項 8】

前記超音波発生手段は、前記被検体の所定の位置に焦点を結ぶ焦点調整部を有することを特徴とする請求項 1 ないし 7 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 9】

前記照明光発生手段は、照明光を前記超音波の照射される位置内の所定の位置に収束させる照明光収束部を有することを特徴とする請求項 1 ないし 8 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 10】

前記被検体情報生成手段によって生成された前記被検体の特性情報に基づいて画像を形成する画像形成手段を有することを特徴とする請求項 1 ないし 9 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 11】

前記超音波発生手段は、前記超音波をパルス波として発生させるパルス超音波発生部を有することを特徴とする請求項 1 ないし 10 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 12】

前記照明光発生手段は、前記照明光をパルス光として照射させるパルス光発生部を有することを特徴とする請求項 1 ないし 10 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 13】

前記照明光発生手段による照明光の照射位置が少なくとも一次元的に変化するように走査させる走査手段を有することを特徴とする請求項 1 ないし 12 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 14】

前記光の散乱情報は、前記検査対象部位の複素屈折率の実部に相当する情報であることを特徴とする請求項 1 ないし 13 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 15】

前記光の散乱情報は、非弾性散乱情報であることを特徴とする請求項 1 ないし 13 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 16】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生部、前記超音波発生部によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生部、前記照明光が到達した検査対象部位から反射される周波数変調された光を受光可能に設けられた反射光受光部と、

前記反射光受光部で受光された受光信号に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部と、

前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成部と、

を有することを特徴とする内視鏡装置。

【請求項 17】

前記照明光発生部は、前記超音波発生部の周辺に配置され、

前記情報抽出部は、前記反射光受光部で受光された受光信号から得られる周波数情報を抽出する周波数情報抽出部と、前記周波数情報抽出部で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部とを有し、

前記被検体情報生成部は、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成することを特徴とする請求項 16 に記載の内視鏡装置。

【請求項 18】

前記照明光発生部は、前記超音波発生部の周辺に配置され、

前記情報抽出部は、前記照明光発生部によって発生される照明光と前記反射光受光部によって受光された反射光とを干渉させて周波数情報を抽出する周波数情報抽出部と、前記周波数情報抽出部で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部と、

前記被検体情報生成部は、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成することを特徴とする請求項 16 に記載の内視鏡装置。

【請求項 19】

前記照明光発生部は、前記超音波発生部の周辺に配置され、

前記情報抽出部は、前記反射光受光部で受光した受光信号を周波数変換して周波数成分を抽出する周波数成分抽出部と、前記周波数成分抽出部で抽出された周波数成分に基づき前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部とを有し、

前記被検体情報生成部は、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成することを特徴とする請求項 14 に記載の内視鏡装置。

【請求項 20】

前記周波数成分抽出部は、フーリエ変換により周波数成分を抽出するフーリエ変換部を有することを特徴とする請求項 17 記載の内視鏡装置。

【請求項 21】

前記光の散乱情報は、前記検査対象部位の複素屈折率の実部に相当する情報であることを特徴とする請求項 16 ないし 20 の何れかに記載の内視鏡装置。

【請求項 22】

前記光の散乱情報は、非弾性散乱情報であることを特徴とする請求項 16 ないし 20 の何れかに記載の内視鏡装置。

【請求項 23】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生する超音波発生工程と、

前記超音波発生工程によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生する照明光発生工程と、

前記照明光が到達した前記検査対象部位からの周波数変調された光を受光する受光工程と、

前記周波数変調された光の周波数情報を光学的又は電氣的に抽出する周波数情報抽出工程と、

前記周波数情報抽出工程で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出工程と、

前記散乱情報抽出工程によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成工程と、
を具備したことを特徴とする被検体情報分析方法。

【請求項 2 4】

超音波発生部により所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生する超音波発生工程と、

照明光発生部により前記超音波の照射される位置内の所定の位置に到達する照明光を発生する照明光発生工程と、

反射光受光部によって前記照明光が到達した位置に対応する部位から反射される光を受光する反射光受光工程と、

前記反射工程受光工程で受光された受光信号から得られる周波数情報を抽出する周波数情報抽出工程と、

前記周波数情報抽出工程で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出工程と、

前記散乱情報抽出工程で抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成工程と、
を有することを特徴とする被検体情報分析方法。

【請求項 2 5】

前記光の散乱情報は、前記検査対象部位の複素屈折率の実部に相当する情報であることを特徴とする請求項 2 3 または 2 4 に記載の被検体情報分析方法。

【請求項 2 6】

前記光の散乱情報は、非弾性散乱情報であることを特徴とする請求項 2 3 または 2 4 に記載の被検体情報分析方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、超音波を利用して被検体を光学的に分析する被検体情報分析装置、内視鏡装置及び被検体情報分析方法に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、生体の光断層イメージングを実現するものとして、光CTや光コヒーレンス断層影像法 (Optical Coherence Tomography: 以下OCT)、
光音響断層影像法等、様々な技術が提案されている。

光CTは生体内部での光散乱の影響が比較的弱い波長域700nm~1200nmの近赤外光を利用するため、粘膜下数cmまでの生体深部の断層像を得ることができる。

また、干渉を利用したOCTは2mm程度の深さまでの生体断層イメージを高分解能(μm ~十数 μm)かつ短時間で取得することが可能である。OCTは眼科領域での網膜疾患診断において既に実用化されている技術であり、その医学的関心度は非常に高い。

【0003】

光CTは深部の情報は得られるが、空間分解能は数mm程度と非常に低い。一方、OCTは生体粘膜下約2mm以深を観察すること、更に、癌等の腫瘍組織に対して良好な画質を得ることは難しい。

10

20

30

40

50

これは、生体深部及び腫瘍組織における、血液の吸収や強い散乱の影響により、光のコヒーレンス性が著しく乱れるためである。

一方、日坂らによる非特許文献1において、超音波と光を生体へ照射し、生体内にてパルス超音波により変調された照射光を検出することにより、粘膜表層以下1cm程度の吸収の光イメージングを試みた例が報告されている。

また、特許文献1の特開2005-224399号公報においても、超音波パルスと光を生体に照射し、生体内にてパルス超音波により変調された照射光を検出することにより、粘膜表層以下の吸収光イメージングを得る装置が開示されている。

【特許文献1】特開2005-224399号公報

【特許文献2】特開2000-197635号公報

【特許文献3】特開2000-88743号公報

【非特許文献1】日坂真樹、杉浦忠男、河田聡、“パルス超音波と光の相互作用を利用した散乱体深部の光断層像観察”、光学29、pp631-634、2000

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかし、上記特許文献1、特許文献3や非特許文献1の先行例は、あくまで吸収の光イメージングに特化されたものであり、組織の構成や構造の変化から生起される散乱情報を得ようとする技術ではない。

一方、生体組織における腫瘍の癌化に伴う核内クロマチンの濃縮状態や核の空間分布変化といった組織の構造的変化は、特に光散乱特性の変化を引き起こす。このため、癌組織等に関連する組織の構造変化に相関性が高い散乱情報が得られることが望まれる。

なお、組織の構造変化に相関性が高い光散乱情報は、その組織部位における複素屈折率の実部に由来し、一方複素屈折率の虚部は吸収に関連するため、複素屈折率の実部と虚部の変化を捉えることにより、散乱特性及び吸収特性に関する2次元、若しくは3次元情報が得られることになる。

【0005】

一方、特許文献2の特開2000-197635号公報には、生体に超音波を集束するように照射し、かつレーザ等複数の光源から様々な方向から光を照射して、超音波が集束された領域で散乱された光を生体の周囲に配置された複数の検出器で検出することにより、散乱係数と吸収係数を記録する方法が拡散型の波動方程式に基づいて開示されている。

この特許文献2の従来例は、光源及び検出器を複数用いるようにしているので、これらを測定できる状態に設置するための作業に時間がかかる点や、検出器以後での信号処理系において検出器の配置に対応した調整が必要になることが予想される点がある等、ユーザに負担をかける欠点がある。

【0006】

また、この従来例は、光源若しくは検査対象部位を走査してその位置を変更した場合における検出器で適切に受光するように制御する制御手段が設けていないため、画像化された情報等を取得することが簡単に行えない欠点がある。

このため、被検体としての生体内の深部側となる検査対象部位の場合にも高い空間分解能を確保して複素屈折率の実部の情報を含む被検体の特性情報を生成することができる装置及び方法が望まれる。

【0007】

(発明の目的)

本発明は上述した点に鑑みてなされたもので、被検体における検査対象部位の光の散乱情報を含む被検体の特性情報を容易に取得するための被検体情報分析装置、内視鏡装置及び被検体情報分析方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明に係る被検体情報分析装置は、所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、

前記超音波発生手段によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記照明光が到達した前記検査対象部位からの周波数変調された光を受光する受光手段と、

前記周波数変調された光の周波数情報を光学的又は電氣的に抽出する周波数情報抽出手段と、

前記周波数情報抽出手段で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、
を具備したことを特徴とする。

【0009】

本発明に係る内視鏡装置は、所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生部、前記超音波発生部によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生部、前記照明光が到達した検査対象部位から反射される周波数変調された光を受光可能に設けられた反射光受光部と、

前記反射光受光部で受光された受光信号に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部と、

前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成部と、

を有することを特徴とする。

【0010】

本発明に係る被検体情報分析方法は、所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生する超音波発生工程と、

前記超音波発生工程によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生する照明光発生工程と、

前記照明光が到達した前記検査対象部位からの周波数変調された光を受光する受光工程と、

前記周波数変調された光の周波数情報を光学的又は電氣的に抽出する周波数情報抽出工程と、

前記周波数情報抽出工程で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出工程と、

前記散乱情報抽出工程によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成工程と、

を具備したことを特徴とする。

【発明の効果】

【0011】

本発明によれば、被検体における検査対象部位の光の散乱情報を含む被検体の特性情報を容易に取得可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0012】

以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。

【実施例1】

【0013】

図1から図4を参照して本発明の実施例1を説明する。図1は本発明の被検体情報分析装置における代表的な構成例をブロック図で示し、図2は検体情報分析装置の実施例1の光イメージング装置の全体構成を示し、図3は超音波の収束点近傍でドップラシフトする

10

20

30

40

50

様子を示し、図 4 は本実施例の動作内容のフローチャートを示す。

図 1 に示すように本発明に係る検体情報分析装置は、所定の超音波送信軸に沿って被検体内に対して超音波を伝達させるように超音波を発生可能とする超音波発生部 2 と、前記超音波発生部 2 から発生される前記超音波が伝達される被検体内における検査対象部位に到達するような照明光を発生可能とする照明光発生部 3 とを有する。

【0014】

また、この検体情報分析装置は、照明光発生部 3 により発生された照明光が前記検査対象部位で反射されたドップラシフトした周波数変調光を受光可能とするように、例えば照明光発生部 3（或いは超音波発生部 2）側に配置された反射光受光部 4 と、この反射光受光部 4 で受光された受光信号からドップラシフト量を抽出する周波数情報抽出部 5 とを有する。

10

なお、図 1 においては、ドップラシフトした反射光を受光する反射光受光部 4 の場合でその構成を示しているが、後述する実施例 3 の第 2 変形例（図 1 4 参照）のように被検体を透過した光を受光する構成にしても良い。この場合には、図 1 中の反射光受光部 4 は、単なる受光部として機能する。

【0015】

また、図 1 の場合には受光信号から電氣的に周波数情報を抽出する構成の場合で示しているが、後述する実施例 3 のようにドップラシフトした光を光学的な周波数情報抽出部となる液晶チューナブルフィルタ等の分光装置で抽出しても良い。

この場合には、光学的な周波数情報抽出部は、反射光受光部 4 で受光される前のドップラシフトした光からその周波数情報（ドップラシフトした周波数成分）を抽出することになる。

20

また、図 1 においては、反射光受光部 4 により受光された受光信号から周波数情報抽出部 5 が周波数情報を抽出する例を示しているが、反射光受光部 4 により受光される光を分光部で分光する構成にすることもできる（後述する例えば実施例 3 参照）。この場合には、反射光受光部 4 により受光された受光信号は、既に周波数情報を含む信号となり、散乱情報抽出部 6 に入力される。

【0016】

また、この検体情報分析装置は、抽出された周波数情報から前記検査対象部位の複素屈折率における少なくとも実部に相当する光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部 6 と、この散乱情報から前記検査対象部位に対応する被検体の特性情報を生成する被検体情報生成部 6' とを有する。なお、図 1 の場合、反射光受光部 4 は、光分離部 1 3 を介して反射光を受光する構成にしている。

30

上記被検体情報生成部 6' は、被検体の検査対象部位を例えば 2 次元或いは 3 次元的に走査した各位置における散乱情報等を画像化して表示するための画像形成部を有する。

本被検体情報分析装置は、ドップラシフトした周波数情報を抽出することにより、検査対象部位に対する複素屈折率の実部の情報を含む被検体情報を比較的容易に得られるようにしている。

【0017】

図 2 に示す光イメージング装置 1 E は、収納容器となるユニット 1 1 内に照明光発生部 3 としての光源装置 3 b を有する。この光源装置 3 b により発生された光は、光分離部 1 3 としてのハーフミラー 1 3 a に入射され、透過する光と、反射する光に分かれる。

40

このハーフミラー 1 3 a を透過した光は、レンズ枠 3 7 に取り付けられたコリメートレンズ（若しくは集光レンズ）3 8 を経て収束されて、被検体としての生体組織 7 に照射される。

また、このコリメートレンズ 3 8 の光軸 O と例えば角度 θ (> 0) なす方向が超音波送信軸 O u となるように、ユニット 1 1 の端面等に超音波発生部 2 となる超音波トランスジューサ 2 a が取り付けられている。

なお、この超音波トランスジューサ 2 a には、超音波収束手段としての音響レンズ 1 6 が設けてある。

50

【 0 0 1 8 】

そして、この図 2 に示すように収束点 F の近傍領域 R 1 付近において光軸 O 方向に散乱され、その際ドップラーシフトした光（周波数変調光）となり、（この散乱後においては）収束された超音波の影響を殆ど受けることなくコリメートレンズ 3 8 側に戻る。

このコリメートレンズ 3 8 側に戻った光は、ハーフミラー 1 3 a で一部が反射され、反射光受光部 4 となる光検出器 4 a にて受光される。

また、上記ハーフミラー 1 3 a で反射された光は、参照光となり、この参照光路上に対向するように配置された参照ミラー 1 4 で反射されて再びハーフミラー 1 3 a に入射される。そして、入射された光の一部がハーフミラー 1 3 a を透過する。

この際、ドップラーシフトした戻り光と混合（干渉）された状態で光検出器 4 a で受光されることになる。

10

【 0 0 1 9 】

また、本実施例においては、上記のように、光軸 O と超音波送信軸 O u とが異なる方向となるように設定することにより、収束点 F の近傍領域 R 1 で散乱された散乱光を超音波による近傍領域 R 1 以外での影響を殆ど受けることなく検出できるようにしている。

このため、本実施例では例えば連続波の超音波駆動信号を発生する信号発生器 3 9 を採用している。

この信号発生器 3 9 で発生された超音波駆動信号は、パワーアンプ 2 2 により増幅された後、超音波トランスジューサ 2 a に印加される。

なお、コリメートレンズ 3 8 が取り付けられたレンズ枠 3 7 は、ユニット 1 1 側に設けた図示しない筒体と嵌合し、光軸 O 方向に移動することにより、超音波を収束する音響レンズ 1 6 による収束点 F の位置に光をフォーカスするように調整することができる。つまり、コリメートレンズ 3 8 及びレンズ枠 3 7 は、照明光が照射される照射位置調整部を形成している。

20

【 0 0 2 0 】

また、超音波トランスジューサ 2 a は、可動枠体 4 0 に取り付けられてあり、この可動枠体 4 0 を超音波送信軸 O u 方向に移動することにより、超音波の収束点 F の位置を調整できるようにして超音波焦点調整部を形成している。

そして、コリメートレンズ 3 8 により光がフォーカスした位置に、超音波が焦点を結ぶように超音波の焦点調整を行うことができる。

30

また、ユニット 1 1 には、このユニット 1 1 を例えば 2 次元的にスキャンング（走査）する走査部としてのスキャンングユニット 1 2 が取り付けられており、このスキャンングユニット 1 2 は、スキャンング信号発生回路 2 4 からのスキャンング信号で動作する。

このスキャンング信号発生回路 2 4 は、後述する P C 6 a により制御される。

【 0 0 2 1 】

本実施例においては、光検出器 4 a の出力信号は、ドップラーシフト成分を抽出する周波数情報抽出部 5 としてのスペクトルアナライザ等の信号処理回路 5 c に入力される。

また、この信号処理回路 5 c により抽出された周波数情報は、散乱情報抽出部 6 及び被検体情報生成部 6 ' としての機能を持つパーソナルコンピュータ（以下、P C と略記）6 a に入力される。この P C 6 a により、周波数情報から散乱情報として、生体組織 7 の収束点 F の近傍領域 R 1 での複素屈折率における実部に相当する情報を抽出する。

40

また、信号発生器 3 9 からの信号は、信号処理回路 5 c に入力され、この信号に同期して信号処理回路 5 c は、抽出した周波数情報を P C 6 a に出力する。

図 3 は、収束点近傍領域 R 1 において光が超音波によりドップラーシフトする様子の説明図を示す。

【 0 0 2 2 】

上述したように光軸 O と超音波送信軸 O u とは、例えば角 θ なし、光の周波数を f_s 、音波の波長を λ 、生体組織 7 内部での超音波の伝達速度を V 、生体組織 7 の屈折率 n_1 、超音波による近傍領域 R 1 での屈折率変化を Δn とする。

なお、生体組織 7 は、より厳密にはその複素屈折率 $m (= m_r + i m_i$: ここで、 m

50

n_r : 複素屈折率の実部、 m_i : 複素屈折率の虚部) が超音波の照射によって、その実部と虚部が変化するが、本実施例のように光の周波数に対して、その一次の変化分 (ドップラーシフト周波数分) を検出する場合にはその実部の変化分を検出することになる。つまり、上記屈折率変化 Δn は、複素屈折率を用いて表した場合における実部 m_r の変化分 Δm_r に相当する。

【0023】

このため、ドップラーシフトに係する本実施例等においては、屈折率としてより広く用いられている符号 n を用いた表記法を採用する。

近傍領域 R1 で散乱されて入射側に戻る光の周波数は、図3に示すように

$$f_s - \Delta f = f_s - 2V \cos \theta (n_1 + \Delta n) / \lambda \quad (1)$$

となる。そして、この(1)式の第2項のドップラーシフト量 Δf を検出することになる。

【0024】

次に本実施例の動作を説明する。まず、光検出器4aによる信号検出の説明を行う。超音波トランスジューサ2aから出射される超音波は、周期的に振動する粗密波として生体組織7の内部を伝播する。図3に示すように音圧が高くなる超音波収束領域では、音圧による生体構成物質 (散乱体、吸収体) の空間的な密度変化により、音圧が密な部分では屈折率変化 Δn が大きく誘起されると考えられる。逆に、粗な部分では、物質の密度変化が小さい。

一方、音圧が密な部分に光が照射されると、屈折率変化部において強いフレネル反射が起こる。つまり、音圧が密な部分はミラーとしての機能を持つ。この場合、屈折率変化部は、時間と共に超音波の伝搬方向に移動するため、反射光の周波数は Δf だけ、ドップラーシフトする。

【0025】

図2に示したようにマイケルソン干渉計を形成した光イメージング装置1Eの場合には、光検出器4aに入射される参照ミラー14側の電場 $E_r(t)$ と観測光側の電場 $E_o(t)$ は、それぞれ(2)及び(3)式で表される。

$$E_r(t) = E_r \exp i \{ 2\pi f_s t - k_o (D_1 + 2L_1 + D_2) \} \quad (2)$$

$$E_o(t) = E_o \exp i \{ 2\pi (f_s - \Delta f) t - k_o (D_1 + 2L_2 + 2n_0 L_4 + 2n_1 z + D_2) \} \quad (3)$$

ここで、図2に示すように D_1 は光源装置3bとハーフミラー13a間の距離、 D_2 はハーフミラー13aと光検出器4a間の距離、 L_1 はハーフミラー13aと参照ミラー14間の距離、 $L_2 + L_4$ は、ハーフミラー13a光が入射される生体組織7の表面間の距離、 L_4 はコリメートレンズ38から生体組織7の表面間の距離を表す。また、 n_0 は水36の屈折率を表す。

【0026】

この場合、ドップラーシフト量 Δf は、(1)式で表される。(1)式によれば、ドップラーシフト量 Δf の中に、超音波により誘起される屈折率変化 Δn が含まれていることが分かる。

つまり、屈折率は、光散乱現象の主パラメータであることから (例えばMie theory)、検出光のドップラーシフト周波数を計測することにより、局所的な散乱特性を取得できる可能性がある。

光検出器4aで検出される光強度 $I(t)$ は、以下の(4)式となる。

【0027】

$$\begin{aligned} I(t) &= |E_r + E_o|^2 \\ &= |E_r|^2 + |E_o|^2 + 2|E_r||E_o| \cos \{ 2\pi (2V \cos \theta (n_1 + \Delta n_1) / \lambda) t + 2n_1 k_o z \} \end{aligned} \quad (4)$$

ここで、 $(L_2 + n_0 L_4) = L_1$ と仮定した。

(4)式中の第3項のAC成分をスペクトルアナライザ等により、その周波数成分を検出することにより、ドップラーシフト周波数の取得、即ち局所領域での散乱計測を行うこと

10

20

30

40

50

が可能となる。

【 0 0 2 8 】

次に本実施例の光イメージング装置 1 E の動作を図 4 のフローチャートを参照して説明する。

最初のステップ S 4 1 において光源装置 3 b は光を発生する。また、ステップ S 4 2 に示すように超音波トランスジューサ 2 a も超音波を発生する。そして、ステップ S 4 3 に示すように生体組織 7 の収束点 F の近傍領域 R 1 において光源装置 3 b の光は超音波によりドップラー周波数シフトを引き起こす。つまり、上述した (1) 式のようにドップラーシフト量 Δf を伴った光は、ハーフミラー 1 3 a において、参照光と干渉して、干渉光となり、ステップ S 4 4 に示すように光検出器 4 a にて検出される。

10

【 0 0 2 9 】

この干渉信号は、ステップ S 4 5 に示すようにスペクトルアナライザ等の信号処理回路 5 c により、ドップラーシフト量 Δf が検出される。

ステップ S 4 6 に示すように信号処理回路 5 c の出力信号は、P C 6 a に入力され、デジタル信号に変換され、P C 6 a 内のメモリ等に Δf 又は $V (n_1 + \Delta n)$ 等が光散乱情報として、スキャン位置の情報と関連付けてストックされる。なお、超音波の伝達速度 V 、波長 λ 、角 θ 等は既知となる。

そして、次のステップ S 4 7 において P C 6 a は、スキャンが終端かを判定し、これに該当しない場合にはステップ S 4 8 に示すように超音波の収束点 F を移動させるようにスキャンを行い、ステップ S 4 2 又は S 4 3 に戻る。

20

【 0 0 3 0 】

このようにして、スキャンを 2 次元或いは 3 次元的にを行い、スキャンの終端になると、ステップ S 4 7 からステップ S 4 9 に進み、画像生成が完了する。そして、画像表示が行われる。

ステップ S 5 0 に示すように術者は、表示される画像を観察して、癌等の病変部のスクリーニング等に有効利用できる。

また、上述の説明ではステップ S 4 5 においてドップラーシフト量 Δf の検出をスペクトルアナライザを用いた場合で説明した。この他にフーリエ変換でドップラーシフト量 Δf を検出することもできる。以下、フーリエ変換を用いた場合を説明する。

【 0 0 3 1 】

上述したように光検出器 4 a は、(4) 式の光強度 $I (t)$ を検出する。この (4) 式は、第 1 及び第 2 項を I_{dc} と、第 3 項を振幅 I_{ac} 及び φ を用いて以下の (5) 式のよう

30

$$\begin{aligned} I (t) &= I_{dc} + I_{ac} \cos (2 \pi \Delta f t + \varphi) \\ &= I_{dc} + I_{ac} \cos (\Delta \omega t + \varphi) \end{aligned} \quad (5)$$

ここで、 $\varphi = 2 n_1 k_0 z$ である。

【 0 0 3 2 】

(5) 式は信号処理回路 5 c においてフーリエ変換され、(6) 式のようになる。

【 0 0 3 3 】

$$\begin{aligned} F (\omega) &= \int \{ I_{dc} + I_{ac} \cos (\Delta \omega t + \varphi) \} e^{-j \omega t} dt \\ &= \int \{ I_{dc} + I_{ac} \cos (\Delta \omega t + \varphi) \} e^{-j \omega t} dt \quad (-T \quad t \quad T) \\ &= 2 I_{dc} \sin \omega T / \omega + I_{ac} \{ e^{j \varphi} \sin (\Delta \omega - \omega) T / (\Delta \omega - \omega) + e^{-j \varphi} \sin (\Delta \omega + \omega) T / (\Delta \omega + \omega) \} \\ &= 2 I_{dc} \sin \omega T / \omega + I_{ac} \cos \varphi \{ \sin (\Delta \omega - \omega) T / (\Delta \omega - \omega) + \sin (\Delta \omega + \omega) T / (\Delta \omega + \omega) \} + j I_{ac} \sin \varphi \{ \sin (\Delta \omega - \omega) T / (\Delta \omega - \omega) + \sin (\Delta \omega + \omega) T / (\Delta \omega + \omega) \} \end{aligned} \quad (6)$$

40

ここで、(6) 式の一番上の右辺の積分範囲は $-\infty$ から $+\infty$ であり、二番目の右辺の積分範囲はその右側に記載されているように有限の時間 $-T$ から $+T$ で近似できる。

【 0 0 3 4 】

50

(6) 式に示したフーリエ変換された信号の実数成分は、図5に示すようになる。そして、この図5に示すように大きなピークとなるドップラーシフト角周波数 $\Delta\omega$ を検出する。

本実施例によれば、ドップラーシフト量 Δf を抽出することにより、生体組織7の散乱情報、つまり、生体組織7の細胞や細胞構成物の形態学的な情報を観測可能とする分析装置を実現できる。また、この場合ドップラーシフト量 Δf を抽出することにより、従来例に比較して容易に複素屈折率の実部の情報を抽出できる。従って、被検体の形態学的特性情報を容易に得られることになる。

なお、上述のようにフーリエ変換を用いて周波数成分の抽出(算出)を行う代わりに、ウェーブレット変換を用いて周波数成分の抽出を行うようにしても良い。

10

【0035】

図6は、第1変形例の光イメージング装置における照明光軸保持部としてのレンズ保持部26と、超音波送信軸保持部としてのトランスジューサ保持部27周辺部を示す。

レンズ保持部26は、コリメートレンズ38が取り付けられたレンズ枠37が嵌合する透孔により摺動可能に保持する可動保持体26aと、この可動保持体26aの一方の端部側を嵌合して回転的にスライド移動可能に保持する固定側保持体26bとを有する。

また、可動保持体26aの他方の端部側には、ラック部26cが設けてあり、このラック部26cは摘み26eの端部に設けたギヤ26dが噛合する。そして、ユーザは、この摘み26eを回転させる操作を行うことにより、図6中の符号Cで示すように可動保持体26aを移動することができる。そして、コリメートレンズ38の光軸Oを移動してその光

20

【0036】

また、同様にトランスジューサ保持部27は、超音波トランスジューサ2aが取り付けられた可動枠体40が嵌合する透孔により摺動可能に保持する可動保持体27aと、この可動保持体27aの一方の端部側を嵌合して回転的にスライド移動可能に保持する固定側保持体27bとからなる。

また、可動保持体27aの他方の端部側には、ラック部27cが設けてあり、このラック部27cは摘み27eの端部に設けたギヤ27dが噛合する。

そして、ユーザは、この摘み27eを回転させる操作を行うことにより、図6中の符号Dで示すように可動保持体27aを移動することができる。そして、超音波トランスジューサ2aの超音波送信軸Ouを移動してその超音波送信軸Ouの方向を調整することができる。

30

【0037】

また、図6において、レンズ枠37を光軸Oの方向に調整することにより、光の焦点位置Foを調整できる。同様に可動枠体40を調整することにより超音波の収束点Fを調整することができる。

そして、例えば収束点Fに焦点位置Foが一致するように調整することができる照明光調整部が設けてある。また、焦点位置Foに収束点Fが一致するように調整することができる超音波の焦点調整部も設けてある。

本変形例では、固定側保持体26b、27bにより可動保持体26aと可動保持体27aとを共通の平面(光軸Oと超音波送信軸Ouを含め面)内で回転的に移動自在に保持し、光と超音波の送信軸の方向が異なる場合にも、検査対象とする部位に光及び超音波をフォーカスし易くしている。

40

【0038】

なお、図6においては、光軸Oと超音波送信軸Ouとが異なる方向に設定した場合におけるフォーカス調整及び方向調整機構を示しているが、光軸Oと超音波送信軸Ouとを一致させる場合には、レンズ保持部26とトランスジューサ保持部27とを同軸的に或いは積層的に配置することにより実現できる。この構成に関しては、後述する(図9参照)。

図7は第2変形例における超音波の収束点Fの近傍領域を示す。図2或いは図3におい

50

ては、超音波トランスジューサ 2 a は、光軸 O と角 θ を成す 1 つの方向にのみ配置された構成であったが、図 7 に示すように光軸 O に関して θ を成す 2 つの方向に配置された構成にしても良い。

このようにすると、後方散乱光の強度をより大きくすることができ、S/N を向上することができる。なお、光軸 O の回りに回転対称的に 2 つ以上の超音波トランスジューサ 2 a を配置するようにしても良い。

【実施例 2】

【0039】

図 8 は本発明の実施例 2 の光イメージング装置 1 F の構成を示す。実施例 1 では光軸 O と超音波送信軸 O u とが異なる方向に設定されていたが、本実施例は、光軸 O と超音波送信軸 O u とを一致させる構成にしたものである。これにより、生体組織 7 側に光及び超音波を照射する部分をコンパクトにできる。

本実施例においては、超音波の収束点 F の近傍領域 R 1 でのドップラーシフト量 Δf のみを有効に検出するため、パルス状の超音波を照射する。このため、図 2 の信号発生器 3 9 の代わりにパルス発生器 2 1 が採用される。

また信号処理回路 5 c にはディレイ回路 2 3 で遅延されたパルスが入力され、信号処理回路 5 c は、この遅延された短い期間にドップラーシフト量 Δf の周波数検出或いは周波数抽出を行う。

【0040】

その他、図 2 で示したものと同一構成要素には同じ符号を付け、その説明を省略する。なお、図 8 においては、超音波を収束させ、光は収束させない構成例で示しているが、光も収束させる構成にしても良い。この場合には、検出される信号の S/N を向上できる。

本実施例においては、光軸 O と超音波送信軸 O u との成す角 θ が 0 ($\cos \theta = 1$) となるため、周波数シフトが最大となる状態でドップラーシフト量 Δf を検出することができるメリットがある。

また、上述したように生体組織に光と超音波を照射する部分をよりコンパクトにできる効果がある。

【0041】

なお、パルス発生器 2 1 からパルス形状の電気信号でなく、連続形状の電気信号をパワーアンプ 2 2 へ与えることで、超音波トランスジューサ 2 a より連続超音波を生体組織 7 へ照射しても良い。またこの際、パルス発生器 2 1 より超音波の波長に相当する時間間隔でパルス状のリファレンス信号を信号処理回路 5 c へ入力して、同期検波をすることでパルス状の超音波を照射した場合と同様の効果を得ることも可能である。

【0042】

図 9 は、図 8 の構成に適用された第 1 変形例におけるレンズ保持部 2 6' とトランスジューサ保持部 2 7' 周辺部を示す。光源装置 3 b からハーフミラー 1 3 a と透過した光は、光軸 O 上に設けたレンズ保持部 2 6' のコリメートレンズ 3 8 を通り、この光軸 O と略一致するように隣接して設けられたトランスジューサ保持部 2 7' における開口 1 5 を通って生体組織 7 側に集光されて照射される。

レンズ保持部 2 6' とトランスジューサ保持部 2 7' は、図 6 におけるレンズ保持部 2 6 とトランスジューサ保持部 2 7 における回動的な移動の代わりに光軸 O 及び超音波送信軸 O u に直交する方向にそれぞれ移動可能とした違いがあるのみである。

【0043】

そして、例えばレンズ保持部 2 6' 側を調整することにより、矢印 C で示す方向に移動して光軸 O が超音波送信軸 O u に一致するように調整することを可能とする照明光軸調整部を形成している。

また、トランスジューサ保持部 2 7' 側を調整することにより、超音波送信軸 O u が矢印 D で示すように移動でき、光軸 O に一致するように調整することを可能とする送信軸調整部を形成している。なお、例えばレンズ枠 3 7 を光軸 O 方向に移動可能として、収束点

10

20

30

40

50

Fと焦点位置F_oとが一致するように調整することができる構成にしても良い。

本変形例によれば、レンズ保持部26'やトランスジューサ保持部27'がバラツキがある場合においても、調整することにより収束点Fと焦点位置F_oとが一致するように調整することができる。そしてS/Nや分解能が高い状態で光イメージング情報を得ることができる。

また、照明光を集光しているので、S/Nや分解能が高い状態で周波数情報を抽出できる。

【0044】

なお、上記の各実施例において、超音波としてパルス波と連続波のいずれを用いても良く、更に上述の各実施例においては光検出器4aとしてCCD等の2次元検出器や、1次元ラインセンサ、更にPhotodetector、光電子倍增管等の点検出器を使用しても良い。更に上記の実施例1, 2においては、フーリエ変換によりドップラーシフト量を検出しても良い。

【実施例3】

【0045】

次に図10及び図11を参照して本発明の実施例3を説明する。実施例1及び実施例2においてはマイケルソン型干渉計を備えた構成の場合で説明したのに対して、本実施例は干渉計を設けなくて、例えば液晶チューナブルフィルタのような分光手段を設けた構成にしたものである。

図10は実施例3の光イメージング装置1Gを示す。ユニット11内に設けられた光源装置3bの光は、ハーフミラー13aに入射され、このハーフミラー13aで反射された光は、水36に浸された生体組織7に照射される。ユニット11はスキャニングユニット12により、2次元若しくは3次元的に移動される。なお、ここでは水36に浸された生体組織7に対して適用する例で示しているが、水を入れたバルーンを採用することもできるし、音響レンズ16を直接接触させても良い。

【0046】

また、ユニット11の端面に取り付けられた超音波トランスジューサ2aから出射される超音波は、音響レンズ16により収束され、光軸Oと角 θ なす超音波送信軸O_uに沿って、超音波を伝達する水36を経て生体組織7内部に照射される。

超音波の収束点Fの近傍領域R1でドップラーシフトし、後方側に散乱された光は、ハーフミラー13aに入射し、その一部が透過する。このハーフミラー13aを透過した光は、さらにミラー41で反射された後、分光手段としての液晶チューナブルフィルタ42に入射される。

この液晶チューナブルフィルタ42は、ドライバ43から印加される駆動信号に応じて、この液晶チューナブルフィルタ42の透過波長の帯域が変化する。なお、ドライバ43は、例えばスキャニング信号発生回路24からのスキャニング信号に同期して液晶チューナブルフィルタ42を駆動する。

この液晶チューナブルフィルタ42を透過した光は、光検出器4aにより受光される。この光検出器4aの出力信号は、信号処理回路5dを経てPC6aに入力される。

【0047】

信号処理回路5d及びPC6aは、光検出器4aの出力信号から散乱情報抽出と、被検体情報生成、より具体的には画像形成処理を行う。この場合、信号処理回路5dで散乱情報抽出、PC6aで画像形成処理を行うようにしても良い。

そして、光検出器4aにより光電変換された信号は、透過波長をスイープさせる駆動信号と共に、PC6a内のメモリ等に一時格納される。そして、例えば以下のようにして、ドップラーシフトした信号検出時の透過波長(或いはドップラーシフト量 Δf)を算出する。

光検出器4aの出力信号からドップラーシフトした信号を検出する場合、例えばPC6a(内のCPU)は、図示しない比較等により、閾値以上で検出され、ピークとなる信号をドップラーシフトした信号として抽出する。

10

20

30

40

50

【 0 0 4 8 】

また、そのピークとなる信号検出時における駆動信号の情報から、透過波長を算出して、その算出した透過波長の情報と共に、メモリにストックする。なお、駆動信号を周期的に変化させることにより、そのタイミングから透過波長の値が算出できるようにしても良い。

なお、後述するように例えば P C 6 a 内においてフーリエ変換することにより、光検出器 4 a の出力信号からドップラーシフトした信号を検出するようにしても良い。

また、超音波トランスジューサ 2 a にはパルス発生器 2 1 で発生したパルスがパワーアンプ 2 2 で増幅されたパルス状超音波駆動信号が印加される。また、パルス発生器 2 1 のパルスは、ディレイ回路若しくはトリガ回路 4 4 を介して例えば信号処理回路 5 d に入力され、信号処理回路 5 d は、パルスに応じて抽出した散乱情報を P C 6 a に出力する。

なお、本実施例においては、超音波トランスジューサ 2 a をパルスの（間欠的）に駆動する構成で示しているが、連続波で駆動する構成にしても良い。

【 0 0 4 9 】

本実施例の動作を図 1 1 のフローチャートを参照して説明する。なお、前述した実施例 1 における図 4 の場合のフローチャートを参照しその説明を簡略化する。

図 4 の場合と同様に最初にステップ S 4 1 及び S 4 2 において光と超音波を発生する。上述のように超音波はパルスの場合に限らず連続波でも良い。

そして、ステップ S 4 3 に示すように収束点 F の近傍領域 R 1 においてドップラーシフト現象が発生する。この場合には、その光強度 $I(t)$ は (2) 及び (3) 式を 2 乗したものととなり、以下の (7) 式のように表される。

$$\begin{aligned} I(t) &= I_{dc} + I_{ac} \cos \{ 2\pi (f_s + \Delta f) t + \phi \} \\ &= I_{dc} + I_{ac} \cos \{ (\omega_s + \Delta \omega) t + \phi \} \end{aligned} \quad (7)$$

そして、ステップ S 4 4 ' に示すように液晶チューナブルフィルタ 4 2 により透過波長を変化して、ステップ S 4 5 ' に示すようにこの液晶チューナブルフィルタ 4 2 を透過した光を光検出器 4 a で検出する。

【 0 0 5 0 】

この光検出器 4 a の出力信号は、信号処理回路 5 d を経て P C 6 a に入力される。信号処理回路 5 d 或いは P C 6 a は、入力された信号から、実際にドップラーシフトした信号の抽出を行う。そして、P C 6 a は、ステップ S 4 6 に示すように Δf 等の情報を光イメージング情報としてメモリにストックする。

その後のステップ S 4 7 から S 5 0 の処理は図 4 にて説明したものと同様であるので、その説明を省略する。

本実施例は、干渉計を必要としないので、装置構成を簡便にできるメリットがある。また、装置を小規模で実現できるメリットがある。

上述の説明では、比較器等を用いて光検出器 4 a の出力信号からドップラーシフトした信号を検出する場合で説明したが、以下のようにフーリエ変換を用いて、ドップラーシフトした信号を検出するようにしても良い。

【 0 0 5 1 】

(7) 式は P C 6 a (或いは信号処理回路 5 d でも良い) においてフーリエ変換され、(8) 式のようになる。

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int \{ I_{dc} + I_{ac} \cos(\Delta \omega t + \phi) \} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int \{ I_{dc} + I_{ac} \cos(\omega_s t + \Delta \omega t + \phi) \} e^{-j\omega t} dt \quad (-T \text{ to } T) \\ &= 2I_{dc} \sin \omega T / \omega + I_{ac} \cos \phi \{ \sin(\Delta \omega + \omega_s - \omega) T / (\Delta \omega + \omega_s - \omega) + \sin(\Delta \omega + \omega_s + \omega) T / (\Delta \omega + \omega_s + \omega) \} \\ &\quad + j I_{ac} \sin \phi \{ \sin(\Delta \omega + \omega_s - \omega) T / (\Delta \omega + \omega_s - \omega) + \sin(\Delta \omega + \omega_s + \omega) T / (\Delta \omega + \omega_s + \omega) \} \end{aligned} \quad (8)$$

ここで、(8) 式の一番上の右辺の積分範囲は $-\infty$ から $+\infty$ であり、二番目の右辺の積分範囲はその右側に記載されているように表される。

【 0 0 5 2 】

(8) 式に示したフーリエ変換された信号の実数成分は、図 1 2 に示すようになる。そして、この図 1 2 に示すように大きなピークとなる角周波数 $\omega_s + \Delta \omega$ を検出し、既知の角周波数 ω_s を減算してドップラーシフトの角周波数 $\Delta \omega$ を検出する。

図 1 3 は第 1 変形例の光イメージング装置 1 H を示す。この光イメージング装置 1 H は、図 1 0 の構成において、液晶チューナブルフィルタ 4 2 の代わりに音響光学回折格子 4 5 a 及び圧電素子 4 5 b が採用されている。

この音響光学回折格子 4 5 a 及び圧電素子 4 5 b は、ドライバ 4 3 からの駆動信号が圧電素子 4 5 b に印加されることにより、回折格子の格子間隔が変化して、入射された光の波長に対する 1 次の回折角が変化する。つまり、この音響光学回折格子 4 5 a は、分光器のように分光（波長分解）した光を（異なる方向に）出す。

10

【 0 0 5 3 】

この音響光学回折格子 4 5 a により波長分解された光は光検出器 4 a にて検出される。

その他は、図 1 0 と同様の構成である。本変形例の作用効果は、図 1 0 の装置の場合と同様である。

図 1 4 は第 2 変形例の光イメージング装置 1 I を示す。この光イメージング装置 1 I は、図 1 0 の装置を透過型に適用したものである。

ユニット 1 1 a 側の光源装置 3 b からの光は、光軸 O に沿って進行し、水 3 6 を透過して生体組織 7 内部に照射される。

20

この光は、超音波収束領域においてドップラーシフトし、その一部は光軸 O 上をさらに進行し、生体組織 7 を透過する。そして、ユニット 1 1 b における光軸 O 上に配置された遮光板 1 9 の開口 1 9 a を経てミラー 4 1 に入射され、このミラー 4 1 で反射されて液晶チューナブルフィルタ 4 2 に入射される。

【 0 0 5 4 】

この液晶チューナブルフィルタ 4 2 を透過した光は光検出器 4 a で検出される。なお、ユニット 1 1 a、1 1 b は、それぞれスキャニングユニット 1 2 a、1 2 b で 2 次元或いは 3 次元的に移動される。その他、図 1 0 等で説明した構成要素と同じものには同じ符号を付け、その説明を省略する。

本変形例は、図 1 0 の装置における反射光（戻り光）を検出する代わりに透過光を検出する相違があるが、これを除けば図 1 0 の装置の場合と同様の作用効果を有する。なお、液晶チューナブルフィルタ 4 2 の代わりに、分光器や音響光学素子といった分光デバイスにしても良い。

30

なお、図示しないが、図 1 3 に示した装置も透過光の検出タイプの構成にすることもできる。

【 0 0 5 5 】

上記の各実施例における光検出器 4 a は、Photodiode や光電子倍增管といった点検出器でも良いし、1 次元ラインセンサや CCD 等の 2 次元検出器を用いても良い。

【 0 0 5 6 】

更に、図 1 3、図 1 4 の実施例に関しては、パルス発生器 2 1 の駆動波形を調整することにより、連続超音波やパルス超音波のいずれを用いても良い。更に上記各実施例は分光的手段を用いずにフーリエ変換によりドップラーシフト量を検出しても良い。

40

【 実施例 4 】

【 0 0 5 7 】

次に図 1 5 及び図 1 6 を参照して本発明の実施例 4 を説明する。本実施例は、例えば図 8 の実施例 2 の場合と同様に超音波送信軸 O u と光軸 O とを略同軸となるように配置してコンパクトな構成を実現にしている。但し、本実施例は、参照光と干渉させることなくドップラーシフト量を検出する点が実施例 2 とは異なる。

図 1 5 に示す光イメージング装置 1 J は、例えば図 8 に示した光イメージング装置 1 F に類似した構成である。

50

図 8 の場合においては、参照光と干渉させる構成であったが、本実施例は、参照光と干渉させないで、例えば実施例 3 の場合のように光学的に分光してドップラーシフト量を検出する構成にしている。

連続光を発生する光源装置 3 b からの光は、ハーフミラー 1 3 a で一部が反射されてコリメートレンズ 3 8 により集光されて生体組織 7 側に照射される。また、生体組織 7 の超音波収束領域 R 1 で反射されたドップラーシフトした光は、ハーフミラー 1 3 a に入射し、一部が透過し、光学的な分光手段としての例えば液晶チューナブルフィルタ 4 2 に入射される。

【0058】

この液晶チューナブルフィルタ 4 2 は、ドライバ 4 3 からの駆動信号の印加により、透過波長が変化する。そして、この液晶チューナブルフィルタ 4 2 を透過した光は、光検出器 4 a にて受光され、光電変換される。

この光検出器 4 a の出力信号は、メモリ装置 5 8 に入力され、メモリ装置 5 8 内の A / D 変換器によりデジタル信号に変換された後、メモリにスキャン情報と共に、ストックされる。このメモリ装置 5 8 にストックされた情報は、例えば 1 フレーム分の情報が生成されると、出力装置表示装置 1 0 に出力され、被検体の特性情報が画像として表示される。

【0059】

また、パルス発生器 2 1 で発生されるパルスは、パワーアンプ 2 2 を介してパルス状超音波駆動信号となり、超音波トランスジューサ 2 a に印加され、超音波トランスジューサ 2 a はパルス超音波を発生する。

このパルス発生器 2 1 によるパルスは制御装置 4 6 に入力され、制御装置 4 6 はパルス超音波に同期してスキャン装置 4 9 のスキャンの動作を制御する。また、この制御装置 4 6 は、パルス超音波に同期して、ドライバ 4 3 の駆動信号の発生を制御する。また、メモリ装置 4 8 もパルス超音波に同期して、光検出器 4 a からの出力信号のストックを行う。

なお、本実施例においては、例えば図 9 で説明したレンズ保持部 2 6 ' とトランスジューサ保持部 2 7 ' とを備えた構成にしている。

【0060】

そして、光源装置 3 b の光はコリメートレンズ 3 8 により集光され、その光軸 O 上を進行し、超音波トランスジューサ 2 a の開口 1 5 を通り、さらに、水 3 6 を経て生体組織 7 内部に照射される。

収束点近傍領域 R 1 で、その周波数がドップラーシフトした反射光の一部は、コリメートレンズ 3 8 、ハーフミラー 1 3 a を経て液晶チューナブルフィルタ 4 2 に入射される。そして、この液晶チューナブルフィルタ 4 2 によりドップラーシフトした光を信号光として抽出できるようにしている。

また、超音波トランスジューサ 2 a から出射されるパルス超音波は音響レンズ 1 6 により収束されて生体組織 7 側に照射される。また、コリメートレンズ 3 8 の光軸 O と超音波送信軸 O u とが一致するように調整できるようにしている。

【0061】

そして、例えばレンズ保持部 2 6 ' 側を調整することにより、光軸 O が超音波送信軸 O u に一致するように調整することを可能とする照明光軸調整部を形成している。

また、トランスジューサ保持部 2 7 ' 側を調整することにより、超音波送信軸 O u が光軸 O に一致するように調整することを可能とする送信軸調整部を形成している。

なお、ユニット 1 1 は、制御装置 4 6 の制御下でスキャン装置 4 9 により 2 次元或いは 3 次元的に駆動される。このスキャン装置 4 9 は、図 8 におけるスキャン信号発生回路 2 4 とスキャンユニット 1 2 の両機能を兼ねる。

【0062】

本実施例の動作を図 1 6 を参照して説明する。

最初のステップ S 5 1 において、光源装置 3 b は連続の光を発生する。そして、この

10

20

30

40

50

光は、生体組織 7 側に照射される。次のステップ S 5 2 に示すようにパルス発生器 2 1 は、パルスを発生し、パワーアンプ 2 2 を経て生成されたパルス状超音波駆動信号が超音波トランスジューサ 2 a に印加され、超音波トランスジューサ 2 a はパルス超音波を発生する。このパルス超音波は、音響レンズ 1 6 で収束されながら生体組織 7 に照射される。

ステップ S 5 3 に示すようにパルス超音波が超音波収束点近傍領域に達した場合の屈折率変化に伴い、この領域に達した光は、最もドップラーシフトし、その反射光は、液晶チューナブルフィルタ 4 2 に入射される。

【 0 0 6 3 】

ステップ S 5 4 に示すようにドップラーシフトした反射光が液晶チューナブルフィルタ 4 2 に入射されるタイミングでドライバ 4 3 は、液晶チューナブルフィルタ 4 2 の透過波長を変化させる。このようにドライバ 4 3 は、パルス超音波が収束点 F に達する時間内において液晶チューナブルフィルタ 4 2 の透過波長を変化させるように制御装置 4 6 により制御される。

そして、ステップ S 5 5 に示すように液晶チューナブルフィルタ 4 2 を透過した光は、光検出器 4 a により受光される。

次のステップ S 5 6 に示すように、光検出器 4 a により受光され、ドップラーシフトした電気信号はメモリ装置 4 8 内のメモリに光イメージング情報として、スキャニング位置情報と共にストックされる。この場合、液晶チューナブルフィルタ 4 2 の透過波長の情報もメモリ装置 5 8 のメモリにストックされる。これにより、ドップラーシフト量 Δf や屈折率変化を反映した物理量の算出が可能になる。

【 0 0 6 4 】

次のステップ S 5 7 において制御装置 4 6 は、スキャニングが終端かの判定を行う。そして、終端に該当しない場合には、制御装置 4 6 は、ステップ S 5 8 に示すように超音波の収束点を移動する制御を行う。

つまり、制御装置 4 6 は、スキャニング装置 4 9 の動作を制御し、ユニット 1 1 を移動させる。そして、ステップ S 5 2 に戻り、上述した処理を繰り返す。

このようにして、スキャニングがスキャニング範囲の終端まで行われると、ステップ S 5 7 からステップ S 5 9 に移る。このステップ S 5 9 において、1 フレーム分の画像生成が完了する。そして、この 1 フレーム分の画像は、出力信号表示装置 1 0 に送られ、この出力信号表示装置 1 0 において、例えば屈折率変化 Δn を反映した画像が表示される。

【 0 0 6 5 】

本実施例によれば、超音波と光を同軸状に照射すると共に、ドップラーシフト光を照射光と同じ光路を経て受光するようにしているので、コンパクトな装置で実現できる。

なお、本実施例は、光学的な分光手段を採用しているが、参照光と干渉させ、光検出器 4 a の干渉信号からスペクトルアナライザ等を用いてドップラーシフト量 Δf や屈折率変化（屈折率の実部の変化量）を反映した物理量を算出することもできる。

図 1 7 は実施例 4 の変形例の光イメージング装置 1 K を示す。本変形例は、図 1 5 において液晶チューナブルフィルタ 4 2 の代わりに分光装置 5 0 ' を採用している。

【 0 0 6 6 】

この分光装置 5 0 ' により波長分離された光は、光検出器 4 a に入力され、電気信号に変換される。

そして、光検出器 4 a の出力信号は、分光装置 5 0 ' による波長分離に用いた情報及びスキャニング位置の情報と共に、メモリ装置 5 8 内のメモリに格納される。その他は、図 1 5 と同様の構成である。

本変形例は、実施例 4 の場合と同様に装置をコンパクトにできる等のメリットがある。

【 実施例 5 】

【 0 0 6 7 】

図 1 8 は実施例 5 の光イメージング装置 1 L を示す。

この光イメージング装置 1 L は、図 1 5 の光イメージング装置 1 J において、超音波ト

10

20

30

40

50

ランスジューサ 2 a の超音波送信軸 O u を光軸 O の方向と異なる方向（例えば超音波送信軸 O u を光軸 O とが角 θ なす方向）に設定したものである。また、この実施例は、光源装置 3 b の光をハーフミラー 1 3 a にて参照ミラー 1 4 側への参照光と生体組織 7 側への観測光とに分岐させ、生体組織 7 側から戻るドップラーシフトした光を参照光と干渉させる構成にしている。本変形例においても、連続波の光を採用している。

なお、本実施例においては、制御装置 4 6 は、ディレイ回路 4 7 を介して信号処理装置 4 8 における検出のタイミングを制御している。この信号処理装置 4 8 は、光検出器 4 a からの出力信号が入力されるスペクトルアナライザ 4 8 a と、例えば P C の一部、例えば A / D 変換器、C P U、メモリからなる A / D 変換器・C P U・メモリ 4 8 b とからなる。そして、この A / D 変換器・C P U・メモリ 4 8 b にストックされた情報は、出力信号表示装置 1 0 に出力される。

【0068】

また、本実施例では、例えばレンズ保持部 2 6 ' のみ設けた構成にしている。

本実施例のタイミングチャートは、図 1 9 に示すようになる。光源装置 3 b は図 1 9 (A) に示すように連続光を発生する。

超音波トランスジューサ 2 a は図 1 9 (B) に示すように例えば一定間隔のパルス超音波を発生する。このパルス超音波は、例えば図 1 9 (C) に示すように超音波トランスジューサ 2 a によるパルス超音波の発生から例えば時間 T f の後、収束点 F に到達する。

制御装置 4 6 は、パルス超音波の発生からこの時間 T f 遅れたタイミングで、光検出器 4 a がドップラーシフトした光を検出させるように例えばゲートパルス印加して制御する。この動作を図 1 9 (D) においては、ドップラーシフトした光の検出で示している。

【0069】

光検出器 4 a は、光検出した信号を常時出力している場合には、A / D 変換器・C P U・メモリ 4 8 b 側を制御して、上記のタイミングにおいて光検出器 4 a の出力信号を取り込むように制御する。

また、このドップラーシフトした光の検出の後、スキャン信号により、収束点 F を移動する。このようにして、検査対象領域に対するドップラーシフト量 Δf の検出、そして屈折率変化 Δn を反映した画像を得ることができる。

図 2 0 は実施例 5 の第 1 変形例の光イメージング装置 I M を示す。

この光イメージング装置 I M は、図 1 8 の光イメージング装置 I L において超音波を収束させない構成にしたものである。つまり、この光イメージング装置 I M は、図 1 8 の光イメージング装置 I L において超音波を収束する音響レンズ 1 6 を設けない構成にしている。また、レンズ保持部 2 6 ' を設けない構成にしている。

【0070】

本変形例は超音波を収束させないため、簡便な構成で実現できる。なお、このように超音波を収束させない場合には、超音波トランスジューサ 2 a 側を固定する構成にしても良い。つまり、超音波が広がって照射されるため、コリメートレンズ 3 8 によりフォーカスする光側をスキャンする構成にすることもできる。

また、図 2 1 は、実施例 5 の第 2 変形例の光イメージング装置 I N を示す。この光イメージング装置 I N は、図 2 0 の光イメージング装置 I M において、光源装置 3 b とハーフミラー 1 3 a との間にビームイクスパンダ 5 0 を設けたものである。このようにすることにより、ビーム径を増大でき、変調光検出強度を増幅させることが可能である。

図 2 2 は、実施例 5 の第 3 変形例の光イメージング装置 I P を示す。この光イメージング装置 I P は、図 2 0 の光イメージング装置 I M において干渉計を形成しない構成にしたものである。

【0071】

本変形例の装置の構成としては例えば図 1 0 に類似した構成を採用している。この光イメージング装置 I P は、図 1 0 の装置においてハーフミラー 1 3 a で反射された光をコリメートレンズ 3 8 で集光して生体組織 7 に照射する。

また、生体組織 7 側で反射され、ハーフミラー 1 3 a を透過した光は、ミラー 4 1 で反

10

20

30

40

50

射されて分光装置 50' に入射され、分光された光を光検出器 4a で検出する。

また、超音波トランスジューサ 2a にはパルス状超音波駆動信号を印加する構成にしている。この場合、音響レンズ 16 は設けてなく、超音波トランスジューサ 2a は収束されないパルス超音波を生体組織 7 に照射することになる。

なお、本変形例は、光源装置 3b の光をビームイクスパンダ 50 によりビーム径を増大して、ハーフミラー 13a に出射する構成にしている。このビームイクスパンダ 50 を用いない構成にしても良い。

本変形例も簡便な構成で実現できる効果がある。また、さらに簡略化するため、図 22 におけるコリメートレンズ 38 を採用しない構成にしても良い。図 23 はコリメートレンズ 38 を採用しないで、集光されない光を生体組織 7 側に照射する光イメージング装置 I 10 Q の一部を示している。

【0072】

なお、上記の各実施例においても、超音波はパルスでも良いし、連続波でも良い。また、上記の各実施例の構成中の光検出器 4a は、点検出器でも、1次元のライン状検出器でも、CCD等の2次元検出器でも良い。更に、フーリエ変換によりドップラーシフト量を検出しても良い。

【実施例6】

【0073】

次に図 24 から図 26 を参照して本発明の実施例 6 を説明する。図 24 に示す実施例 6 の光イメージング装置 1U は、ドップラーシフト量を検出するタイプである。 20

この光イメージング装置 1U は、生体組織 7 に照射するレーザ光等の光を発生する光源装置 3b を有する。

この光源装置 3b の光は、この光を導光する光ファイバ 52a の端面に入射され、この光ファイバ 52a を介してその途中に設けられた光カプラ 53 において、2つの光に分岐される。そして、一方は光ファイバ 52b を介して光照射と受光を行う光照射・受光部 54b 側に導光され、他方は光ファイバ 52c を介して参照光生成部 55 側に導光される。

【0074】

また、光ファイバ 52b により、超音波を伝達する水 36 を介して生体組織 7 側に照射され、生体組織 7 側からドップラーシフトして戻る光は、観測光としてこの光ファイバ 52b に入射され、光カプラ 53 において参照光側の光と干渉した干渉光となる。 30

そして、この干渉光は、光ファイバ 52d を経てその端面に配置された光検出器 4a により受光され、光電変換される。

上記参照光生成部は、光ファイバ 52c の端面から出射される光をコリメートレンズ 56 により平行な光束の光にして、固定された参照ミラー 14 に入射させ、この参照ミラー 14 で反射された光をコリメートレンズ 56 により再び光ファイバ 52c の端面に入射させる。

また、上記光照射・受光部 54b は、光照射（或いは光射出）及び受光を行う光ファイバ 52b の端面付近に、超音波トランスジューサ 57b とスキャニングデバイス 58 と音響レンズ 59 が設けられている。

【0075】

超音波トランスジューサ 57b は、超音波送信面側が例えば凹面形状に加工されており、パルス発生器 21 からパワーアンプ 22 で増幅されたパルス状の超音波駆動信号が印加されることにより、パルス超音波を発生し、このパルス超音波は収束されて生体組織 7 側に照射される。

また、スキャニングデバイス 58 は、パルス状超音波駆動信号と同期して、スキャニング信号発生回路 24 からのスキャニング信号が印加されることにより、光照射・受光部 54b を2次元的にスキャンする。例えば、生体組織 7 の深さ方向、つまりz方向と、このz方向と直交する例えばx方向等にスキャンする。

この光ファイバ 52b の端面の拡大図を図 25 に示す。本実施例においては、光ファイバ 52b は、中央部に配置した1本或いは複数本の光ファイバからなる第1の光ファイバ 50

部 6 0 a と、この第 1 の光ファイバ部 6 0 a の周囲に配置した複数のファイバ、つまりファイババンドルからなる第 2 の光ファイバ部 6 0 b とにより構成されている。

【 0 0 7 6 】

そして、例えば図 2 6 の光カブラ 5 3 の拡大図に示すように光源装置 3 b による光を光ファイバ 5 2 a に入射させ、光カブラ 5 3 を構成する第 1 カブラ部 5 3 a において例えば 2 本に分岐させて光ファイバ 5 2 b の第 2 の光ファイバ部 6 0 b と光ファイバ 5 2 c における第 2 の光ファイバ部 6 0 b と導光させるようにしている。

そして、第 2 の光ファイバ部 6 0 b の端面から、導光されたレーザ光を生体組織 7 側に照射する。また、生体組織 7 側からのドップラーシフトした戻り光を中央の第 1 の光ファイバ部 6 0 a で受光するようにしている。この第 1 の光ファイバ部 6 0 a で受光された光は、第 2 のカブラ部 5 3 b において参照光側の光を導光する第 1 の光ファイバ部 6 0 a と光混合され、ドップラーシフトした干渉光が生成される。そして、この干渉光は、光ファイバ 5 2 d により導光されて光検出器 4 a で受光される。

【 0 0 7 7 】

この光検出器 4 a で検出された信号は、スペクトルアナライザ等の信号処理回路 5 c に入力され、ドップラーシフト量 f が検出される。

また、この信号処理回路 5 c は、パルス発生器 2 1 からディレイ回路 2 3 によりディレイされたタイミングに同期して、信号抽出の動作を行う。

この信号処理回路 5 c で検出された信号は、P C 6 a の P C 本体 6 c 内の A / D 変換回路に入力される。なお、P C 本体 6 c は、内部に C P U、メモリ、A / D 変換回路等を備えている。そして、P C 本体 6 c から出力される画像表示用信号はモニタ 3 5 に入力され、このモニタ 3 5 の表示面に光イメージング情報の画像が表示される。

また、この P C 本体 6 c 内の A / D 変換回路には、スキャニング信号発生回路 2 4 からスキャニング信号が入力され、このスキャニング信号を取り込むことにより、スキャニング位置情報を算出する。

【 0 0 7 8 】

また制御回路 2 5 は、パルス発生器 2 1、スキャニング信号発生回路 2 4 及びディレイ回路 2 3 の各動作を制御する。また、この制御回路 2 5 は、例えば P C 本体 6 c 内の C P U と制御信号などの送受を行うことができる。そして、制御回路 2 5 によりパルス発生器 2 1 等を制御することができると共に、P C 6 a 側から制御回路 2 5 を介して或いは制御回路 2 5 をスルーしてパルス発生器 2 1 等を制御することもできるようにしている。

このような構成による本実施例によれば、光ファイバ 5 2 b の先端付近をスキャニングすることにより、実施例 1 と同様に複素屈折率の実部に相当する光イメージング情報を得ることができる。さらに、スキャニングデバイス 5 8 としてサイズが小さくかつ駆動力が小さなもので済む。その他、実施例 1 と同様の効果を有する。

【 0 0 7 9 】

図 2 7 は実施例 6 の第 1 変形例の光イメージング装置 1 V の構成を示す。この光イメージング装置 1 V は、干渉計を形成しない構成にしたものである。この光イメージング装置 1 V は、図 2 4 の光イメージング装置 1 U において、光の分離や結合を行う光カブラ 5 3 を用いない構成にしている。

また、本変形例は、連続の光を発生する光源装置 3 c を採用し、超音波については連続波の超音波を発生する構成にしている。なお、図 2 4 の場合と同様に連続の光とパルス超音波とを採用する構成にしても良い。

光源装置 3 c からの光は、光ファイババンドル 5 2 a ' により、その先端面に導光され、光照射と受光を行う光照射・受光部 5 4 b における先端面から導光された光が生体組織 7 側に照射される。

【 0 0 8 0 】

また、この光ファイババンドル 5 2 a ' は、途中で光ファイバ 5 2 d ' と例えば一体化された光ファイババンドル部 5 2 b ' が形成されている。

この光ファイババンドル部 5 2 b ' は、例えば図 2 5 と類似の構成である。具体的には

10

20

30

40

50

、図 27 中の端面拡大図に示すように、中心位置に受光用の光ファイバ 52d' が配置され、その周囲に光ファイババンドル 52a' を構成する光ファイバが配置された同心の構造になっている。

また、光ファイババンドル 52a' の先端付近の外側には凹面形状の超音波トランスジューサ 57b とスキャニングデバイス 58 と音響レンズ 59 が設けられている。

【0081】

そして、中心位置に配置した光ファイバ 52d' により、生体組織 7 側からのドップラースhiftした光を受光し、その基端面側に導光する。この基端面には、例えば分光装置 50' が配置されており、ドップラースhiftした光を光学的に分離抽出する。抽出された光は、光検出器 4a に入力され、光電変換された電気信号となり、PC 本体 6c に入力され、内部のメモリにスキャニング位置の情報や分光装置 50' による周波数分離の情報と共にストックされる。

本変形例は、図 24 の構成の場合における電氣的にドップラースhiftした周波数成分の信号を分離抽出することを行わない構成のため、図 24 における光検出器 4a の出力信号は、信号処理回路 5c を経由しないで、PC 本体 6c に入力される。

【0082】

光源装置 3c による光の発生のタイミングは、制御回路 25 により制御される。また、制御回路 25 は、光の発生のタイミングに同期して、生体組織 7 側の収束点 F で反射されたドップラースhiftした光が分光装置 50'、光検出器 4a を経て PC 本体 6c に入力されるタイミングにおいて、光検出器 4a の出力信号を取り込むように PC 本体 6c に制御信号を送る。

なお、超音波トランスジューサ 57b は、図 2 の場合と同様に信号発生器 39、パワーアンプ 22 を経た超音波駆動信号により駆動される。

その他は、図 24 の構成と同様である。本変形例は、図 24 の場合と同様の効果を有する。また、図 24 における光カプラ 53 や干渉させるための参照光生成部 55 等が不要となり、よりコンパクトな装置を実現できる。

【0083】

なお、本変形例における分光装置 50' の代わりに、他の光学的な分光手段（若しくは波長分離抽出手段）、具体的には液晶チューナブルフィルタ、音響光学素子、回折格子等を用いることもできる。

図 28 は実施例 6 の第 2 変形例で、光イメージング装置を備えた内視鏡装置 1W の構成を示す。

本変形例は、例えば実施例 6 における光照射・受光部 54b に相当する構成を内視鏡 71 に設けている。

この内視鏡 71 は、挿入部 72 の先端に設けられた硬質の先端部 73 には、照明光を出射する照明窓と観察（撮像）を行う観察窓とが設けてある。照明窓にはライトガイド 74 の先端側が取り付けられてあり、その先端面から照明光を出射する。なお、ライトガイド 74 の図示しない手元側の端面には、図示しない内視鏡光源装置から照明光が入射される。

【0084】

また、観察窓には対物レンズ 75 が取り付けられてあり、その結像位置には撮像素子として例えば CCD 76 が配置されている。この CCD 76 は、図示しないビデオプロセッサ等の信号処理装置と接続され、この信号処理装置は、CCD 76 により撮像された画像信号に対する信号処理を行って映像信号を生成し、図示しないモニタに映像信号を出力する。

また、この挿入部 72 にはその長手方向に処置具類を挿通可能とするチャンネル 77 が設けてあり、このチャンネル 77 内に光ファイバ 52b が挿通される。

また、本変形例における内視鏡 71 においては、例えば先端部 73 の先端面にスキャニングデバイス 79 が取り付けられ、このスキャニングデバイス 79 の駆動面に超音波トランスジューサ 78 が取り付けられている。

【0085】

そして、スキャンング信号発生回路 24 のスキャンング信号をスキャンングデバイス 79 に印加することにより、超音波トランスジューサ 78 を 2 次元的にスキャンすることができるようにしている。

なお、本変形例における超音波トランスジューサ 78 は例えば電子走査型の超音波トランスジューサにより構成され、この超音波トランスジューサは例えば図 28 における x 方向に沿って複数配置されたトランスジューサエレメントにより構成され、図示しない遅延素子等を介して遅延時間を制御して駆動することにより超音波を収束させるように出射させ、収束点 F で収束させることができるようにしている。

そして、図 28 に示すように光ファイバ 52b の先端面から出射される光の照射部位内の領域において、超音波の収束点 F を設定し、この状態でスキャンングデバイス 79 をスキャンング信号で駆動することにより収束点 F を 2 次元的にスキャンする。

10

【0086】

その他の構成は図 24 と同様であり、その説明を省略する。本変形例によれば、内視鏡 71 により体腔内の生体組織 7 を内視鏡検査することができる。そして、病変部等、より詳しく観察或いは診断したい部位に対しては図 28 に示すようにチャンネル 77 内に光ファイバ 52b を挿通して、その先端面を観察対象部位に対向させる。

そして、パルス発生器 21 からパワーアンプ 22 を介してパルス状超音波駆動信号を発生させると共に、スキャンング信号も発生させて、観察対象部位の周辺部に対する 2 次元イメージング情報を取得し、モニタ 35 の表示面に表示する。

本変形例においては、内視鏡 71 に光を照射する光照射部と、超音波を収束させるように照射する超音波照射手段と、超音波の収束領域を 2 次元的にスキャンするスキャンング手段とを設けているので、体腔内における所望とする部位の生体組織 7 に対する光イメージング情報を得ることができる。

20

【0087】

従って、体腔内の患部等の生体組織 7 を光学的に内視鏡検査し、その場合に病変部のように、より詳しく診断したい部位に対して、光イメージング情報を取得し、モニタ 35 に表示させるようにすることができる。このようにすることにより、内視鏡検査のみの場合よりも、病変部をよりの確に診断するのに有益な情報を得ることができる。

なお、本変形例を変形した第 3 変形例として以下に説明するように、例えばチャンネル 77 の先端開口部分に、実施例 4 における超音波を収束して照射する機能と、スキャンング手段の機能も備えた光照射・受光部 54b を設けるようにしても良い。

30

図 29 は、実施例 6 の第 3 変形例の内視鏡装置 1x における内視鏡 71 の先端部付近の構成を示す。本変形例は、図 24 の光照射・受光部 54b をチャンネル 77 の先端開口に着脱自在に取り付けた構成にしたものである。このような構成にすることにより、既存の内視鏡のチャンネルに光照射・受光部 54b を取り付けて光イメージング情報を得ることができる。なお、図 27 の構成のものを同様に内視鏡に適用しても良い。この場合にも同様の効果を得ることができる。

【0088】

また、図 30 は第 4 変形例における光ファイバ 52b の端部の構成例を示す。図 25 で示したようにこの光ファイバ 52b は、その中央部に第 1 の光ファイバ部 60a が配置され、その周囲に複数のファイバからなる第 2 の光ファイバ部 60b が配置されている。図 30 の光ファイバ 52b においては、第 2 の光ファイバ部 60b の端面が中央部の第 1 の光ファイバ部 60a の軸に関して回転対称となる放物面等の凹面を形成するように加工されており、さらにその端面には集光するコリメートレンズ（或いは集光レンズ）60c が取り付けられている。

40

そして、各第 2 の光ファイバ部 60b の端面から出射される光を焦点位置 F₀ にフォーカスすることができるようにしている。このようにすることにより、S/N が良い光イメージング情報を取得できる。

【0089】

上記各実施例においては、超音波としてパルス又は連続波のいずれでも良く、さらに光

50

検出器 4 a は、点検出器である Photodiode や光電子倍增管、1 次元ライン型検出器や CCD 等の 2 次元検出器のいずれを用いても良い。

【0090】

また、上記各実施例においては、フーリエ変換にてドップラーシフト量を検出する構成にしても良い。

【実施例 7】

【0091】

次に図 3 1 から図 3 4 を参照して本発明の実施例 7 を説明する。図 3 1 は本発明の実施例 7 の光イメージング装置 1 Z の構成を示す。本実施例は、超音波出射部と、光照射及び光検出部とが一体的に形成された超音波出射・光照射・検出部がラインに沿って複数個、1 次元的に配列された超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 を採用した構成である。この構成により、1 つの超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 を用いてスキャンニングを行うこと無しで 1 次元の光イメージング情報を得られるようにしたものである。これにより、1 次元の光イメージング情報を時間短縮して得られる効果を有する。

10

【0092】

また、この超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 を 1 次元的にスキャンニングすることにより、2 次元の光イメージング情報が得られる。

なお、後述するように複数の超音波出射・光照射・検出部が 2 次元的に配置された超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 B を採用することにより、超音波トランスジューサ等のスキャンニングを行わないでも 2 次元のイメージング情報を得ることもできる。

20

【0093】

なお、本実施例は、ドップラーシフト量 Δf を抽出することにより、散乱情報を算出するタイプの構成となっている。

光源装置 9 1 から出射される可視或いは近赤外の波長領域の光は、複数本（例えば p 本）の光ファイバを配列して構成された光ファイバアレイ 9 2 a を構成する各光ファイバに入射される。各光ファイバに入射された光は、光カプラ部 9 3 で光ファイバアレイ 9 2 c の光ファイバ側と光ファイバアレイ 9 2 b 側の光ファイバ 9 2 b i（i は 1 ~ p の 1 つを代表）とに分岐される。

【0094】

光ファイバアレイ 9 2 c の光ファイバに導光された光は、参照光生成部 5 5 において、図 2 4 の場合と同様に参照光が生成され、光カプラ部 9 3 側に戻る。

30

また、光ファイバアレイ 9 2 b 側の光ファイバ 9 2 b i に導光された光は、（超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 を構成する）超音波出射・光照射・検出部の超音波トランスジューサ 5 7 - i に設けた開口部を通して生体組織 7 側に照射される。

超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 は、図 3 1 の右下部分の拡大図に示すように例えば x 方向に複数の超音波出射・光照射・検出部が配置されている。そして、各超音波出射・光照射・検出部は、その構成要素となる超音波トランスジューサ 5 7 - i によりそれぞれ収束点 F で超音波を収束する。

【0095】

かつその収束点 F には、光ファイバアレイ 9 2 b を構成する光ファイバ 9 2 b i の端面による光照射・検出部から光が照射されると共に、その収束点 F の近傍領域 R 1 を経たドップラーシフトした戻り光を受光する。

40

光ファイバアレイ 9 2 b の光ファイバ 9 2 b i により受光された光は、観測光として、光カプラ部 9 3 において光ファイバアレイ 9 2 c 側の光ファイバによる参照光と光混合されてドップラーシフトした干渉光が生成される。

各干渉光は、光ファイバアレイ 9 2 d の光ファイバにより導光され、その端面から光検出器アレイ 9 6 を構成する各光検出器 4 a にて受光され、光電変換される。光検出器アレイ 9 6 を構成する光検出器 4 a でそれぞれ光電変換された出力信号は、例えば複数チャンネルのスペクトルアナライザ 5 e に入力される。

【0096】

50

そして、このスペクトルアナライザ 5 e により各光検出器 4 a から出力されるドップラシフト量 Δf の干渉信号を殆ど同時に抽出する。

このスペクトルアナライザ 5 e から出力される複数の干渉信号は、P C 6 a における複数の入力チャンネルから P C 6 a 内のメモリなどにストックされる。

また、本実施例におけるスキヤニング信号発生回路 2 4 B は、例えば超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 が取り付けられたスキヤニングデバイス 9 8 を例えば y 方向にスキヤンさせるように駆動する。そして、2 次元の光イメージング情報を得られるようにしている。なお、ここではパルス発生器 2 1 ' は、図 2 4 のパルス発生器 2 1 とパワーアンプ 2 2 の機能を備えたものである。

【0097】

10

図 3 2 は、超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 を、例えば y 方向にスキヤンさせることにより、2 次元 (2 D) 光イメージング情報が得られる様子を示す。ライン状に配置された超音波出射・光照射・検出部により、x 方向の 1 次元 (1 D) 光イメージング情報が得られ、超音波出射・光照射・検出部を y 方向にスキヤンすることにより 2 次元光イメージング情報が得られる。

なお、スキヤニング信号発生回路 2 4 B により、超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 を y 方向及び z 方向に 2 次元スキヤンを行うように駆動して、3 次元光イメージング情報を得られるようにしても良い。

本実施例によれば、高速に 2 次元或いは 3 次元の光イメージング情報が得られる。

【0098】

20

なお、得られる光イメージング情報の x 方向の解像度は、光ファイバアレイ 9 2 b の本数に依存するため、x 方向にもスキヤンさせることにより、その解像度を飛躍的に向上させるようにしても良い。

図 3 3 は第 1 変形例の光イメージング装置における超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 B の概略の構成を示す。本変形例は、図 3 1 の光イメージング装置 1 Z において、光ファイバアレイ 9 2 a、9 2 b などを構成する光ファイバの本数をより多くしている (例えば図 3 1 の場合の整数倍以上)。これに対応して、超音波出射・光照射・検出部の数も増大する。

そして、本変形例では、光ファイバアレイ 9 2 b における端部側の超音波出射・光照射・検出部を x、y 方向に 2 次元的に配置して超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 B を構成している。

30

【0099】

図 3 3 に示すように光ファイバアレイ 9 2 b は、例えば p 本ずつの光ファイバ 9 2 b 1 ~ 9 2 b p が m 組、例えば帯状に設けられたものであり、これらの各光ファイバ 9 2 b i は、スキヤニングデバイス 9 8 に 2 次元的に設けた開口部にそれぞれ取り付けられている。

なお、このスキヤニングデバイス 9 8 の底面側には、図 3 1 で示したような超音波トランスジューサ (図 3 3 では図示せず) が取り付けられている。そして、この超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 B をスキヤンしない状態において、2 次元光イメージング情報 (図 3 4 参照) を得ることができるようになっている。

40

なお本変形例においては、P C 6 a もスペクトルアナライザ 5 e から出力される出力信号を超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 B を構成する超音波出射・光照射・検出部の 2 次元配列に対応したアドレスのメモリにストックする。

【0100】

また、本変形例では、スキヤニング信号により、スキヤニングデバイス 9 8 を z 方向に駆動することにより図 3 4 に示すように 3 次元光イメージング情報を得られるようにしている。

なお、本変形例に対しても、実施例 4 で説明したように x、y 方向にもスキヤンすることにより、より高解像度の光イメージング情報を得るようにしても良い。本変形例においても高速に 2 次元或いは 3 次元の光イメージング情報を得ることができる。

50

なお、本変形例におけるさらに変形例として、スキャニングを行わないで２次元の光イメージング情報を得るようにしても良い。

【０１０１】

なお、上述した各実施例において、光を収束させる構成にしても良い。上記の各実施例では、パルス超音波、又は連続超音波のいずれを用いてもよい。また、スペクトラルアナライザなどの信号処理回路を用いずにフーリエ変換によりドップラーシフト量を検出しても良い。

なお、上記の各実施例においては、複素屈折率の実部に基づく光散乱情報を検出するものであるが、例えば、蛍光、りん光等の非弾性散乱情報に基づいて生体組織の情報を取得しても良い。

10

また、上述した各実施例を部分的に組み合わせる等して構成される実施例等も本発明に属する。

【産業上の利用可能性】

【０１０２】

生体組織に超音波が照射された検査対象部位に光を照射し、超音波が照射された部位でドップラーシフトした光を観測光として検出し、複素屈折率の実部に相当する光散乱情報を検出して画像化できるようにすることにより、病変組織の構造変化に相関性が高い情報を得ることができ、病変組織の診断等に有効利用することができる。

【図面の簡単な説明】

【０１０３】

20

【図１】図１は本発明の被検体情報分析装置の代表的な構成例を示すブロック図。

【図２】本発明の実施例１に係る光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図３】図３は超音波収束領域付近においてドップラーシフトする様子の説明図。

【図４】図４は実施例１の動作説明用のフローチャート。

【図５】図５はフーリエ変換された信号の実数成分の角周波数に対する波形例を示す図。

【図６】図６は第１変形例におけるレンズ保持部及びトランスジューサ保持部の構造を示す図。

【図７】図７は第２変形例における超音波の収束点近傍領域でのドップラーシフトする様子の説明図。

【図８】図８は本発明の実施例２に係る光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

30

【図９】図９は実施例２の変形例におけるレンズ保持部及びトランスジューサ保持部の構造を示す図。

【図１０】図１０は本発明の実施例３に係る光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図１１】図１１は実施例３の動作説明用のフローチャート。

【図１２】図１２はフーリエ変換された信号の実数成分の角周波数に対する波形例を示す図。

【図１３】図１３は第１変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図１４】図１４は第２変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

40

【図１５】図１５は本発明の実施例４に係る光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図１６】図１６は実施例４の動作説明用のフローチャート。

【図１７】図１７は実施例４の変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図１８】図１８は実施例５に係る光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図１９】図１９は実施例５の動作説明用のタイミングチャート。

【図２０】図２０は実施例５の第１変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図２１】図２１は実施例５の第２変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロッ

50

ク図。

【図 2 2】図 2 2 は実施例 5 の第 3 変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図 2 3】図 2 3 は実施例 5 の第 4 変形例における一部の構成を示す図。

【図 2 4】図 2 4 は本発明の実施例 6 に係る光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図 2 5】図 2 5 は光ファイバの端面の構造を示す図。

【図 2 6】図 2 6 は光カプラの構成例を示す図。

【図 2 7】図 2 7 は実施例 6 の第 1 変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

10

【図 2 8】図 2 8 は光イメージング装置を備えた第 2 変形例に係る内視鏡装置の構成を示すブロック図。

【図 2 9】図 2 9 は第 3 変形例の光イメージング装置における内視鏡の先端側の構成を示す図。

【図 3 0】図 3 0 は第 4 変形例における光ファイバの構成を示す斜視図。

【図 3 1】図 3 1 は本発明の実施例 7 に係る光イメージング装置の構成を示すブロック図。

【図 3 2】図 3 2 は実施例 7 における 1 次元走査により 2 次元光イメージング情報が得られる動作の説明図。

【図 3 3】図 3 3 は第 1 変形例における超音波・光照射・検出アレイ部の概略の構成を示す図。

20

【図 3 4】図 3 4 は図 3 3 の超音波・光照射・検出アレイ部による動作の説明図。

【符号の説明】

【0 1 0 4】

1 E、1 F ... 光イメージング装置

2 ... 超音波発生部

2 a ... 超音波トランスジューサ

3 ... 照明光発生部

3 b ... 光源装置

4 ... 反射光受光部

30

4 a ... 光検出器

5 ... 周波数情報抽出部

5 c ... 信号処理回路

6 ... 散乱情報抽出部

6 ' ... 被検体情報生成部

6 a ... P C

7 ... 生体組織

1 1 ... ユニット

1 2 ... スキャニングユニット

1 3 a ... ハーフミラー

40

1 6 ... 音響レンズ


2 4 ... スキャニング信号発生回路

3 3 ... C P U


3 5 ... モニタ

3 8 ... コリメートレンズ


【図 1】

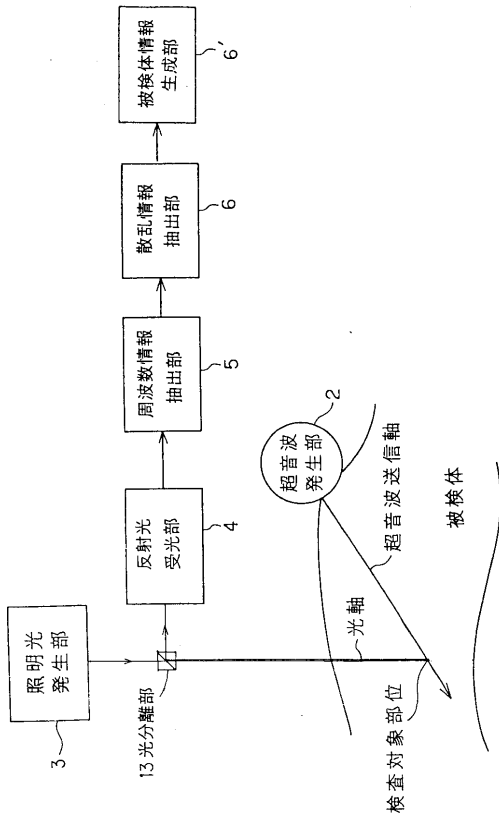


【図 2】

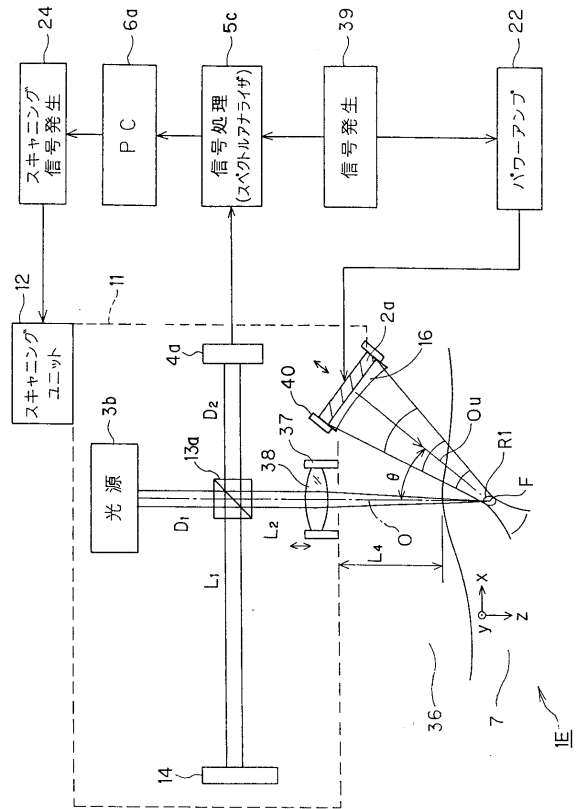


【図 3】

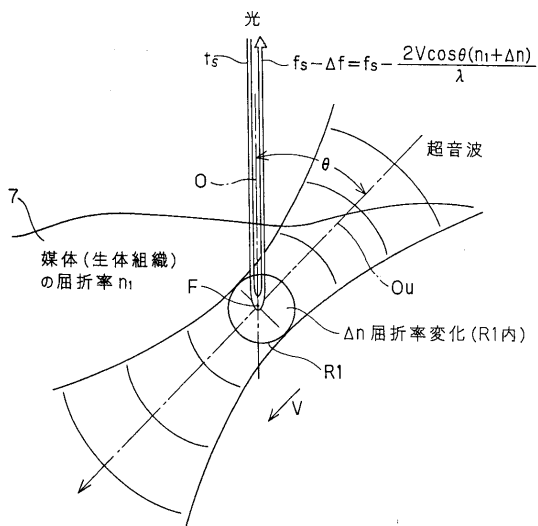


【図 4】

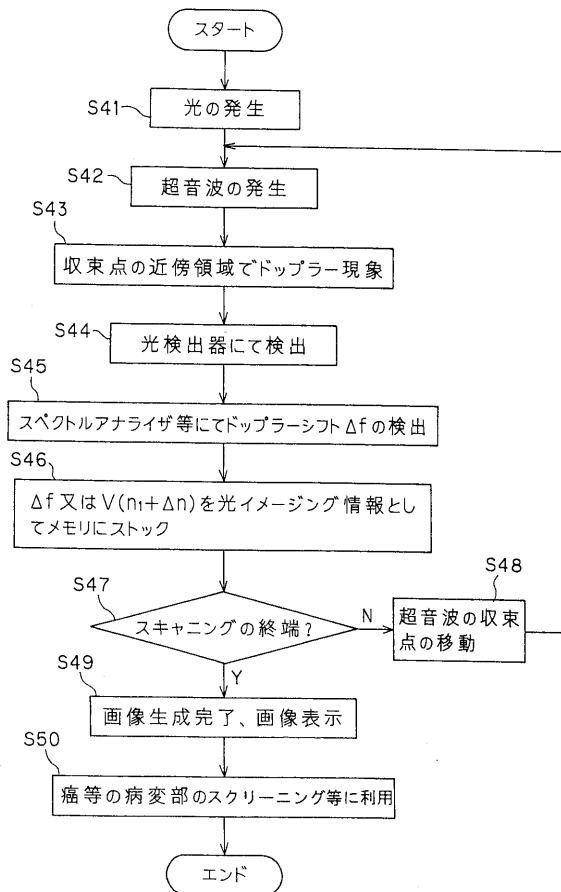


【図 5】

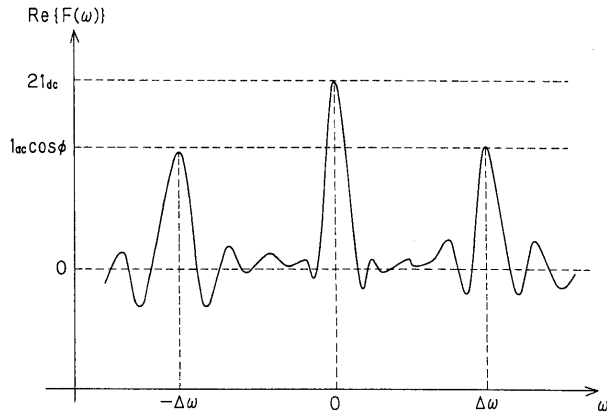


【図 6】

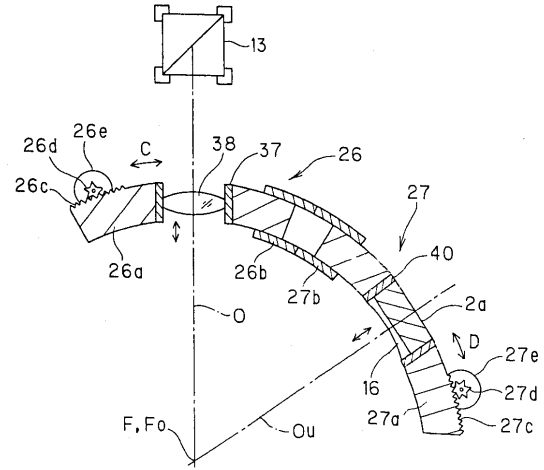


【図 7】

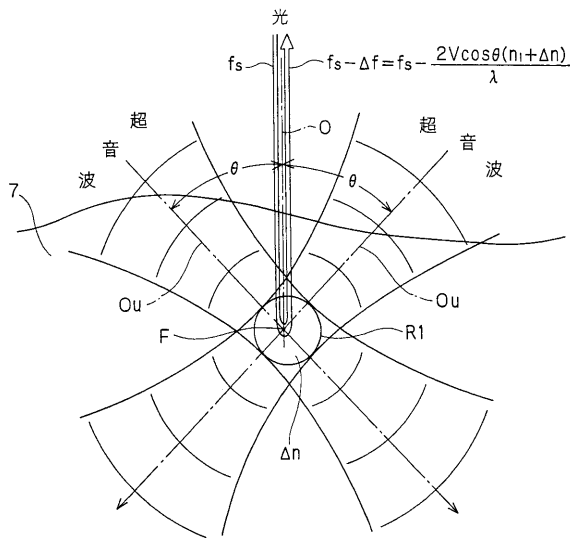


【図 8】

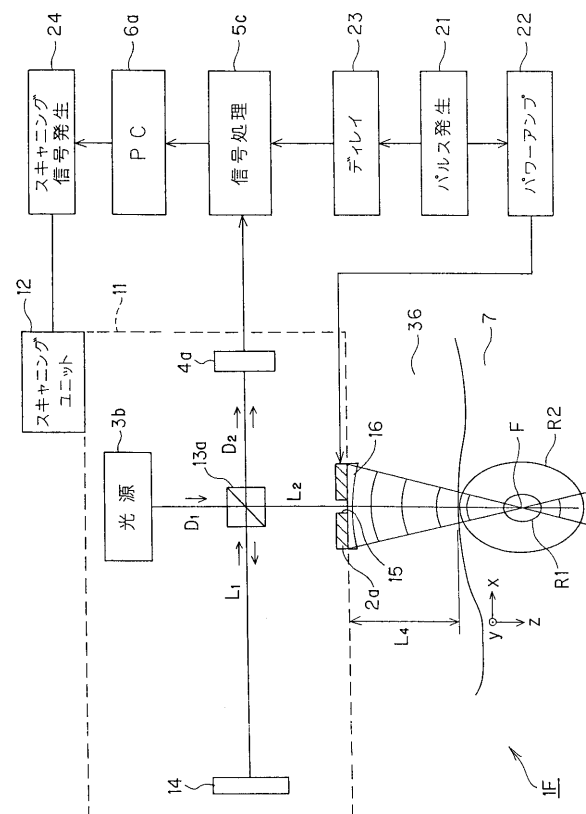


【図 9】

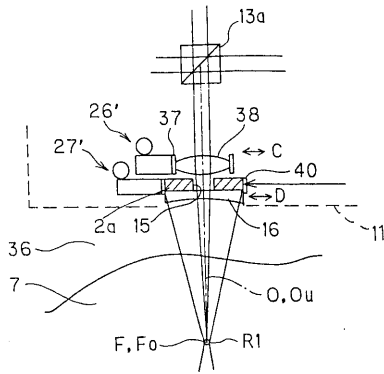


【図 10】

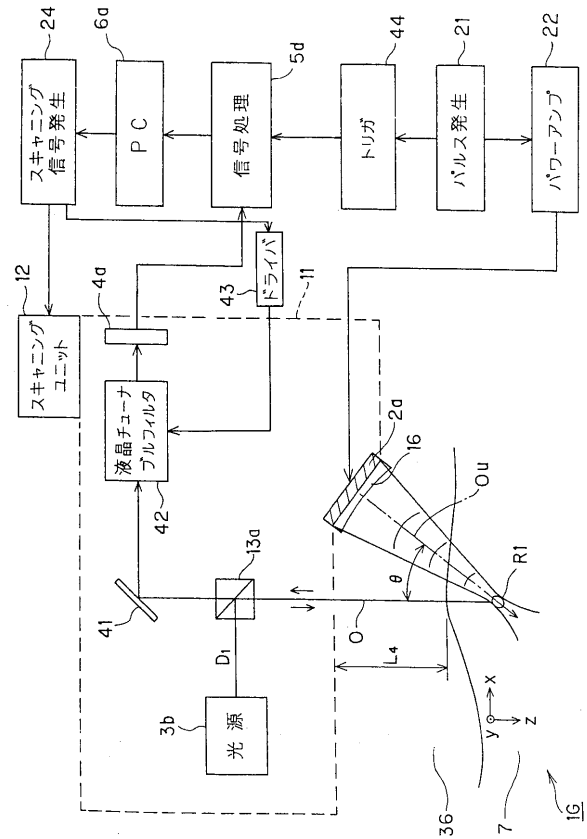


【図 11】

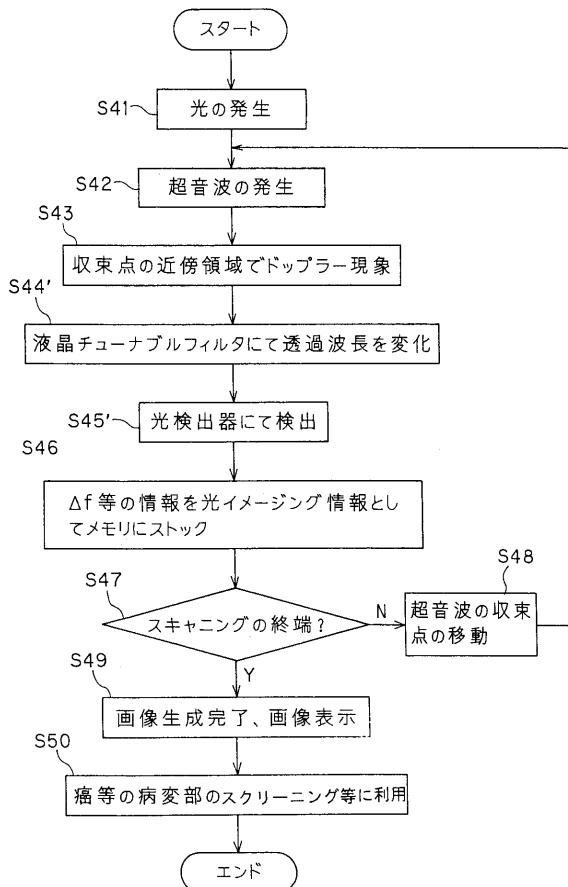


【図 12】

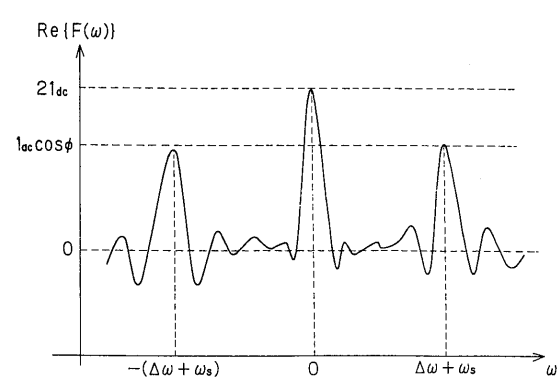


【図 13】

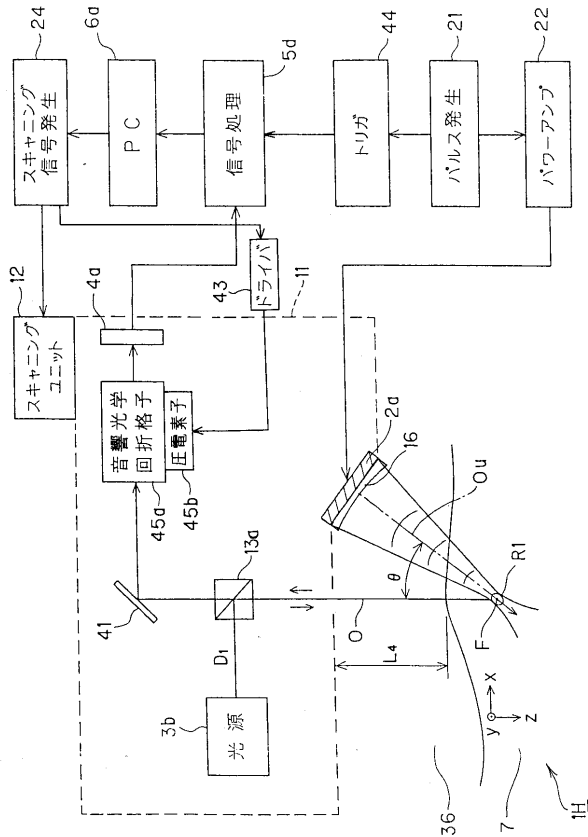


【図 14】

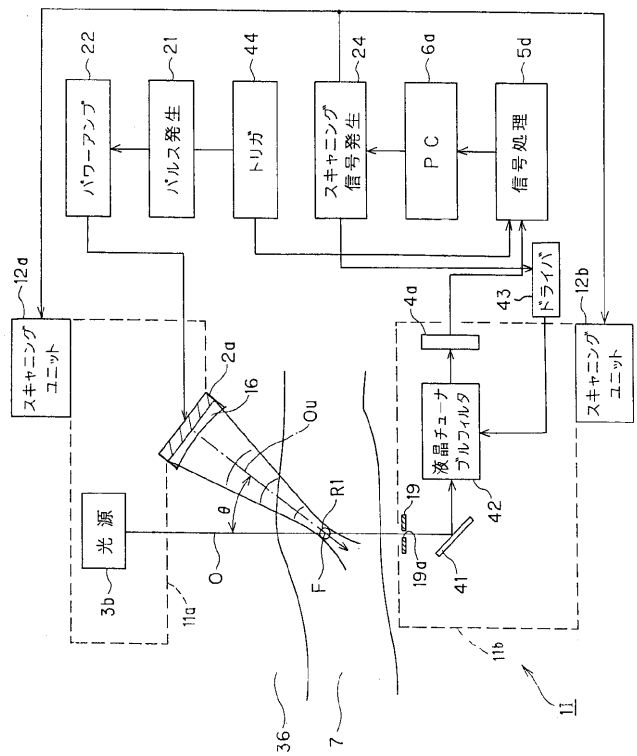


【図 15】

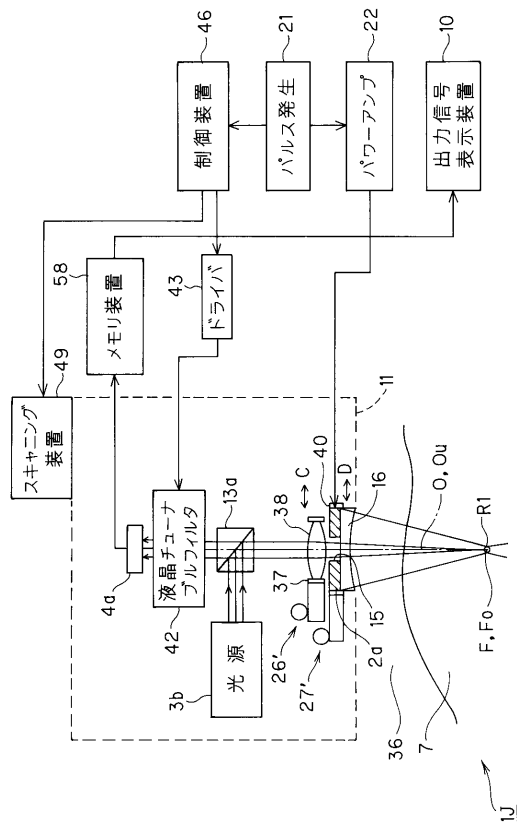


【図 16】

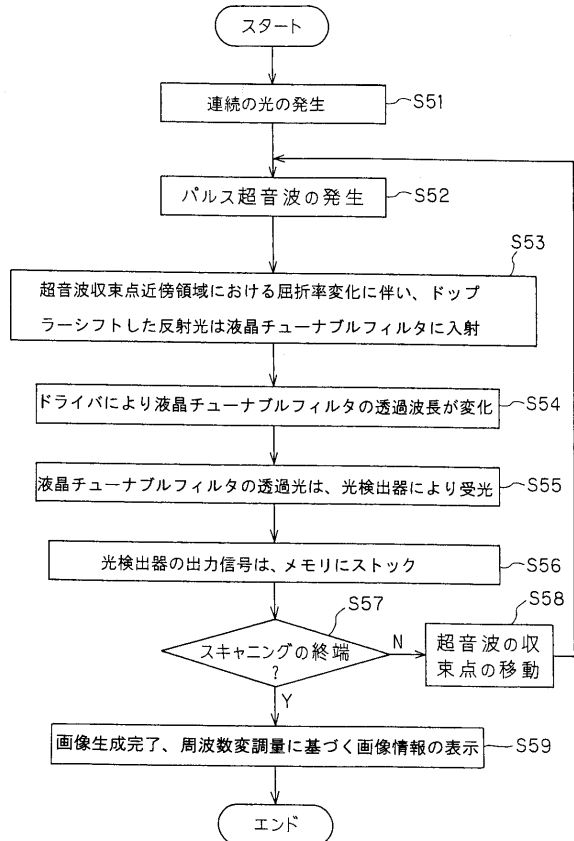


【図 17】

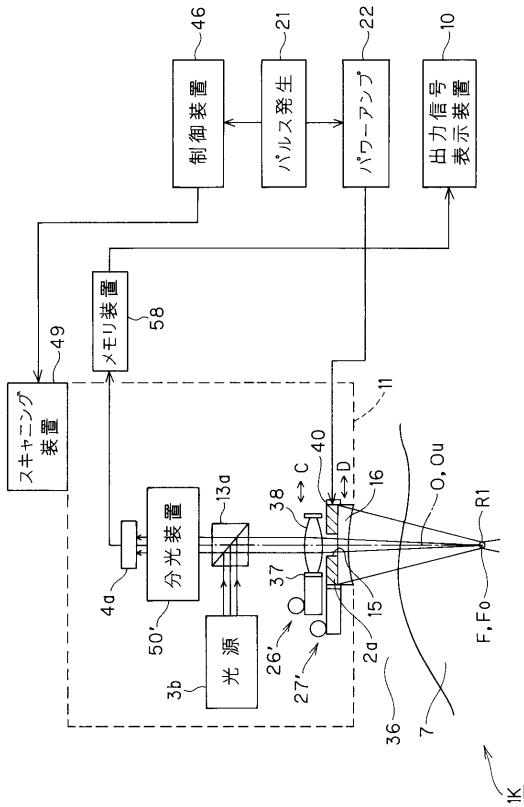


【図 18】

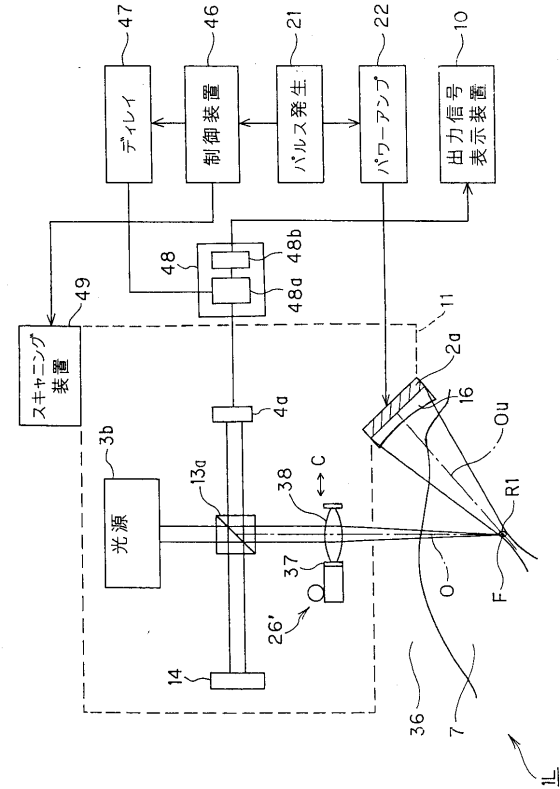


【図 19】

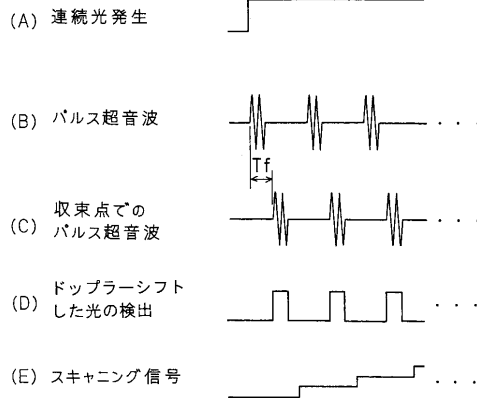


【図 20】

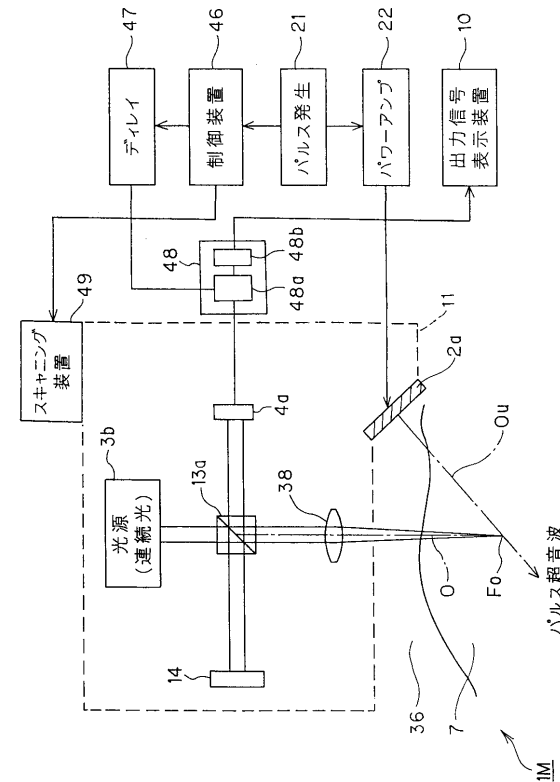


【図 2 1】

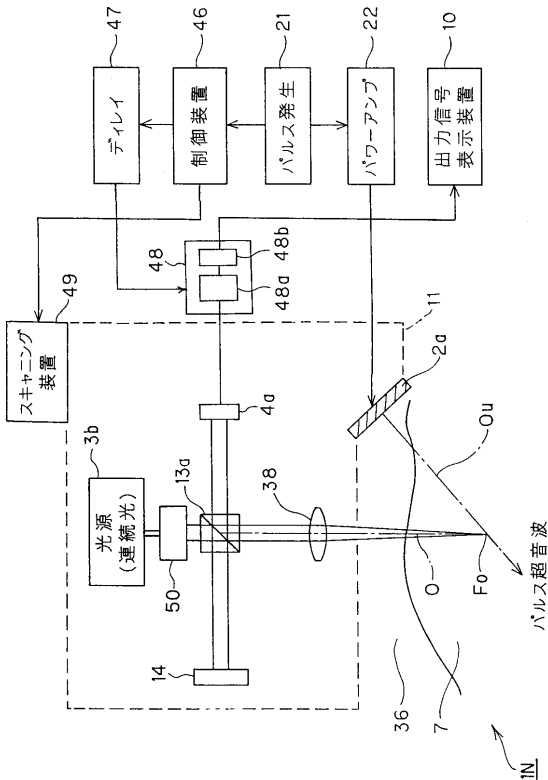


【図 2 2】

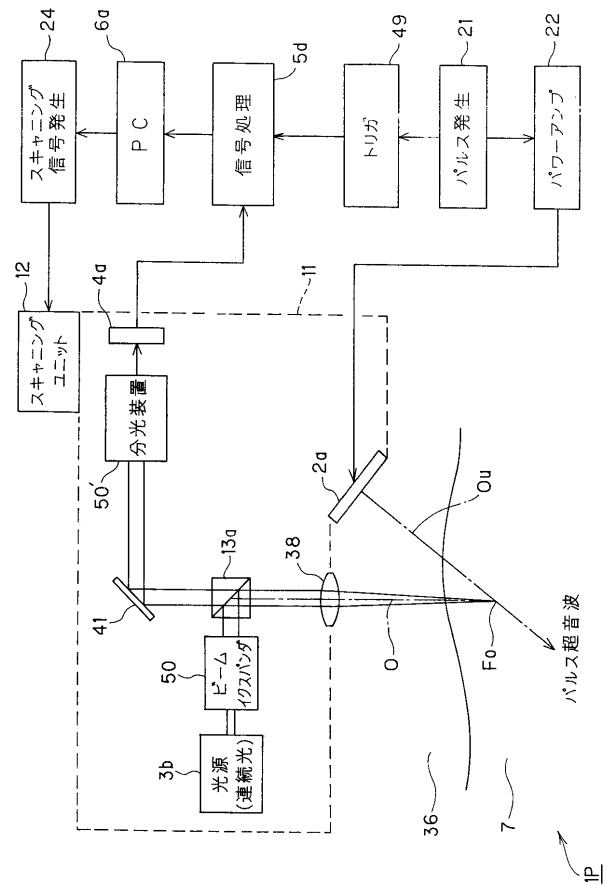


【図 2 3】

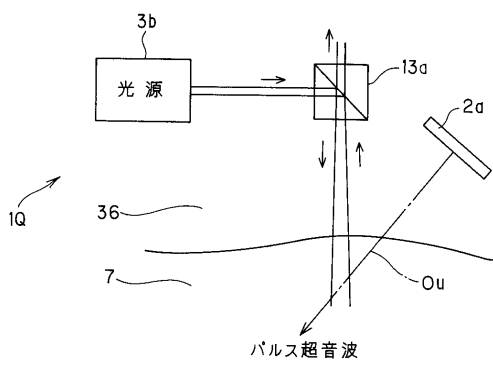


【図 2 4】

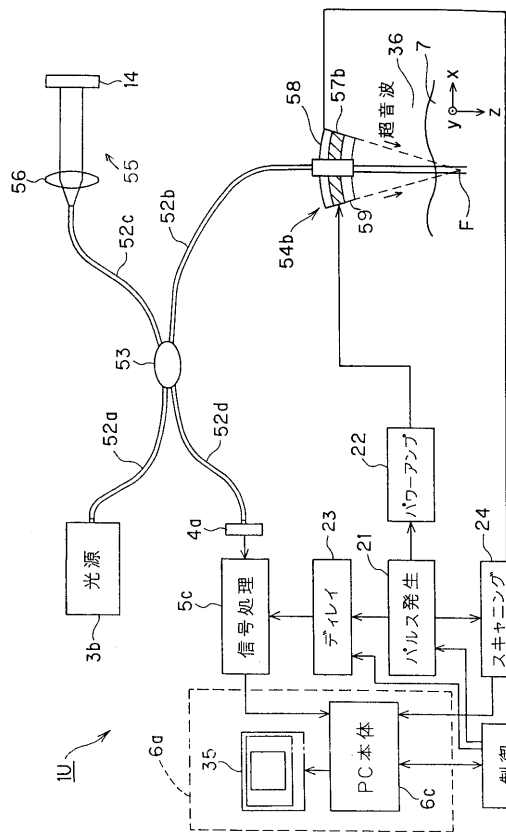


【図 25】

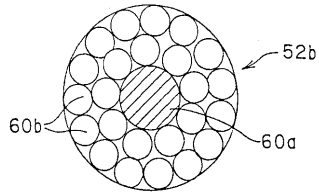


【図 26】

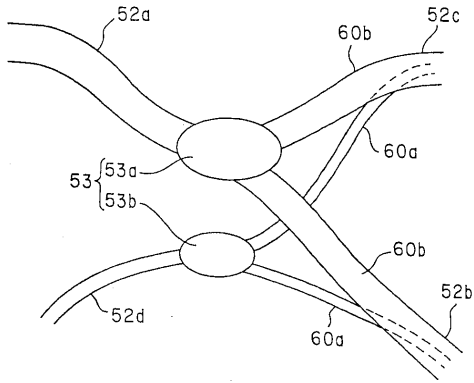


【図 28】

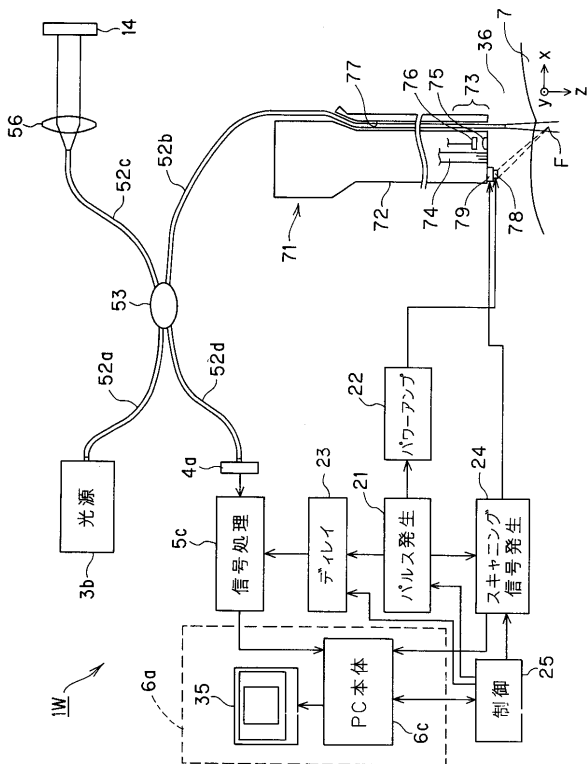


【図 27】

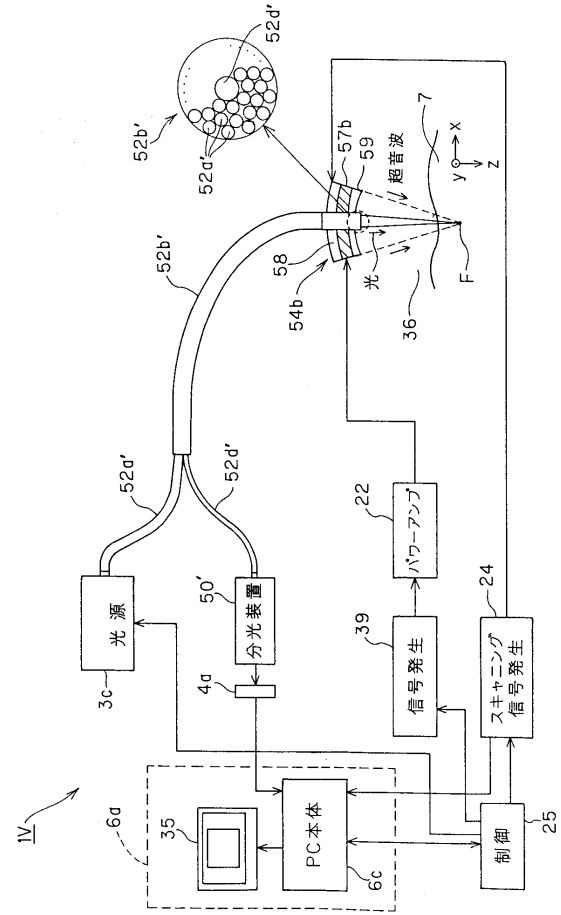


【図 29】

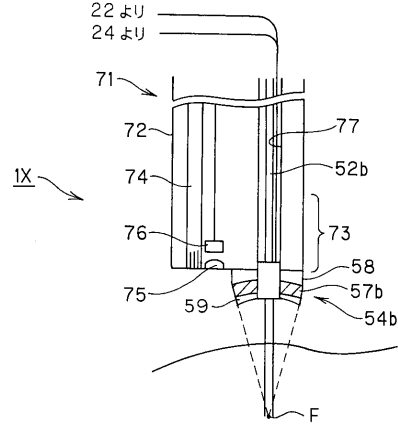


【 図 3 1 】

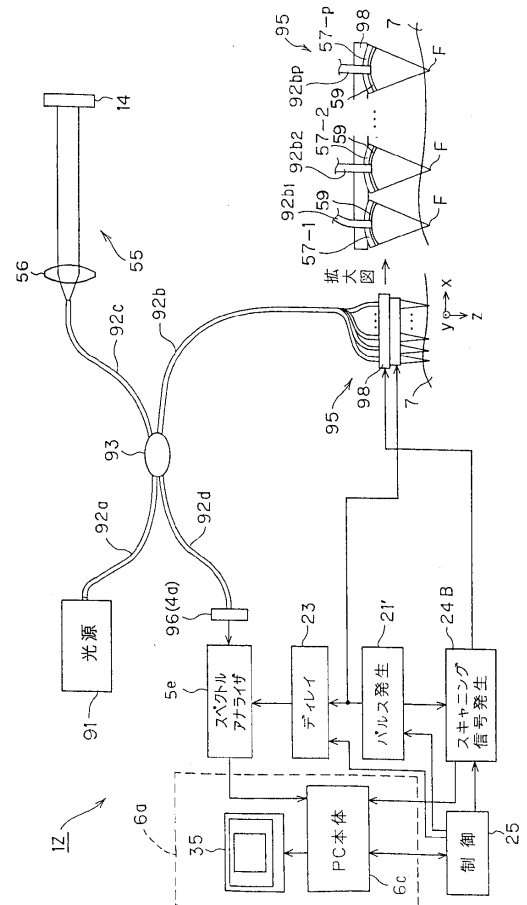

【 ㄨ 3 3 】

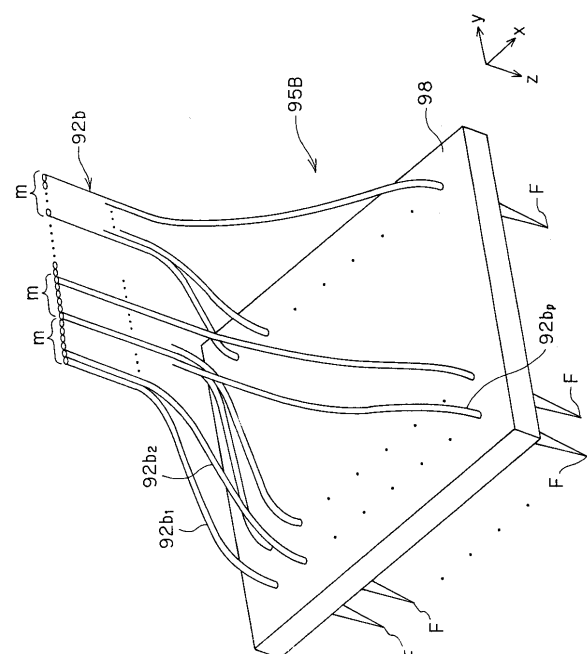

【図 3 4】

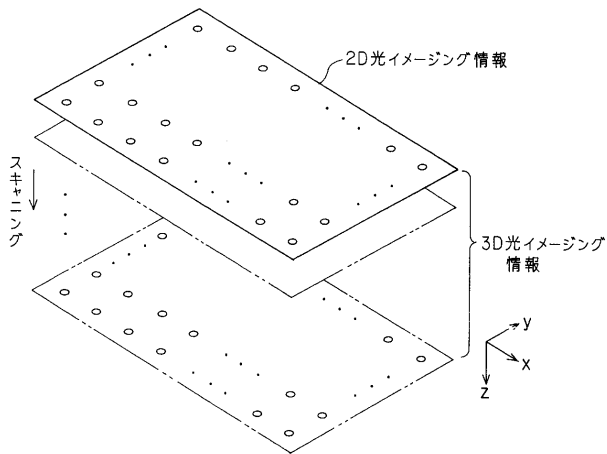

【手続補正書】

【提出日】平成19年4月3日(2007.4.3)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、
 前記超音波発生手段によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における
 検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生手段と、
 前記照明光が到達した前記検査対象部位からの周波数変調された光を受光する受光手段
 と、

前記周波数変調された光の周波数情報を光学的又は電氣的に抽出する周波数情報抽出手
 段と、

前記周波数情報抽出手段で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記
 検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達し
 た前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、
 を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

【請求項 2】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、
 前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記超音波発生手段によ
 って発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照

明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記照明光が到達した前記検査対象部位から反射される光を受光可能に設けられた反射光受光手段と、

前記反射光受光手段で受光された受光信号から得られる周波数情報を抽出する周波数情報抽出手段と、

前記周波数情報抽出手段で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、
を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

【請求項 3】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記超音波発生手段によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記照明光が到達した前記検査対象部位から反射される光を受光可能に設けられた反射光受光手段と、

前記照明光発生手段によって発生される照明光と前記反射光受光手段によって受光された反射光とを干渉させて周波数情報を抽出する周波数情報抽出手段と、

前記周波数情報抽出手段で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、
を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

【請求項 4】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記超音波発生手段によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記照明光が到達した前記検査対象部位から反射される光を受光可能に設けられた反射光受光手段と、

前記反射光受光手段で受光された反射光を分光する分光手段と、

前記分光手段で分光された分光結果に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、
を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

【請求項 5】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記超音波発生手段によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記照明光が到達した前記検査対象部位から反射される光を受光可能に設けられた反射光受光手段と、

前記反射光受光手段で受光した受光信号を周波数変換して周波数成分を抽出する周波数成分抽出手段と、

前記周波数成分抽出手段で抽出された周波数成分に基づき前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、

を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

【請求項 6】

前記周波数成分抽出手段は、フーリエ変換により周波数成分を抽出するフーリエ変換手段を有することを特徴とする請求項 5 記載の被検体情報分析装置。

【請求項 7】

前記周波数成分抽出手段は、ウェーブレット変換により周波数成分を抽出するウェーブレット変換手段を有することを特徴とする請求項 5 記載の被検体情報分析装置。

【請求項 8】

前記超音波発生手段は、前記被検体の所定の位置に焦点を結ぶ焦点調整部を有することを特徴とする請求項 1 ないし 7 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 9】

前記照明光発生手段は、照明光を前記超音波の照射される位置内の所定の位置に収束させる照明光収束部を有することを特徴とする請求項 1 ないし 8 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 10】

前記被検体情報生成手段によって生成された前記被検体の特性情報に基づいて画像を形成する画像形成手段を有することを特徴とする請求項 1 ないし 9 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 11】

前記超音波発生手段は、前記超音波をパルス波として発生させるパルス超音波発生部を有することを特徴とする請求項 1 ないし 10 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 12】

前記照明光発生手段は、前記照明光をパルス光として照射させるパルス光発生部を有することを特徴とする請求項 1 ないし 10 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 13】

前記照明光発生手段による照明光の照射位置が少なくとも一次元的に変化するように走査させる走査手段を有することを特徴とする請求項 1 ないし 12 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 14】

前記光の散乱情報は、前記検査対象部位の複素屈折率の実部に相当する情報であることを特徴とする請求項 1 ないし 13 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 15】

前記光の散乱情報は、非弾性散乱情報であることを特徴とする請求項 1 ないし 13 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 16】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生部、前記超音波発生部によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生部、前記照明光が到達した検査対象部位から反射される周波数変調された光を受光可能に設けられた反射光受光部と、

前記反射光受光部で受光された受光信号に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する情報抽出部と、

前記情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成部と、

を有することを特徴とする内視鏡装置。

【請求項 17】

前記照明光発生部は、前記超音波発生部の周辺に配置され、

前記情報抽出部は、前記反射光受光部で受光された受光信号から得られる周波数情報を抽出する周波数情報抽出部と、前記周波数情報抽出部で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部とを有し、

前記被検体情報生成部は、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成することを特徴とする請求項 16 に記載の内視鏡装置。

【請求項 18】

前記照明光発生部は、前記超音波発生部の周辺に配置され、

前記情報抽出部は、前記照明光発生部によって発生される照明光と前記反射光受光部によって受光された反射光とを干渉させて周波数情報を抽出する周波数情報抽出部と、前記周波数情報抽出部で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部と、

前記被検体情報生成部は、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成することを特徴とする請求項 16 に記載の内視鏡装置。

【請求項 19】

前記照明光発生部は、前記超音波発生部の周辺に配置され、

前記情報抽出部は、前記反射光受光部で受光した受光信号を周波数変換して周波数成分を抽出する周波数成分抽出部と、前記周波数成分抽出部で抽出された周波数成分に基づき前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部とを有し、

前記被検体情報生成部は、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成することを特徴とする請求項 16 に記載の内視鏡装置。

【請求項 20】

前記周波数成分抽出部は、フーリエ変換により周波数成分を抽出するフーリエ変換部を有することを特徴とする請求項 17 に記載の内視鏡装置。

【請求項 21】

前記光の散乱情報は、前記検査対象部位の複素屈折率の実部に相当する情報であることを特徴とする請求項 16 ないし 20 の何れかに記載の内視鏡装置。

【請求項 22】

前記光の散乱情報は、非弾性散乱情報であることを特徴とする請求項 16 ないし 20 の何れかに記載の内視鏡装置。

【請求項 23】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生する超音波発生工程と、

前記超音波発生工程によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生する照明光発生工程と、

前記照明光が到達した前記検査対象部位からの周波数変調された光を受光する受光工程と、

前記周波数変調された光の周波数情報を光学的又は電氣的に抽出する周波数情報抽出工程と、

前記周波数情報抽出工程で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出工程と、

前記散乱情報抽出工程によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成工程と、
を具備したことを特徴とする被検体情報分析方法。

【請求項 24】

超音波発生部により所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生する超音波発生工程と、

照明光発生部により前記超音波の照射される位置内の所定の位置に到達する照明光を発生する照明光発生工程と、

反射光受光部によって前記照明光が到達した位置に対応する部位から反射される光を受光する反射光受光工程と、

前記反射工程受光工程で受光された受光信号から得られる周波数情報を抽出する周波数情報抽出工程と、

前記周波数情報抽出工程で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出工程と、

前記散乱情報抽出工程で抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成工程と、

を有することを特徴とする被検体情報分析方法。

【請求項 25】

前記光の散乱情報は、前記検査対象部位の複素屈折率の実部に相当する情報であることを特徴とする請求項 23 または 24 に記載の被検体情報分析方法。

【請求項 26】

前記光の散乱情報は、非弾性散乱情報であることを特徴とする請求項 23 または 24 に記載の被検体情報分析方法。

フロントページの続き

F ターム(参考) 2G059 AA02 AA06 BB12 CC16 EE02 EE07 EE09 EE12 EE16 FF02
HH01 HH06 JJ01 JJ02 JJ11 JJ17 JJ18 JJ22 KK04 MM01
MM10 PP04
4C061 BB08 GG01 HH51
4C601 DD23 EE30 LL40

专利名称(译)	被検体情報分析装置、内视镜装置及び被検体情報分析方法		
公开(公告)号	JP2008170363A	公开(公告)日	2008-07-24
申请号	JP2007005678	申请日	2007-01-15
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯医疗株式会社		
申请(专利权)人(译)	オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
[标]发明人	五十嵐 誠		
发明人	五十嵐 誠		
IPC分类号	G01N21/17 A61B1/00 A61B10/00 G01B17/06 A61B8/00		
FI分类号	G01N21/17.630 A61B1/00.300.D A61B10/00.E G01B17/06 A61B8/00 A61B1/00.550		
F-TERM分类号	2F068/AA38 2F068/CC07 2F068/DD11 2F068/FF03 2F068/FF28 2F068/GG07 2F068/GG09 2F068/JJ12 2F068/KK14 2F068/LL25 2F068/QQ10 2F068/QQ12 2F068/QQ31 2G059/AA02 2G059/AA06 2G059/BB12 2G059/CC16 2G059/EE02 2G059/EE07 2G059/EE09 2G059/EE12 2G059/EE16 2G059/FF02 2G059/HH01 2G059/HH06 2G059/JJ01 2G059/JJ02 2G059/JJ11 2G059/JJ17 2G059/JJ18 2G059/JJ22 2G059/KK04 2G059/MM01 2G059/MM10 2G059/PP04 4C061/BB08 4C061/GG01 4C061/HH51 4C601/DD23 4C601/EE30 4C601/LL40 4C161/BB08 4C161/GG01 4C161/HH51		
代理人(译)	伊藤 进		
其他公开文献	JP4939236B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供样本数据分析器，用于容易地获取包含样本的检查目标区域的光散射数据的样本的特征数据，内窥镜装置和样本数据分析方法。ZOLUTION：超声波产生部分2在样本中朝向预定的超声波透射轴产生超声波，并且照明光产生部分3产生照明光，以允许其到达样本中的检查目标区域。超声波被传输。通过反射光检测部分4检测在检查目标区域中频率调制的光，并且通过提取由于a的频率数据而形成对应于样本的检查目标区域的样本的特征数据。频率数据提取部分5来自检测信号，由于散射数据提取部分6，相对于检查目标区域提取光的散射数据。Z

