

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第4939236号
(P4939236)

(45) 発行日 平成24年5月23日 (2012.5.23)

(24) 登録日 平成24年3月2日 (2012.3.2)

(51) Int. Cl.

F 1

G O 1 N 21/17 (2006.01)

A 6 1 B 1/00 (2006.01)

A 6 1 B 10/00 (2006.01)

G O 1 B 17/06 (2006.01)

A 6 1 B 8/00 (2006.01)

G O 1 N 21/17 6 3 0

A 6 1 B 1/00 3 0 0 D

A 6 1 B 10/00 E

G O 1 B 17/06

A 6 1 B 8/00

請求項の数 21 (全 37 頁)

(21) 出願番号 特願2007-5678 (P2007-5678)
 (22) 出願日 平成19年1月15日 (2007.1.15)
 (65) 公開番号 特開2008-170363 (P2008-170363A)
 (43) 公開日 平成20年7月24日 (2008.7.24)
 審査請求日 平成21年11月17日 (2009.11.17)

(73) 特許権者 304050923
 オリンパスメディカルシステムズ株式会社
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
 (74) 代理人 100076233
 弁理士 伊藤 進
 (72) 発明者 五十嵐 誠
 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ
 リンパスメディカルシステムズ株式会社内

審査官 尾崎 淳史

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 被検体情報分析装置、内視鏡装置及び被検体情報分析方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、
 前記超音波発生手段によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における
 検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記照明光が到達した前記検査対象部位からの周波数変調された光を受光する受光手段
 と、

前記周波数変調された光の周波数情報を光学的又は電氣的に抽出する周波数情報抽出手
 段と、

前記周波数情報抽出手段で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記
 検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達し
 た前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、
 を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

【請求項 2】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、
 前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記超音波発生手段によ
 って発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照
 明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記照明光が到達した前

10

20

記検査対象部位から反射される光を受光可能に設けられた反射光受光手段と、

前記反射光受光手段で受光された受光信号から得られる周波数情報を抽出する周波数情報抽出手段と、

前記周波数情報抽出手段で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、
を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

【請求項 3】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記超音波発生手段によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記照明光が到達した前記検査対象部位から反射される光を受光可能に設けられた反射光受光手段と、

前記照明光発生手段によって発生される照明光と前記反射光受光手段によって受光された反射光とを干渉させて周波数情報を抽出する周波数情報抽出手段と、

前記周波数情報抽出手段で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、
を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

【請求項 4】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記超音波発生手段によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記照明光が到達した前記検査対象部位から反射される光を受光可能に設けられた反射光受光手段と、

前記反射光受光手段で受光された反射光を分光する分光手段と、
前記分光手段で分光された分光結果に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、
を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

【請求項 5】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記超音波発生手段によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記被検体に対して前記超音波発生手段と同じ側に配置され、前記照明光が到達した前記検査対象部位から反射される光を受光可能に設けられた反射光受光手段と、

前記反射光受光手段で受光した受光信号を周波数変換して周波数成分を抽出する周波数成分抽出手段と、

前記周波数成分抽出手段で抽出された周波数成分に基づき前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、
を具備したことを特徴とする被検体情報分析装置。

【請求項 6】

前記周波数成分抽出手段は、フーリエ変換により周波数成分を抽出するフーリエ変換手段を有することを特徴とする請求項 5 記載の被検体情報分析装置。

【請求項 7】

前記周波数成分抽出手段は、ウェーブレット変換により周波数成分を抽出するウェーブレット変換手段を有することを特徴とする請求項 5 記載の被検体情報分析装置。

【請求項 8】

前記超音波発生手段は、前記被検体の所定の位置に焦点を結ぶ焦点調整部を有することを特徴とする請求項 1 ないし 7 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 9】

前記照明光発生手段は、照明光を前記超音波の照射される位置内の所定の位置に収束させる照明光収束部を有することを特徴とする請求項 1 ないし 8 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

10

【請求項 10】

前記被検体情報生成手段によって生成された前記被検体の特性情報に基づいて画像を形成する画像形成手段を有することを特徴とする請求項 1 ないし 9 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 11】

前記超音波発生手段は、前記超音波をパルス波として発生させるパルス超音波発生部を有することを特徴とする請求項 1 ないし 10 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 12】

20

前記照明光発生手段は、前記照明光をパルス光として照射させるパルス光発生部を有することを特徴とする請求項 1 ないし 10 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 13】

前記照明光発生手段による照明光の照射位置が少なくとも一次元的に変化するように走査させる走査手段を有することを特徴とする請求項 1 ないし 12 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 14】

前記光の散乱情報は、前記検査対象部位の複素屈折率の実部に相当する情報であることを特徴とする請求項 1 ないし 13 の何れかに記載の被検体情報分析装置。

【請求項 15】

30

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生部、前記超音波発生部によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生部、前記照明光が到達した検査対象部位から反射される周波数変調された光を受光可能に設けられた反射光受光部と、

前記反射光受光部で受光された受光信号に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部と、

前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成部と、

を有し、

前記照明光発生部は、前記超音波発生部の周辺に配置され、

40

前記情報抽出部は、前記反射光受光部で受光された受光信号から得られる周波数情報を抽出する周波数情報抽出部と、前記周波数情報抽出部で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部とを有し、

前記被検体情報生成部は、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成することを特徴とする内視鏡装置。

【請求項 16】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生部、前記超音波発生部によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部

50

位に到達する照明光を発生可能な照明光発生部、前記照明光が到達した検査対象部位から反射される周波数変調された光を受光可能に設けられた反射光受光部と、

前記反射光受光部で受光された受光信号に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部と、

前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成部と、

を有し、

前記照明光発生部は、前記超音波発生部の周辺に配置され、

前記情報抽出部は、前記照明光発生部によって発生される照明光と前記反射光受光部によって受光された反射光とを干渉させて周波数情報を抽出する周波数情報抽出部と、前記周波数情報抽出部で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部と、

前記被検体情報生成部は、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成することを特徴とする内視鏡装置。

【請求項 17】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生部、前記超音波発生部によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生部、前記照明光が到達した検査対象部位から反射される周波数変調された光を受光可能に設けられた反射光受光部と、

前記反射光受光部で受光された受光信号に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部と、

前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成部と、

を有し、

前記照明光発生部は、前記超音波発生部の周辺に配置され、

前記情報抽出部は、前記反射光受光部で受光した受光信号を周波数変換して周波数成分を抽出する周波数成分抽出部と、前記周波数成分抽出部で抽出された周波数成分に基づき前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部とを有し、

前記被検体情報生成部は、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成することを特徴とする内視鏡装置。

【請求項 18】

前記周波数成分抽出部は、フーリエ変換により周波数成分を抽出するフーリエ変換部を有することを特徴とする請求項 15 記載の内視鏡装置。

【請求項 19】

所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生する超音波発生工程と、

前記超音波発生工程によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生する照明光発生工程と、

前記照明光が到達した前記検査対象部位からの周波数変調された光を受光する受光工程と、

前記周波数変調された光の周波数情報を光学的又は電氣的に抽出する周波数情報抽出工程と、

前記周波数情報抽出工程で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出工程と、

前記散乱情報抽出工程によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成工程と、

を具備したことを特徴とする被検体情報分析方法。

【請求項 20】

超音波発生部により所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生する超音波発生工程と、

照明光発生部により前記超音波の照射される位置内の所定の位置に到達する照明光を発生する照明光発生工程と、

反射光受光部によって前記照明光が到達した位置に対応する部位から反射される光を受光する反射光受光工程と、

前記反射工程受光工程で受光された受光信号から得られる周波数情報を抽出する周波数情報抽出工程と、

前記周波数情報抽出工程で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出工程と、

前記散乱情報抽出工程で抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成工程と、

を有することを特徴とする被検体情報分析方法。

【請求項 2 1】

前記光の散乱情報は、前記検査対象部位の複素屈折率の実部に相当する情報であることを特徴とする請求項 1 9 または 2 0 に記載の被検体情報分析方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

本発明は、超音波を利用して被検体を光学的に分析する被検体情報分析装置、内視鏡装置及び被検体情報分析方法に関する。

【背景技術】

【0 0 0 2】

近年、生体の光断層イメージングを実現するものとして、光 C T や光コヒーレンス断層影像法 (Optical Coherence Tomography : 以下 O C T)、超音波断層影像法等、様々な技術が提案されている。

光 C T は生体内部での光散乱の影響が比較的弱い波長域 7 0 0 n m ~ 1 2 0 0 n m の近赤外光を利用するため、粘膜下数 c m までの生体深部の断層像を得ることができる。

また、干渉を利用した O C T は 2 m m 程度の深さまでの生体断層イメージを高分解能 (μm ~ 十数 μm) かつ短時間で取得することが可能である。O C T は眼科領域での網膜疾患診断において既に実用化されている技術であり、その医学的関心度は非常に高い。

【0 0 0 3】

光 C T は深部の情報は得られるが、空間分解能は数 m m 程度と非常に低い。一方、O C T は生体粘膜下約 2 m m 以深を観察すること、更に、癌等の腫瘍組織に対して良好な画質を得ることは難しい。

これは、生体深部及び腫瘍組織における、血液の吸収や強い散乱の影響により、光のコヒーレンス性が著しく乱れるためである。

一方、日坂らによる非特許文献 1 において、超音波と光を生体へ照射し、生体内にてパルス超音波により変調された照射光を検出することにより、粘膜表層以下 1 c m 程度の吸収の光イメージングを試みた例が報告されている。

また、特許文献 1 の特開 2 0 0 5 - 2 2 4 3 9 9 号公報においても、超音波パルスと光を生体に照射し、生体内にてパルス超音波により変調された照射光を検出することにより、粘膜表層以下の吸収光イメージングを得る装置が開示されている。

【特許文献 1】特開 2 0 0 5 - 2 2 4 3 9 9 号公報

【特許文献 2】特開 2 0 0 0 - 1 9 7 6 3 5 号公報

【特許文献 3】特開 2 0 0 0 - 8 8 7 4 3 号公報

【非特許文献 1】日坂真樹、杉浦忠男、河田聡、“パルス超音波と光の相互作用を利用した散乱体深部の光断層像観察”、光学 2 9、p p 6 3 1 - 6 3 4、2 0 0 0

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 4 】

しかし、上記特許文献 1、特許文献 3 や非特許文献 1 の先行例は、あくまで吸収の光イメージングに特化されたものであり、組織の構成や構造の変化から生じられる散乱情報を得ようとする技術ではない。

一方、生体組織における腫瘍の癌化に伴う核内クロマチンの濃縮状態や核の空間分布変化といった組織の構造的変化は、特に光散乱特性の変化を引き起こす。このため、癌組織等に関連する組織の構造変化に相関性が高い散乱情報が得られることが望まれる。

なお、組織の構造変化に相関性が高い光散乱情報は、その組織部位における複素屈折率の実部に由来し、一方複素屈折率の虚部は吸収に関連するため、複素屈折率の実部と虚部の変化を捉えることにより、散乱特性及び吸収特性に関する 2 次元、若しくは 3 次元情報が得られることになる。

10

【 0 0 0 5 】

一方、特許文献 2 の特開 2 0 0 0 - 1 9 7 6 3 5 号公報には、生体に超音波を集束するように照射し、かつレーザ等複数の光源から様々な方向から光を照射して、超音波が集束された領域で散乱された光を生体の周囲に配置された複数の検出器で検出することにより、散乱係数と吸収係数を記録する方法が拡散型の波動方程式に基づいて開示されている。

この特許文献 2 の従来例は、光源及び検出器を複数用いるようにしているので、これらを測定できる状態に設置するための作業に時間がかかる点や、検出器以後での信号処理系において検出器の配置に対応した調整が必要になることが予想される点がある等、ユーザに負担をかける欠点がある。

20

【 0 0 0 6 】

また、この従来例は、光源若しくは検査対象部位を走査してその位置を変更した場合における検出器で適切に受光するように制御する制御手段が設けていないため、画像化された情報等を取得することが簡単に行えない欠点がある。

このため、被検体としての生体内の深部側となる検査対象部位の場合にも高い空間分解能を確保して複素屈折率の実部の情報を含む被検体の特性情報を生成することができる装置及び方法が望まれる。

【 0 0 0 7 】

(発明の目的)

30

本発明は上述した点に鑑みてなされたもので、被検体における検査対象部位の光の散乱情報を含む被検体の特性情報を容易に取得するための被検体情報分析装置、内視鏡装置及び被検体情報分析方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 8 】

本発明に係る被検体情報分析装置は、所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生手段と、

前記超音波発生手段によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生手段と、

前記照明光が到達した前記検査対象部位からの周波数変調された光を受光する受光手段と、

40

前記周波数変調された光の周波数情報を光学的又は電氣的に抽出する周波数情報抽出手段と、

前記周波数情報抽出手段で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出手段と、

前記散乱情報抽出手段によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成手段と、を具備したことを特徴とする。

【 0 0 0 9 】

本発明の第 1 の内視鏡装置は、所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発

50

生可能な超音波発生部、前記超音波発生部によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生部、前記照明光が到達した検査対象部位から反射される周波数変調された光を受光可能に設けられた反射光受光部と、前記反射光受光部で受光された受光信号に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部と、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成部と、を有し、前記照明光発生部は、前記超音波発生部の周辺に配置され、前記情報抽出部は、前記反射光受光部で受光された受光信号から得られる周波数情報を抽出する周波数情報抽出部と、前記周波数情報抽出部で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部とを有し、前記被検体情報生成部は、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成することを特徴とする。

10

本発明の第2の内視鏡装置は、所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生部、前記超音波発生部によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生部、前記照明光が到達した検査対象部位から反射される周波数変調された光を受光可能に設けられた反射光受光部と、前記反射光受光部で受光された受光信号に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部と、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成部と、を有し、前記照明光発生部は、前記超音波発生部の周辺に配置され、前記情報抽出部は、前記照明光発生部によって発生される照明光と前記反射光受光部によって受光された反射光とを干渉させて周波数情報を抽出する周波数情報抽出部と、前記周波数情報抽出部で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部と、前記被検体情報生成部は、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成することを特徴とする。

20

本発明の第3の内視鏡装置は、所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生可能な超音波発生部、前記超音波発生部によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生可能な照明光発生部、前記照明光が到達した検査対象部位から反射される周波数変調された光を受光可能に設けられた反射光受光部と、前記反射光受光部で受光された受光信号に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部と、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成部と、を有し、前記照明光発生部は、前記超音波発生部の周辺に配置され、前記情報抽出部は、前記反射光受光部で受光した受光信号を周波数変換して周波数成分を抽出する周波数成分抽出部と、前記周波数成分抽出部で抽出された周波数成分に基づき前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部とを有し、前記被検体情報生成部は、前記散乱情報抽出部によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成することを特徴とする。

30

40

【0010】

本発明に係る被検体情報分析方法は、所定の超音波送信軸に沿って被検体に対して超音波を発生する超音波発生工程と、

前記超音波発生工程によって発生された前記超音波が伝達される前記被検体内における検査対象部位に到達する照明光を発生する照明光発生工程と、

前記照明光が到達した前記検査対象部位からの周波数変調された光を受光する受光工程と、

前記周波数変調された光の周波数情報を光学的又は電氣的に抽出する周波数情報抽出工

50

程と、

前記周波数情報抽出工程で抽出された周波数情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位における光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出工程と、

前記散乱情報抽出工程によって抽出された光の散乱情報に基づき、前記照明光が到達した前記検査対象部位に対応する前記被検体の特性情報を生成する被検体情報生成工程と、
を具備したことを特徴とする。

【発明の効果】

【0011】

本発明によれば、被検体における検査対象部位の光の散乱情報を含む被検体の特性情報を容易に取得可能となる。

10

【発明を実施するための最良の形態】

【0012】

以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。

【実施例1】

【0013】

図1から図4を参照して本発明の実施例1を説明する。図1は本発明の被検体情報分析装置における代表的な構成例をブロック図で示し、図2は検体情報分析装置の実施例1の光イメージング装置の全体構成を示し、図3は超音波の収束点近傍でドップラシフトする様子を示し、図4は本実施例の動作内容のフローチャートを示す。

図1に示すように本発明に係る検体情報分析装置は、所定の超音波送信軸に沿って被検体内に対して超音波を伝達させるように超音波を発生可能とする超音波発生部2と、前記超音波発生部2から発生される前記超音波が伝達される被検体内における検査対象部位に到達するような照明光を発生可能とする照明光発生部3とを有する。

20

【0014】

また、この検体情報分析装置は、照明光発生部3により発生された照明光が前記検査対象部位で反射されたドップラシフトした周波数変調光を受光可能とするように、例えば照明光発生部3（或いは超音波発生部2）側に配置された反射光受光部4と、この反射光受光部4で受光された受光信号からドップラシフト量を抽出する周波数情報抽出部5とを有する。

なお、図1においては、ドップラシフトした反射光を受光する反射光受光部4の場合でその構成を示しているが、後述する実施例3の第2変形例（図14参照）のように被検体を透過した光を受光する構成にしても良い。この場合には、図1中の反射光受光部4は、単なる受光部として機能する。

30

【0015】

また、図1の場合には受光信号から電氣的に周波数情報を抽出する構成の場合で示しているが、後述する実施例3のようにドップラシフトした光を光学的な周波数情報抽出部となる液晶チューナブルフィルタ等の分光装置で抽出しても良い。

この場合には、光学的な周波数情報抽出部は、反射光受光部4で受光される前のドップラシフトした光からその周波数情報（ドップラシフトした周波数成分）を抽出することになる。

40

また、図1においては、反射光受光部4により受光された受光信号から周波数情報抽出部5が周波数情報を抽出する例を示しているが、反射光受光部4により受光される光を分光部で分光する構成にすることもできる（後述する例えば実施例3参照）。この場合には、反射光受光部4により受光された受光信号は、既に周波数情報を含む信号となり、散乱情報抽出部6に入力される。

【0016】

また、この検体情報分析装置は、抽出された周波数情報から前記検査対象部位の複素屈折率における少なくとも実部に相当する光の散乱情報を抽出する散乱情報抽出部6と、この散乱情報から前記検査対象部位に対応する被検体の特性情報を生成する被検体情報生成部6'とを有する。なお、図1の場合、反射光受光部4は、光分離部13を介して反射光

50

を受光する構成にしている。

上記被検体情報生成部 6' は、被検体の検査対象部位を例えば 2 次元或いは 3 次元的に走査した各位置における散乱情報等を画像化して表示するための画像形成部を有する。

本被検体情報分析装置は、ドップラシフトした周波数情報を抽出することにより、検査対象部位に対する複素屈折率の実部の情報を含む被検体情報を比較的容易に得られるようにしている。

【0017】

図 2 に示す光イメージング装置 1 E は、収納容器となるユニット 1 1 内に照明光発生部 3 としての光源装置 3 b を有する。この光源装置 3 b により発生された光は、光分離部 1 3 としてのハーフミラー 1 3 a に入射され、透過する光と、反射する光に分かれる。

10

このハーフミラー 1 3 a を透過した光は、レンズ枠 3 7 に取り付けられたコリメートレンズ（若しくは集光レンズ）3 8 を経て収束されて、被検体としての生体組織 7 に照射される。

また、このコリメートレンズ 3 8 の光軸 O と例えば角度 θ (> 0) なす方向が超音波送信軸 O u となるように、ユニット 1 1 の端面等に超音波発生部 2 となる超音波トランスジューサ 2 a が取り付けられている。

なお、この超音波トランスジューサ 2 a には、超音波収束手段としての音響レンズ 1 6 が設けてある。

【0018】

そして、この図 2 に示すように収束点 F の近傍領域 R 1 付近において光軸 O 方向に散乱され、その際ドップラシフトした光（周波数変調光）となり、（この散乱後においては）収束された超音波の影響を殆ど受けることなくコリメートレンズ 3 8 側に戻る。

20

このコリメートレンズ 3 8 側に戻った光は、ハーフミラー 1 3 a で一部が反射され、反射光受光部 4 となる光検出器 4 a にて受光される。

また、上記ハーフミラー 1 3 a で反射された光は、参照光となり、この参照光路上に対向するように配置された参照ミラー 1 4 で反射されて再びハーフミラー 1 3 a に入射される。そして、入射された光の一部がハーフミラー 1 3 a を透過する。

この際、ドップラシフトした戻り光と混合（干渉）された状態で光検出器 4 a で受光されることになる。

【0019】

30

また、本実施例においては、上記のように、光軸 O と超音波送信軸 O u とが異なる方向となるように設定することにより、収束点 F の近傍領域 R 1 で散乱された散乱光を超音波による近傍領域 R 1 以外での影響を殆ど受けることなく検出できるようにしている。

このため、本実施例では例えば連続波の超音波駆動信号を発生する信号発生器 3 9 を採用している。

この信号発生器 3 9 で発生された超音波駆動信号は、パワーアンプ 2 2 により増幅された後、超音波トランスジューサ 2 a に印加される。

なお、コリメートレンズ 3 8 が取り付けられたレンズ枠 3 7 は、ユニット 1 1 側に設けた図示しない筒体と嵌合し、光軸 O 方向に移動することにより、超音波を収束する音響レンズ 1 6 による収束点 F の位置に光をフォーカスするように調整することができる。つまり、コリメートレンズ 3 8 及びレンズ枠 3 7 は、照明光が照射される照射位置調整部を形成している。

40

【0020】

また、超音波トランスジューサ 2 a は、可動枠体 4 0 に取り付けられており、この可動枠体 4 0 を超音波送信軸 O u 方向に移動することにより、超音波の収束点 F の位置を調整できるようにして超音波焦点調整部を形成している。

そして、コリメートレンズ 3 8 により光がフォーカスした位置に、超音波が焦点を結ぶように超音波の焦点調整を行うことができる。

また、ユニット 1 1 には、このユニット 1 1 を例えば 2 次元的にスキャニング（走査）する走査部としてのスキャニングユニット 1 2 が取り付けられており、このスキャニング

50

ユニット 12 は、スキャニング信号発生回路 24 からスキャニング信号で動作する。

このスキャニング信号発生回路 24 は、後述する PC6a により制御される。

【0021】

本実施例においては、光検出器 4a の出力信号は、ドップラーシフト成分を抽出する周波数情報抽出部 5 としてのスペクトルアナライザ等の信号処理回路 5c に入力される。

また、この信号処理回路 5c により抽出された周波数情報は、散乱情報抽出部 6 及び検体情報生成部 6' としての機能を持つパーソナルコンピュータ（以下、PC と略記）6a に入力される。この PC6a により、周波数情報から散乱情報として、生体組織 7 の収束点 F の近傍領域 R1 での複素屈折率における実部に相当する情報を抽出する。

また、信号発生器 39 からの信号は、信号処理回路 5c に入力され、この信号に同期して信号処理回路 5c は、抽出した周波数情報を PC6a に出力する。

図 3 は、収束点近傍領域 R1 において光が超音波によりドップラーシフトする様子の説明図を示す。

【0022】

上述したように光軸 O と超音波送信軸 Ou とは、例えば角 θ なし、光の周波数を f_s 、音波の波長を λ 、生体組織 7 内部での超音波の伝達速度を V 、生体組織 7 の屈折率 n_1 、超音波による近傍領域 R1 での屈折率変化を Δn とする。

なお、生体組織 7 は、より厳密にはその複素屈折率 $m (= m_r + i m_i)$: ここで、 m_r : 複素屈折率の実部、 m_i : 複素屈折率の虚部 が超音波の照射によって、その実部と虚部が変化するが、本実施例のように光の周波数に対して、その一次の変化分（ドップラーシフト周波数分）を検出する場合にはその実部の変化分を検出することになる。つまり、上記屈折率変化 Δn は、複素屈折率を用いて表した場合における実部 m_r の変化分 Δm_r に相当する。

【0023】

このため、ドップラーシフトに関係する本実施例等においては、屈折率としてより広く用いられている符号 n を用いた表記法を採用する。

近傍領域 R1 で散乱されて入射側に戻る光の周波数は、図 3 に示すように

$$f_s - \Delta f = f_s - 2V \cos \theta (n_1 + \Delta n) / \lambda \quad (1)$$

となる。そして、この (1) 式の第 2 項のドップラーシフト量 Δf を検出することになる。

【0024】

次に本実施例の動作を説明する。まず、光検出器 4a による信号検出の説明を行う。超音波トランスジューサ 2a から出射される超音波は、周期的に振動する粗密波として生体組織 7 の内部を伝播する。図 3 に示すように音圧が高くなる超音波収束領域では、音圧による生体構成物質（散乱体、吸収体）の空間的な密度変化により、音圧が密な部分では屈折率変化 Δn が大きく誘起されると考えられる。逆に、粗な部分では、物質の密度変化が小さい。

一方、音圧が密な部分に光が照射されると、屈折率変化部において強いフレネル反射が起こる。つまり、音圧が密な部分はミラーとしての機能を持つ。この場合、屈折率変化部は、時間と共に超音波の伝搬方向に移動するため、反射光の周波数は Δf だけ、ドップラーシフトする。

【0025】

図 2 に示したようにマイケルソン干渉計を形成した光イメージング装置 1E の場合には、光検出器 4a に入射される参照ミラー 14 側の電場 $E_r(t)$ と観測光側の電場 $E_o(t)$ は、それぞれ (2) 及び (3) 式で表される。

$$E_r(t) = E_r \exp i \{ 2\pi f_s t - k_o (D_1 + 2L_1 + D_2) \} \quad (2)$$

$$E_o(t) = E_o \exp i \{ 2\pi (f_s - \Delta f) t - k_o (D_1 + 2L_2 + 2n_o L_4 + 2n_1 z + D_2) \} \quad (3)$$

ここで、図 2 に示すように D_1 は光源装置 3b とハーフミラー 13a 間の距離、 D_2 はハーフミラー 13a と光検出器 4a 間の距離、 L_1 はハーフミラー 13a と参照ミラー 14

10

20

30

40

50

間の距離、 $L_2 + L_4$ は、ハーフミラー 13 a 光が入射される生体組織 7 の表面間の距離、 L_4 はコリメートレンズ 38 から生体組織 7 の表面間の距離を表す。また、 n_0 は水 36 の屈折率を表す。

【0026】

この場合、ドップラーシフト量 Δf は、(1) 式で表される。(1) 式によれば、ドップラーシフト量 Δf の中に、超音波により誘起される屈折率変化 Δn が含まれていることが分かる。

つまり、屈折率は、光散乱現象の主パラメータであることから（例えば Mie theory）、検出光のドップラーシフト周波数を計測することにより、局所的な散乱特性を取得できる可能性がある。

10

光検出器 4 a で検出される光強度 $I(t)$ は、以下の(4) 式となる。

【0027】

$$I(t) = |E_r + E_o|^2 \\ = |E_r|^2 + |E_o|^2 + 2|E_r||E_o|\cos\{2\pi(2V\cos\theta(n_1 + \Delta n_1)/\lambda)t + 2n_1k_0z\} \quad (4)$$

ここで、 $(L_2 + n_0 L_4) = L_1$ と仮定した。

(4) 式中の第 3 項の AC 成分をスペクトルアナライザ等により、その周波数成分を検出することにより、ドップラーシフト周波数の取得、即ち局所領域での散乱計測を行うことが可能となる。

【0028】

20

次に本実施例の光イメージング装置 1 E の動作を図 4 のフローチャートを参照して説明する。

最初のステップ S 4 1 において光源装置 3 b は光を発生する。また、ステップ S 4 2 に示すように超音波トランスジューサ 2 a も超音波を発生する。そして、ステップ S 4 3 に示すように生体組織 7 の収束点 F の近傍領域 R 1 において光源装置 3 b の光は超音波によりドップラー周波数シフトを引き起こす。つまり、上述した(1) 式のようにドップラーシフト量 Δf を伴った光は、ハーフミラー 13 a において、参照光と干渉して、干渉光となり、ステップ S 4 4 に示すように光検出器 4 a にて検出される。

【0029】

この干渉信号は、ステップ S 4 5 に示すようにスペクトルアナライザ等の信号処理回路 5 c により、ドップラーシフト量 Δf が検出される。

30

ステップ S 4 6 に示すように信号処理回路 5 c の出力信号は、PC 6 a に入力され、デジタル信号に変換され、PC 6 a 内のメモリ等に Δf 又は $V(n_1 + \Delta n)$ 等が光散乱情報として、スキヤニング位置の情報と関連付けてストックされる。なお、超音波の伝達速度 V 、波長 λ 、角 θ 等は既知となる。

そして、次のステップ S 4 7 において PC 6 a は、スキヤニングが終端かを判定し、これに該当しない場合にはステップ S 4 8 に示すように超音波の収束点 F を移動させるようにスキヤニングを行い、ステップ S 4 2 又は S 4 3 に戻る。

【0030】

このようにして、スキヤニングを 2 次元或いは 3 次元的に行い、スキヤニングの終端になると、ステップ S 4 7 からステップ S 4 9 に進み、画像生成が完了する。そして、画像表示が行われる。

40

ステップ S 5 0 に示すように術者は、表示される画像を観察して、癌等の病変部のスクリーニング等に有効利用できる。

また、上述の説明ではステップ S 4 5 においてドップラーシフト量 Δf の検出をスペクトルアナライザを用いた場合で説明した。この他にフーリエ変換でドップラーシフト量 Δf を検出することもできる。以下、フーリエ変換を用いた場合を説明する。

【0031】

上述したように光検出器 4 a は、(4) 式の光強度 $I(t)$ を検出する。この(4) 式は、第 1 及び第 2 項を I_{dc} と、第 3 項を振幅 I_{ac} 及び ϕ を用いて以下の(5) 式のよ

50

うに表わすことができる。

$$\begin{aligned} I(t) &= I_{dc} + I_{ac} \cos(2\pi \Delta f t + \varphi) \\ &= I_{dc} + I_{ac} \cos(\Delta \omega t + \varphi) \end{aligned} \quad (5)$$

ここで、 $\varphi = 2n_1 k_0 z$ である。

【0032】

(5) 式は信号処理回路 5c においてフーリエ変換され、(6) 式のようにになる。

【0033】

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \int \{ I_{dc} + I_{ac} \cos(\Delta \omega t + \varphi) \} e^{-j\omega t} dt \\ &= \int \{ I_{dc} + I_{ac} \cos(\Delta \omega t + \varphi) \} e^{-j\omega t} dt \quad (-T \quad t \quad T) \\ &= 2I_{dc} \sin \omega T / \omega + I_{ac} \{ e^{j\varphi} \sin(\Delta \omega - \omega) T / (\Delta \omega - \omega) + e^{-j\varphi} \sin(\Delta \omega + \omega) T / (\Delta \omega + \omega) \} \\ &= 2I_{dc} \sin \omega T / \omega + I_{ac} \cos \varphi \{ \sin(\Delta \omega - \omega) T / (\Delta \omega - \omega) + \sin(\Delta \omega + \omega) T / (\Delta \omega + \omega) \} + j I_{ac} \sin \varphi \{ \sin(\Delta \omega - \omega) T / (\Delta \omega - \omega) + \sin(\Delta \omega + \omega) T / (\Delta \omega + \omega) \} \end{aligned} \quad (6)$$

ここで、(6) 式の一番上の右辺の積分範囲は $-\infty$ から $+\infty$ であり、二番目の右辺の積分範囲はその右側に記載されているように有限の時間 $-T$ から $+T$ で近似できる。

【0034】

(6) 式に示したフーリエ変換された信号の実数成分は、図 5 に示すようになる。そして、この図 5 に示すように大きなピークとなるドップラーシフト角周波数 $\Delta \omega$ を検出する。

本実施例によれば、ドップラーシフト量 Δf を抽出することにより、生体組織 7 の散乱情報、つまり、生体組織 7 の細胞や細胞構成物の形態学的な情報を観測可能とする分析装置を実現できる。また、この場合ドップラーシフト量 Δf を抽出することにより、従来例に比較して容易に複素屈折率の実部の情報を抽出できる。従って、被検体の形態学的特性情報を容易に得られることになる。

なお、上述のようにフーリエ変換を用いて周波数成分の抽出(算出)を行う代わりに、ウェーブレット変換を用いて周波数成分の抽出を行うようにしても良い。

【0035】

図 6 は、第 1 変形例の光イメージング装置における照明光軸保持部としてのレンズ保持部 26 と、超音波送信軸保持部としてのトランスジューサ保持部 27 周辺部を示す。

レンズ保持部 26 は、コリメートレンズ 38 が取り付けられたレンズ枠 37 が嵌合する透孔により摺動可能に保持する可動保持体 26a と、この可動保持体 26a の一方の端部側を嵌合して回転的にスライド移動可能に保持する固定側保持体 26b とを有する。

また、可動保持体 26a の他方の端部側には、ラック部 26c が設けてあり、このラック部 26c は摘み 26e の端部に設けたギヤ 26d が噛合する。そして、ユーザは、この摘み 26e を回動する操作を行うことにより、図 6 中の符号 C で示すように可動保持体 26a を移動することができる。そして、コリメートレンズ 38 の光軸 O を移動してその光軸 O を調整することができる。

【0036】

また、同様にトランスジューサ保持部 27 は、超音波トランスジューサ 2a が取り付けられた可動枠 40 が嵌合する透孔により摺動可能に保持する可動保持体 27a と、この可動保持体 27a の一方の端部側を嵌合して回転的なスライド移動可能に保持する固定側保持体 27b とからなる。

また、可動保持体 27a の他方の端部側には、ラック部 27c が設けてあり、このラック部 27c は摘み 27e の端部に設けたギヤ 27d が噛合する。

そして、ユーザは、この摘み 27e を回動する操作を行うことにより、図 6 中の符号 D で示すように可動保持体 27a を移動することができる。そして、超音波トランスジューサ 2a の超音波送信軸 Ou を移動してその超音波送信軸 Ou の方向を調整することができる。

【 0 0 3 7 】

また、図 6 において、レンズ枠 3 7 を光軸 O の方向に調整することにより、光の焦点位置 F o を調整できる。同様に可動枠体 4 0 を調整することにより超音波の収束点 F を調整することができる。

そして、例えば収束点 F に焦点位置 F o が一致するように調整することができる照明光調整部が設けてある。また、焦点位置 F o に収束点 F が一致するように調整することができる超音波の焦点調整部も設けてある。

本変形例では、固定側保持体 2 6 b、2 7 b により可動保持体 2 6 a と可動保持体 2 7 a とを共通の平面（光軸 O と超音波送信軸 O u を含め面）内で回動的に移動自在に保持し、光と超音波の送信軸の方向が異なる場合にも、検査対象とする部位に光及び超音波をフ

10

【 0 0 3 8 】

なお、図 6 においては、光軸 O と超音波送信軸 O u とが異なる方向に設定した場合におけるフォーカス調整及び方向調整機構を示しているが、光軸 O と超音波送信軸 O u とを一致させる場合には、レンズ保持部 2 6 とトランスジューサ保持部 2 7 とを同軸的に或いは積層的に配置することにより実現できる。この構成に関しては、後述する（図 9 参照）。

図 7 は第 2 変形例における超音波の収束点 F の近傍領域を示す。図 2 或いは図 3 においては、超音波トランスジューサ 2 a は、光軸 O と角 θ を成す 1 つの方向にのみ配置された構成であったが、図 7 に示すように光軸 O に関して θ を成す 2 つの方向に配置された構成

20

にしても良い。このようにすると、後方散乱光の強度をより大きくすることができ、S / N を向上することができる。なお、光軸 O の回りに回転対称的に 2 つ以上の超音波トランスジューサ 2 a を配置するようにしても良い。

【 実施例 2 】

【 0 0 3 9 】

図 8 は本発明の実施例 2 の光イメージング装置 1 F の構成を示す。実施例 1 では光軸 O と超音波送信軸 O u とが異なる方向に設定されていたが、本実施例は、光軸 O と超音波送信軸 O u とを一致させる構成にしたものである。これにより、生体組織 7 側に光及び超音波を照射する部分をコンパクトにできる。

30

本実施例においては、超音波の収束点 F の近傍領域 R 1 でのドップラーシフト量 Δf のみを有効に検出するため、パルス状の超音波を照射する。このため、図 2 の信号発生器 3 9 の代わりにパルス発生器 2 1 が採用される。

また信号処理回路 5 c にはディレイ回路 2 3 で遅延されたパルスが入力され、信号処理回路 5 c は、この遅延された短い期間にドップラーシフト量 Δf の周波数検出或いは周波数抽出を行う。

【 0 0 4 0 】

その他、図 2 で示したものと同一構成要素には同じ符号を付け、その説明を省略する。なお、図 8 においては、超音波を収束させ、光は収束させない構成例で示しているが、光も収束させる構成にしても良い。この場合には、検出される信号の S / N を向上できる。

40

本実施例においては、光軸 O と超音波送信軸 O u との成す角 θ が 0 ($\cos \theta = 1$) となるため、周波数シフトが最大となる状態でドップラーシフト量 Δf を検出することができるメリットがある。

また、上述したように生体組織に光と超音波を照射する部分をよりコンパクトにできる効果がある。

【 0 0 4 1 】

なお、パルス発生器 2 1 からパルス形状の電気信号でなく、連続形状の電気信号をパワーアンプ 2 2 へ与えることで、超音波トランスジューサ 2 a より連続超音波を生体組織 7 へ照射しても良い。またこの際、パルス発生器 2 1 より超音波の波長に相当する時間間隔

50

でパルス状のリファレンス信号を信号処理回路 5 c へ入力して、同期検波をすることでパルス状の超音波を照射した場合と同様の効果を得ることも可能である。

【 0 0 4 2 】

図 9 は、図 8 の構成に適用された第 1 変形例におけるレンズ保持部 2 6 ' とトランスジューサ保持部 2 7 ' 周辺部を示す。光源装置 3 b からハーフミラー 1 3 a と透過した光は、光軸 O 上に設けたレンズ保持部 2 6 ' のコリメートレンズ 3 8 を通り、この光軸 O と略一致するように隣接して設けられたトランスジューサ保持部 2 7 ' における開口 1 5 を通って生体組織 7 側に集光されて照射される。

レンズ保持部 2 6 ' とトランスジューサ保持部 2 7 ' は、図 6 におけるレンズ保持部 2 6 とトランスジューサ保持部 2 7 における回動的な移動の代わりに光軸 O 及び超音波送信軸 O u に直交する方向にそれぞれ移動可能とした違いがあるのみである。

【 0 0 4 3 】

そして、例えばレンズ保持部 2 6 ' 側を調整することにより、矢印 C で示す方向に移動して光軸 O が超音波送信軸 O u に一致するように調整することを可能とする照明光軸調整部を形成している。

また、トランスジューサ保持部 2 7 ' 側を調整することにより、超音波送信軸 O u が矢印 D で示すように移動でき、光軸 O に一致するように調整することを可能とする送信軸調整部を形成している。なお、例えばレンズ枠 3 7 を光軸 O 方向に移動可能として、収束点 F と焦点位置 F o とが一致するように調整することができる構成にしても良い。

本変形例によれば、レンズ保持部 2 6 ' やトランスジューサ保持部 2 7 ' がバラツキがある場合においても、調整することにより収束点 F と焦点位置 F o とが一致するように調整することができる。そして S / N や分解能が高い状態で光イメージング情報を得ることができる。

また、照明光を集光しているので、S / N や分解能が高い状態で周波数情報を抽出できる。

【 0 0 4 4 】

なお、上記の各実施例において、超音波としてパルス波と連続波のいずれを用いても良く、更に上述の各実施例においては光検出器 4 a として CCD 等の 2 次元検出器や、1 次元ラインセンサ、更に Photodetector、光電子倍增管等の点検出器を使用しても良い。更に上記の実施例 1, 2 においては、フーリエ変換によりドップラーシフト量を検出しても良い。

【 実施例 3 】

【 0 0 4 5 】

次に図 1 0 及び図 1 1 を参照して本発明の実施例 3 を説明する。実施例 1 及び実施例 2 においてはマイケルソン型干渉計を備えた構成の場合で説明したのに対して、本実施例は干渉計を設けないで、例えば液晶チューナブルフィルタのような分光手段を設けた構成にしたものである。

図 1 0 は実施例 3 の光イメージング装置 1 G を示す。ユニット 1 1 内に設けられた光源装置 3 b の光は、ハーフミラー 1 3 a に入射され、このハーフミラー 1 3 a で反射された光は、水 3 6 に浸された生体組織 7 に照射される。ユニット 1 1 はスキャニングユニット 1 2 により、2 次元若しくは 3 次元的に移動される。なお、ここでは水 3 6 に浸された生体組織 7 に対して適用する例で示しているが、水を入れたバルーンを採用することもできるし、音響レンズ 1 6 を直接接触させても良い。

【 0 0 4 6 】

また、ユニット 1 1 の端面に取り付けられた超音波トランスジューサ 2 a から出射される超音波は、音響レンズ 1 6 により収束され、光軸 O と角 θ なす超音波送信軸 O u に沿って、超音波を伝達する水 3 6 を経て生体組織 7 内部に照射される。

超音波の収束点 F の近傍領域 R 1 でドップラーシフトし、後方側に散乱された光は、ハーフミラー 1 3 a に入射し、その一部が透過する。このハーフミラー 1 3 a を透過した光は、さらにミラー 4 1 で反射された後、分光手段としての液晶チューナブルフィルタ 4 2

10

20

30

40

50

に入射される。

この液晶チューナブルフィルタ 4 2 は、ドライバ 4 3 から印加される駆動信号に応じて、この液晶チューナブルフィルタ 4 2 の透過波長の帯域が変化する。なお、ドライバ 4 3 は、例えばスキャニング信号発生回路 2 4 からスキャニング信号に同期して液晶チューナブルフィルタ 4 2 を駆動する。

この液晶チューナブルフィルタ 4 2 を透過した光は、光検出器 4 a により受光される。この光検出器 4 a の出力信号は、信号処理回路 5 d を経て P C 6 a に入力される。

【 0 0 4 7 】

信号処理回路 5 d 及び P C 6 a は、光検出器 4 a の出力信号から散乱情報抽出と、被検体情報生成、より具体的には画像形成処理を行う。この場合、信号処理回路 5 d で散乱情報抽出、P C 6 a で画像形成処理を行うようにしても良い。

10

そして、光検出器 4 a により光電変換された信号は、透過波長をスweepさせる駆動信号と共に、P C 6 a 内のメモリ等に一時格納される。そして、例えば以下のようにして、ドップラシフトした信号検出時の透過波長（或いはドップラシフト量 Δf ）を算出する。

光検出器 4 a の出力信号からドップラシフトした信号を検出する場合、例えば P C 6 a（内の C P U）は、図示しない比較等により、閾値以上で検出され、ピークとなる信号をドップラシフトした信号として抽出する。

【 0 0 4 8 】

また、そのピークとなる信号検出時における駆動信号の情報から、透過波長を算出して、その算出した透過波長の情報と共に、メモリにストックする。なお、駆動信号を周期的に変化させることにより、そのタイミングから透過波長の値が算出できるようにしても良い。

20

なお、後述するように例えば P C 6 a 内においてフーリエ変換することにより、光検出器 4 a の出力信号からドップラシフトした信号を検出するようにしても良い。

また、超音波トランスジューサ 2 a にはパルス発生器 2 1 で発生したパルスがパワーアンプ 2 2 で増幅されたパルス状超音波駆動信号が印加される。また、パルス発生器 2 1 のパルスは、ディレイ回路若しくはトリガ回路 4 4 を介して例えば信号処理回路 5 d に入力され、信号処理回路 5 d は、パルスに応じて抽出した散乱情報を P C 6 a に出力する。

なお、本実施例においては、超音波トランスジューサ 2 a をパルスの（間欠的）に駆動する構成で示しているが、連続波で駆動する構成にしても良い。

30

【 0 0 4 9 】

本実施例の動作を図 1 1 のフローチャートを参照して説明する。なお、前述した実施例 1 における図 4 の場合のフローチャートを参照しその説明を簡略化する。

図 4 の場合と同様に最初にステップ S 4 1 及び S 4 2 において光と超音波を発生する。上述のように超音波はパルスの場合に限らず連続波でも良い。

そして、ステップ S 4 3 に示すように収束点 F の近傍領域 R 1 においてドップラシフト現象が発生する。この場合には、その光強度 $I(t)$ は（ 2 ）及び（ 3 ）式を 2 乗したものとなり、以下の（ 7 ）式のように表される。

$$\begin{aligned} I(t) &= I_{dc} + I_{ac} \cos \{ 2\pi (f_s + \Delta f) t + \varphi \} \\ &= I_{dc} + I_{ac} \cos \{ (\omega_s + \Delta \omega) t + \varphi \} \end{aligned} \quad (7)$$

40

そして、ステップ S 4 4 ' に示すように液晶チューナブルフィルタ 4 2 により透過波長を変化して、ステップ S 4 5 ' に示すようにこの液晶チューナブルフィルタ 4 2 を透過した光を光検出器 4 a で検出する。

【 0 0 5 0 】

この光検出器 4 a の出力信号は、信号処理回路 5 d を経て P C 6 a に入力される。信号処理回路 5 d 或いは P C 6 a は、入力された信号から、実際にドップラシフトした信号の抽出を行う。そして、P C 6 a は、ステップ S 4 6 に示すように Δf 等の情報を光イメージング情報としてメモリにストックする。

その後のステップ S 4 7 から S 5 0 の処理は図 4 にて説明したものと同様であるので、

50

その説明を省略する。

本実施例は、干渉計を必要としないので、装置構成を簡便にできるメリットがある。また、装置を小規模で実現できるメリットがある。

上述の説明では、比較器等を用いて光検出器 4 a の出力信号からドップラーシフトした信号を検出する場合で説明したが、以下のようにフーリエ変換を用いて、ドップラーシフトした信号を検出するようにしても良い。

【 0 0 5 1 】

(7) 式は P C 6 a (或いは信号処理回路 5 d でも良い) においてフーリエ変換され、(8) 式のようになる。

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \int \{ I_{dc} + I_{ac} \cos(\Delta\omega t + \phi) \} e^{-j\omega t} dt \\
 &= \int \{ I_{dc} + I_{ac} \cos(\omega_s t + \Delta\omega t + \phi) \} e^{-j\omega t} dt \quad (-T \text{ to } T) \\
 &= 2I_{dc} \sin\omega T / \omega + I_{ac} \cos\phi \{ \sin(\Delta\omega + \omega_s - \omega) T / (\Delta\omega + \omega_s - \omega) + \sin(\Delta\omega + \omega_s + \omega) T / (\Delta\omega + \omega_s + \omega) \} + j I_{ac} \sin\phi \{ \sin(\Delta\omega + \omega_s - \omega) T / (\Delta\omega + \omega_s - \omega) + \sin(\Delta\omega + \omega_s + \omega) T / (\Delta\omega + \omega_s + \omega) \} \quad (8)
 \end{aligned}$$

ここで、(8) 式の一番上の右辺の積分範囲は $-\infty$ から $+\infty$ であり、二番目の右辺の積分範囲はその右側に記載されているように表される。

【 0 0 5 2 】

(8) 式に示したフーリエ変換された信号の実数成分は、図 1 2 に示すようになる。そして、この図 1 2 に示すように大きなピークとなる角周波数 $\omega_s + \Delta\omega$ を検出し、既知の角周波数 ω_s を減算してドップラーシフトの角周波数 $\Delta\omega$ を検出する。

図 1 3 は第 1 変形例の光イメージング装置 1 H を示す。この光イメージング装置 1 H は、図 1 0 の構成において、液晶チューナブルフィルタ 4 2 の代わりに音響光学回折格子 4 5 a 及び圧電素子 4 5 b が採用されている。

この音響光学回折格子 4 5 a 及び圧電素子 4 5 b は、ドライバ 4 3 からの駆動信号が圧電素子 4 5 b に印加されることにより、回折格子の格子間隔が変化して、入射された光の波長に対する 1 次の回折角が変化する。つまり、この音響光学回折格子 4 5 a は、分光器のように分光 (波長分解) した光を (異なる方向に) 出す。

【 0 0 5 3 】

この音響光学回折格子 4 5 a により波長分解された光は光検出器 4 a にて検出される。

その他は、図 1 0 と同様の構成である。本変形例の作用効果は、図 1 0 の装置の場合と同様である。

図 1 4 は第 2 変形例の光イメージング装置 1 I を示す。この光イメージング装置 1 I は、図 1 0 の装置を透過型に適用したものである。

ユニット 1 1 a 側の光源装置 3 b からの光は、光軸 O に沿って進行し、水 3 6 を透過して生体組織 7 内部に照射される。

この光は、超音波収束領域においてドップラーシフトし、その一部は光軸 O 上をさらに進行し、生体組織 7 を透過する。そして、ユニット 1 1 b における光軸 O 上に配置された遮光板 1 9 の開口 1 9 a を経てミラー 4 1 に入射され、このミラー 4 1 で反射されて液晶チューナブルフィルタ 4 2 に入射される。

【 0 0 5 4 】

この液晶チューナブルフィルタ 4 2 を透過した光は光検出器 4 a で検出される。なお、ユニット 1 1 a、1 1 b は、それぞれスキャニングユニット 1 2 a、1 2 b で 2 次元或いは 3 次元的に移動される。その他、図 1 0 等で説明した構成要素と同じものには同じ符号を付け、その説明を省略する。

本変形例は、図 1 0 の装置における反射光 (戻り光) を検出する代わりに透過光を検出する相違があるが、これを除けば図 1 0 の装置の場合と同様の作用効果を有する。なお、液晶チューナブルフィルタ 4 2 の代わりに、分光器や音響光学素子といった分光デバイス

にしても良い。

なお、図示しないが、図 1 3 に示した装置も透過光の検出タイプの構成にすることもできる。

【 0 0 5 5 】

上記の各実施例における光検出器 4 a は、Photodiodeや光電子倍增管といった点検出器でも良いし、1次元ラインセンサやCCD等の2次元検出器を用いても良い。

【 0 0 5 6 】

更に、図 1 3、図 1 4 の実施例に関しては、パルス発生器 2 1 の駆動波形を調整することにより、連続超音波やパルス超音波のいずれを用いても良い。更に上記各実施例は分光的手段を用いずにフーリエ変換によりドップラーシフト量を検出しても良い。

10

【実施例 4】

【 0 0 5 7 】

次に図 1 5 及び図 1 6 を参照して本発明の実施例 4 を説明する。本実施例は、例えば図 8 の実施例 2 の場合と同様に超音波送信軸 O u と光軸 O とを略同軸となるように配置してコンパクトな構成を実現にしている。但し、本実施例は、参照光と干渉させることなくドップラーシフト量を検出する点が実施例 2 とは異なる。

図 1 5 に示す光イメージング装置 1 J は、例えば図 8 に示した光イメージング装置 1 F に類似した構成である。

図 8 の場合においては、参照光と干渉させる構成であったが、本実施例は、参照光と干渉させないで、例えば実施例 3 の場合のように光学的に分光してドップラーシフト量を検出する構成にしている。

20

連続光を発生する光源装置 3 b からの光は、ハーフミラー 1 3 a で一部が反射されてコリメートレンズ 3 8 により集光されて生体組織 7 側に照射される。また、生体組織 7 の超音波収束領域 R 1 で反射されたドップラーシフトした光は、ハーフミラー 1 3 a に入射し、一部が透過し、光学的な分光手段としての例えば液晶チューナブルフィルタ 4 2 に入射される。

【 0 0 5 8 】

この液晶チューナブルフィルタ 4 2 は、ドライバ 4 3 からの駆動信号の印加により、透過波長が変化する。そして、この液晶チューナブルフィルタ 4 2 を透過した光は、光検出器 4 a にて受光され、光電変換される。

30

この光検出器 4 a の出力信号は、メモリ装置 5 8 に入力され、メモリ装置 5 8 内の A / D 変換器によりデジタル信号に変換された後、メモリにスキャン情報と共に、ストックされる。このメモリ装置 5 8 にストックされた情報は、例えば 1 フレーム分の情報が生成されると、出力装置表示装置 1 0 に出力され、被検体の特性情報が画像として表示される。

【 0 0 5 9 】

また、パルス発生器 2 1 で発生されるパルスは、パワーアンプ 2 2 を介してパルス状超音波駆動信号となり、超音波トランスジューサ 2 a に印加され、超音波トランスジューサ 2 a はパルス超音波を発生する。

このパルス発生器 2 1 によるパルスは制御装置 4 6 に入力され、制御装置 4 6 はパルス超音波に同期してスキャン装置 4 9 のスキャンの動作を制御する。また、この制御装置 4 6 は、パルス超音波に同期して、ドライバ 4 3 の駆動信号の発生を制御する。また、メモリ装置 4 8 もパルス超音波に同期して、光検出器 4 a からの出力信号のストックを行う。

40

なお、本実施例においては、例えば図 9 で説明したレンズ保持部 2 6 ' とトランスジューサ保持部 2 7 ' とを備えた構成にしている。

【 0 0 6 0 】

そして、光源装置 3 b の光はコリメートレンズ 3 8 により集光され、その光軸 O 上を進行し、超音波トランスジューサ 2 a の開口 1 5 を通り、さらに、水 3 6 を経て生体組織 7 内部に照射される。

50

収束点近傍領域 R 1 で、その周波数がドップラーシフトした反射光の一部は、コリメートレンズ 3 8、ハーフミラー 1 3 a を経て液晶チューナブルフィルタ 4 2 に入射される。そして、この液晶チューナブルフィルタ 4 2 によりドップラーシフトした光を信号光として抽出できるようにしている。

また、超音波トランスジューサ 2 a から出射されるパルス超音波は音響レンズ 1 6 により収束されて生体組織 7 側に照射される。また、コリメートレンズ 3 8 の光軸 O と超音波送信軸 O u とが一致するように調整できるようにしている。

【 0 0 6 1 】

そして、例えばレンズ保持部 2 6 ' 側を調整することにより、光軸 O が超音波送信軸 O u に一致するように調整することを可能とする照明光軸調整部を形成している。

10

また、トランスジューサ保持部 2 7 ' 側を調整することにより、超音波送信軸 O u が光軸 O に一致するように調整することを可能とする送信軸調整部を形成している。

なお、ユニット 1 1 は、制御装置 4 6 の制御下でスキャニング装置 4 9 により 2 次元或いは 3 次元的に駆動される。このスキャニング装置 4 9 は、図 8 におけるスキャニング信号発生回路 2 4 とスキャニングユニット 1 2 の両機能を兼ねる。

【 0 0 6 2 】

本実施例の動作を図 1 6 を参照して説明する。

最初のステップ S 5 1 において、光源装置 3 b は連続の光を発生する。そして、この光は、生体組織 7 側に照射される。次のステップ S 5 2 に示すようにパルス発生器 2 1 は、パルスを発生し、パワーアンプ 2 2 を経て生成されたパルス状超音波駆動信号が超音波トランスジューサ 2 a に印加され、超音波トランスジューサ 2 a はパルス超音波を発生する。このパルス超音波は、音響レンズ 1 6 で収束されながら生体組織 7 に照射される。

20

ステップ S 5 3 に示すようにパルス超音波が超音波収束点近傍領域に達した場合の屈折率変化に伴い、この領域に達した光は、最もドップラーシフトし、その反射光は、液晶チューナブルフィルタ 4 2 に入射される。

【 0 0 6 3 】

ステップ S 5 4 に示すようにドップラーシフトした反射光が液晶チューナブルフィルタ 4 2 に入射されるタイミングでドライバ 4 3 は、液晶チューナブルフィルタ 4 2 の透過波長を変化させる。このようにドライバ 4 3 は、パルス超音波が収束点 F に達する時間内において液晶チューナブルフィルタ 4 2 の透過波長を変化させるように制御装置 4 6 により制御される。

30

そして、ステップ S 5 5 に示すように液晶チューナブルフィルタ 4 2 を透過した光は、光検出器 4 a により受光される。

次のステップ S 5 6 に示すように、光検出器 4 a により受光され、ドップラーシフトした電気信号はメモリ装置 4 8 内のメモリに光イメージング情報として、スキャニング位置情報と共にストックされる。この場合、液晶チューナブルフィルタ 4 2 の透過波長の情報もメモリ装置 5 8 のメモリにストックされる。これにより、ドップラーシフト量 Δf や屈折率変化を反映した物理量の算出が可能になる。

【 0 0 6 4 】

次のステップ S 5 7 において制御装置 4 6 は、スキャニングが終端かの判定を行う。そして、終端に該当しない場合には、制御装置 4 6 は、ステップ S 5 8 に示すように超音波の収束点を移動する制御を行う。

40

つまり、制御装置 4 6 は、スキャニング装置 4 9 の動作を制御し、ユニット 1 1 を移動させる。そして、ステップ S 5 2 に戻り、上述した処理を繰り返す。

このようにして、スキャニングがスキャニング範囲の終端まで行われると、ステップ S 5 7 からステップ S 5 9 に移る。このステップ S 5 9 において、1 フレーム分の画像生成が完了する。そして、この 1 フレーム分の画像は、出力信号表示装置 1 0 に送られ、この出力信号表示装置 1 0 において、例えば屈折率変化 Δn を反映した画像が表示される。

【 0 0 6 5 】

本実施例によれば、超音波と光を同軸状に照射すると共に、ドップラーシフト光を照射

50

光と同じ光路を経て受光するようにしているので、コンパクトな装置で実現できる。

なお、本実施例は、光学的な分光手段を採用しているが、参照光と干渉させ、光検出器 4 a の干渉信号からスペクトルアナライザ等を用いてドップラーシフト量 Δf や屈折率変化（屈折率の実部の変化量）を反映した物理量を算出することもできる。

図 17 は実施例 4 の変形例の光イメージング装置 1 K を示す。本変形例は、図 15 において液晶チューナブルフィルタ 42 の代わりに分光装置 50' を採用している。

【0066】

この分光装置 50' により波長分離された光は、光検出器 4 a に入力され、電気信号に変換される。

そして、光検出器 4 a の出力信号は、分光装置 50' による波長分離に用いた情報及びスキャニング位置の情報と共に、メモリ装置 58 内のメモリに格納される。その他は、図 15 と同様の構成である。

本変形例は、実施例 4 の場合と同様に装置をコンパクトにできる等のメリットがある。

【実施例 5】

【0067】

図 18 は実施例 5 の光イメージング装置 1 L を示す。

この光イメージング装置 1 L は、図 15 の光イメージング装置 1 J において、超音波トランスジューサ 2 a の超音波送信軸 O u を光軸 O の方向と異なる方向（例えば超音波送信軸 O u を光軸 O とが角 θ なす方向）に設定したものである。また、この実施例は、光源装置 3 b の光をハーフミラー 13 a にて参照ミラー 14 側への参照光と生体組織 7 側への観測光とに分岐させ、生体組織 7 側から戻るドップラーシフトした光を参照光と干渉させる構成にしている。本変形例においても、連続波の光を採用している。

なお、本実施例においては、制御装置 46 は、ディレイ回路 47 を介して信号処理装置 48 における検出のタイミングを制御している。この信号処理装置 48 は、光検出器 4 a からの出力信号が入力されるスペクトルアナライザ 48 a と、例えば PC の一部、例えば A/D 変換器、CPU、メモリからなる A/D 変換器・CPU・メモリ 48 b とからなる。そして、この A/D 変換器・CPU・メモリ 48 b にストックされた情報は、出力信号表示装置 10 に出力される。

【0068】

また、本実施例では、例えばレンズ保持部 26' のみ設けた構成にしている。

本実施例のタイミングチャートは、図 19 に示すようになる。光源装置 3 b は図 19 (A) に示すように連続光を発生する。

超音波トランスジューサ 2 a は図 19 (B) に示すように例えば一定間隔のパルス超音波を発生する。このパルス超音波は、例えば図 19 (C) に示すように超音波トランスジューサ 2 a によるパルス超音波の発生から例えば時間 T_f の後、収束点 F に到達する。

制御装置 46 は、パルス超音波の発生からこの時間 T_f 遅れたタイミングで、光検出器 4 a がドップラーシフトした光を検出させるように例えばゲートパルスを印加して制御する。この動作を図 19 (D) においては、ドップラーシフトした光の検出で示している。

【0069】

光検出器 4 a は、光検出した信号を常時出力している場合には、A/D 変換器・CPU・メモリ 48 b 側を制御して、上記のタイミングにおいて光検出器 4 a の出力信号を取り込むように制御する。

また、このドップラーシフトした光の検出の後、スキャニング信号により、収束点 F を移動する。このようにして、検査対象領域に対するドップラーシフト量 Δf の検出、そして屈折率変化 Δn を反映した画像を得ることができる。

図 20 は実施例 5 の第 1 変形例の光イメージング装置 1 M を示す。

この光イメージング装置 1 M は、図 18 の光イメージング装置 1 L において超音波を収束させない構成にしたものである。つまり、この光イメージング装置 1 M は、図 18 の光イメージング装置 1 L において超音波を収束する音響レンズ 16 を設けない構成にしてい

10

20

30

40

50

る。また、レンズ保持部 2 6 ' を設けない構成にしている。

【 0 0 7 0 】

本変形例は超音波を収束させないため、簡便な構成で実現できる。なお、このように超音波を収束させない場合には、超音波トランスジューサ 2 a 側を固定する構成にしても良い。つまり、超音波が広がって照射されるため、コリメートレンズ 3 8 によりフォーカスする光側をスキャンする構成にすることもできる。

また、図 2 1 は、実施例 5 の第 2 変形例の光イメージング装置 I N を示す。この光イメージング装置 I N は、図 2 0 の光イメージング装置 I M において、光源装置 3 b とハーフミラー 1 3 a との間にビームイクスパンダ 5 0 を設けたものである。このようにすることにより、ビーム径を増大でき、変調光検出強度を増幅させることが可能である。

10

図 2 2 は、実施例 5 の第 3 変形例の光イメージング装置 I P を示す。この光イメージング装置 I P は、図 2 0 の光イメージング装置 I M において干渉計を形成しない構成にしたものである。

【 0 0 7 1 】

本変形例の装置の構成としては例えば図 1 0 に類似した構成を採用している。この光イメージング装置 I P は、図 1 0 の装置においてハーフミラー 1 3 a で反射された光をコリメートレンズ 3 8 で集光して生体組織 7 に照射する。

また、生体組織 7 側で反射され、ハーフミラー 1 3 a を透過した光は、ミラー 4 1 で反射されて分光装置 5 0 ' に入射され、分光された光を光検出器 4 a で検出する。

また、超音波トランスジューサ 2 a にはパルス状超音波駆動信号を印加する構成にしている。この場合、音響レンズ 1 6 は設けてなく、超音波トランスジューサ 2 a は収束されないパルス超音波を生体組織 7 に照射することになる。

20

なお、本変形例は、光源装置 3 b の光をビームイクスパンダ 5 0 によりビーム径を増大して、ハーフミラー 1 3 a に出射する構成にしている。このビームイクスパンダ 5 0 を用いない構成にしても良い。

本変形例も簡便な構成で実現できる効果がある。また、さらに簡略化するため、図 2 2 におけるコリメートレンズ 3 8 を採用しない構成にしても良い。図 2 3 はコリメートレンズ 3 8 を採用しないで、集光されない光を生体組織 7 側に照射する光イメージング装置 I Q の一部を示している。

【 0 0 7 2 】

30

なお、上記の各実施例においても、超音波はパルスでも良いし、連続波でも良い。また、上記の各実施例の構成中の光検出器 4 a は、点検出器でも、1次元のライン状検出器でも、CCD等の2次元検出器でも良い。更に、フーリエ変換によりドップラーシフト量を検出しても良い。

【実施例 6】

【 0 0 7 3 】

次に図 2 4 から図 2 6 を参照して本発明の実施例 6 を説明する。図 2 4 に示す実施例 6 の光イメージング装置 1 U は、ドップラーシフト量を検出するタイプである。

この光イメージング装置 1 U は、生体組織 7 に照射するレーザ光等の光を発生する光源装置 3 b を有する。

40

この光源装置 3 b の光は、この光を導光する光ファイバ 5 2 a の端面に入射され、この光ファイバ 5 2 a を介してその途中に設けられた光カプラ 5 3 において、2つの光に分岐される。そして、一方は光ファイバ 5 2 b を介して光照射と受光を行う光照射・受光部 5 4 b 側に導光され、他方は光ファイバ 5 2 c を介して参照光生成部 5 5 側に導光される。

【 0 0 7 4 】

また、光ファイバ 5 2 b により、超音波を伝達する水 3 6 を介して生体組織 7 側に照射され、生体組織 7 側からドップラーシフトして戻る光は、観測光としてこの光ファイバ 5 2 b に入射され、光カプラ 5 3 において参照光側の光と干渉した干渉光となる。

そして、この干渉光は、光ファイバ 5 2 d を経てその端面に配置された光検出器 4 a により受光され、光電変換される。

50

上記参照光生成部は、光ファイバ 5 2 c の端面から出射される光をコリメートレンズ 5 6 により平行な光束の光にして、固定された参照ミラー 1 4 に入射させ、この参照ミラー 1 4 で反射された光をコリメートレンズ 5 6 により再び光ファイバ 5 2 c の端面に入射させる。

また、上記光照射・受光部 5 4 b は、光照射（或いは光射出）及び受光を行う光ファイバ 5 2 b の端面付近に、超音波トランスジューサ 5 7 b とスキャニングデバイス 5 8 と音響レンズ 5 9 が設けられている。

【 0 0 7 5 】

超音波トランスジューサ 5 7 b は、超音波送信面側が例えば凹面形状に加工されており、パルス発生器 2 1 からパワーアンプ 2 2 で増幅されたパルス状の超音波駆動信号が印加されることにより、パルス超音波を発生し、このパルス超音波は収束されて生体組織 7 側に照射される。

10

また、スキャニングデバイス 5 8 は、パルス状超音波駆動信号と同期して、スキャニング信号発生回路 2 4 からのスキャニング信号が印加されることにより、光照射・受光部 5 4 b を 2 次元的にスキャンする。例えば、生体組織 7 の深さ方向、つまり z 方向と、この z 方向と直交する例えば x 方向等にスキャンする。

この光ファイバ 5 2 b の端面の拡大図を図 2 5 に示す。本実施例においては、光ファイバ 5 2 b は、中央部に配置した 1 本或いは複数本の光ファイバからなる第 1 の光ファイバ部 6 0 a と、この第 1 の光ファイバ部 6 0 a の周囲に配置した複数のファイバ、つまりファイババンドルからなる第 2 の光ファイバ部 6 0 b とにより構成されている。

20

【 0 0 7 6 】

そして、例えば図 2 6 の光カプラ 5 3 の拡大図に示すように光源装置 3 b による光を光ファイバ 5 2 a に入射させ、光カプラ 5 3 を構成する第 1 カプラ部 5 3 a において例えば 2 本に分岐させて光ファイバ 5 2 b の第 2 の光ファイバ部 6 0 b と光ファイバ 5 2 c における第 2 の光ファイバ部 6 0 b と導光させるようにしている。

そして、第 2 の光ファイバ部 6 0 b の端面から、導光されたレーザ光を生体組織 7 側に照射する。また、生体組織 7 側からのドップラーシフトした戻り光を中央の第 1 の光ファイバ部 6 0 a で受光するようにしている。この第 1 の光ファイバ部 6 0 a で受光された光は、第 2 のカプラ部 5 3 b において参照光側の光を導光する第 1 の光ファイバ部 6 0 a と光混合され、ドップラーシフトした干渉光が生成される。そして、この干渉光は、光ファイバ 5 2 d により導光されて光検出器 4 a で受光される。

30

【 0 0 7 7 】

この光検出器 4 a で検出された信号は、スペクトルアナライザ等の信号処理回路 5 c に入力され、ドップラーシフト量 f が検出される。

また、この信号処理回路 5 c は、パルス発生器 2 1 からディレイ回路 2 3 によりディレイされたタイミングに同期して、信号抽出の動作を行う。

この信号処理回路 5 c で検出された信号は、P C 6 a の P C 本体 6 c 内の A / D 変換回路に入力される。なお、P C 本体 6 c は、内部に C P U、メモリ、A / D 変換回路等を備えている。そして、P C 本体 6 c から出力される画像表示用信号はモニタ 3 5 に入力され、このモニタ 3 5 の表示面に光イメージング情報の画像が表示される。

40

また、この P C 本体 6 c 内の A / D 変換回路には、スキャニング信号発生回路 2 4 からスキャニング信号が入力され、このスキャニング信号を取り込むことにより、スキャニング位置情報を算出する。

【 0 0 7 8 】

また制御回路 2 5 は、パルス発生器 2 1、スキャニング信号発生回路 2 4 及びディレイ回路 2 3 の各動作を制御する。また、この制御回路 2 5 は、例えば P C 本体 6 c 内の C P U と制御信号などの送受を行うことができる。そして、制御回路 2 5 によりパルス発生器 2 1 等を制御することできると共に、P C 6 a 側から制御回路 2 5 を介して或いは制御回路 2 5 をスルーしてパルス発生器 2 1 等を制御することもできるようにしている。

このような構成による本実施例によれば、光ファイバ 5 2 b の先端付近をスキャニング

50

することにより、実施例 1 と同様に複素屈折率の実部に相当する光イメージング情報を得ることができる。さらに、スキャニングデバイス 5 8 としてサイズが小さくかつ駆動力が小さなもので済む。その他、実施例 1 と同様の効果を有する。

【 0 0 7 9 】

図 2 7 は実施例 6 の第 1 変形例の光イメージング装置 1 V の構成を示す。この光イメージング装置 1 V は、干渉計を形成しない構成にしたものである。この光イメージング装置 1 V は、図 2 4 の光イメージング装置 1 U において、光の分離や結合を行う光カプラ 5 3 を用いない構成にしている。

また、本変形例は、連続の光を発生する光源装置 3 c を採用し、超音波については連続波の超音波を発生する構成にしている。なお、図 2 4 の場合と同様に連続の光とパルス超音波とを採用する構成にしても良い。

光源装置 3 c からの光は、光ファイババンドル 5 2 a ' により、その先端面に導光され、光照射と受光を行う光照射・受光部 5 4 b における先端面から導光された光が生体組織 7 側に照射される。

【 0 0 8 0 】

また、この光ファイババンドル 5 2 a ' は、途中で光ファイバ 5 2 d ' と例えば一体化された光ファイババンドル部 5 2 b ' が形成されている。

この光ファイババンドル部 5 2 b ' は、例えば図 2 5 と類似の構成である。具体的には、図 2 7 中の端面拡大図に示すように、中心位置に受光用の光ファイバ 5 2 d ' が配置され、その周囲に光ファイババンドル 5 2 a ' を構成する光ファイバが配置された同心の構造になっている。

また、光ファイババンドル 5 2 a ' の先端付近の外側には凹面形状の超音波トランスジューサ 5 7 b とスキャニングデバイス 5 8 と音響レンズ 5 9 が設けられている。

【 0 0 8 1 】

そして、中心位置に配置した光ファイバ 5 2 d ' により、生体組織 7 側からのドップラーシフトした光を受光し、その基端面側に導光する。この基端面には、例えば分光装置 5 0 ' が配置されており、ドップラーシフトした光を光学的に分離抽出する。抽出された光は、光検出器 4 a に入力され、光電変換された電気信号となり、P C 本体 6 c に入力され、内部のメモリにスキャニング位置の情報や分光装置 5 0 ' による周波数分離の情報と共にストックされる。

本変形例は、図 2 4 の構成の場合における電氣的にドップラーシフトした周波数成分の信号を分離抽出することを行わない構成のため、図 2 4 における光検出器 4 a の出力信号は、信号処理回路 5 c を経由しないで、P C 本体 6 c に入力される。

【 0 0 8 2 】

光源装置 3 c による光の発生のタイミングは、制御回路 2 5 により制御される。また、制御回路 2 5 は、光の発生のタイミングに同期して、生体組織 7 側の収束点 F で反射されたドップラーシフトした光が分光装置 5 0 ' 、光検出器 4 a を経て P C 本体 6 c に入力されるタイミングにおいて、光検出器 4 a の出力信号を取り込むように P C 本体 6 c に制御信号を送る。

なお、超音波トランスジューサ 5 7 b は、図 2 の場合と同様に信号発生器 3 9 、パワーアンプ 2 2 を経た超音波駆動信号により駆動される。

その他は、図 2 4 の構成と同様である。本変形例は、図 2 4 の場合と同様の効果を有する。また、図 2 4 における光カプラ 5 3 や干渉させるための参照光生成部 5 5 等が不要となり、よりコンパクトな装置を実現できる。

【 0 0 8 3 】

なお、本変形例における分光装置 5 0 ' の代わりに、他の光学的な分光手段（若しくは波長分離抽出手段）、具体的には液晶チューナブルフィルタ、音響光学素子、回折格子等を用いることもできる。

図 2 8 は実施例 6 の第 2 変形例で、光イメージング装置を備えた内視鏡装置 1 W の構成を示す。

10

20

30

40

50

本変形例は、例えば実施例 6 における光照射・受光部 5 4 b に相当する構成を内視鏡 7 1 に設けている。

この内視鏡 7 1 は、挿入部 7 2 の先端に設けられた硬質の先端部 7 3 には、照明光を出射する照明窓と観察(撮像)を行う観察窓とが設けてある。照明窓にはライトガイド 7 4 の先端側が取り付けられてあり、その先端面から照明光を出射する。なお、ライトガイド 7 4 の図示しない手元側の端面には、図示しない内視鏡光源装置から照明光が入射される。

【0084】

また、観察窓には対物レンズ 7 5 が取り付けられてあり、その結像位置には撮像素子として例えば CCD 7 6 が配置されている。この CCD 7 6 は、図示しないビデオプロセッサ等の信号処理装置と接続され、この信号処理装置は、CCD 7 6 により撮像された画像信号

10

に対する信号処理を行って映像信号を生成し、図示しないモニタに映像信号を出力する。

また、この挿入部 7 2 にはその長手方向に処置具類を挿通可能とするチャンネル 7 7 が設けてあり、このチャンネル 7 7 内に光ファイバ 5 2 b が挿通される。

【0085】

そして、スキャニング信号発生回路 2 4 のスキャニング信号をスキャニングデバイス 7 9 に印加することにより、超音波トランスジューサ 7 8 を 2 次元的にスキャンすることが

20

できるようにしている。

なお、本変形例における超音波トランスジューサ 7 8 は例えば電子走査型の超音波トランスジューサにより構成され、この超音波トランスジューサは例えば図 2 8 における x 方向に沿って複数配置されたトランスジューサエレメントにより構成され、図示しない遅延素子等を介して遅延時間を制御して駆動することにより超音波を収束させるように出射させ、収束点 F で収束させることができるようにしている。

そして、図 2 8 に示すように光ファイバ 5 2 b の先端面から出射される光の照射部位内の領域において、超音波の収束点 F を設定し、この状態でスキャニングデバイス 7 9 をスキャニング信号で駆動することにより収束点 F を 2 次元的にスキャンする。

【0086】

30

その他の構成は図 2 4 と同様であり、その説明を省略する。本変形例によれば、内視鏡 7 1 により体腔内の生体組織 7 を内視鏡検査することができる。そして、病変部等、より詳しく観察或いは診断したい部位に対しては図 2 8 に示すようにチャンネル 7 7 内に光ファイバ 5 2 b を挿通して、その先端面を観察対象部位に対向させる。

そして、パルス発生器 2 1 からパワーアンプ 2 2 を介してパルス状超音波駆動信号を発生させると共に、スキャニング信号も発生させて、観察対象部位の周辺部に対する 2 次元イメージング情報を取得し、モニタ 3 5 の表示面に表示する。

本変形例においては、内視鏡 7 1 に光を照射する光照射部と、超音波を収束させるように照射する超音波照射手段と、超音波の収束領域を 2 次元的にスキャンするスキャニング手段とを設けているので、体腔内における所望とする部位の生体組織 7 に対する光イメー

40

【0087】

従って、体腔内の患部等の生体組織 7 を光学的に内視鏡検査し、その場合に病変部のように、より詳しく診断したい部位に対して、光イメージング情報を取得し、モニタ 3 5 に表示させるようにすることができる。このようにすることにより、内視鏡検査のみの場合よりも、病変部をよりの確に診断するのに有益な情報を得ることができる。

なお、本変形例を変形した第 3 変形例として以下に説明するように、例えばチャンネル 7 7 の先端開口部分に、実施例 4 における超音波を収束して照射する機能と、スキャニング手段の機能も備えた光照射・受光部 5 4 b を設けるようにしても良い。

図 2 9 は、実施例 6 の第 3 変形例の内視鏡装置 1 x における内視鏡 7 1 の先暗部付近の

50

構成を示す。本変形例は、図 2 4 の光照射・受光部 5 4 b をチャンネル 7 7 の先端開口に着脱自在に取り付けた構成にしたものである。このような構成にすることにより、既存の内視鏡のチャンネルに光照射・受光部 5 4 b を取り付けて光イメージング情報を得ることができる。なお、図 2 7 の構成のものを同様に内視鏡に適用しても良い。この場合にも同様の効果を得ることができる。

【 0 0 8 8 】

また、図 3 0 は第 4 変形例における光ファイバ 5 2 b の端部の構成例を示す。図 2 5 で示したようにこの光ファイバ 5 2 b は、その中央部に第 1 の光ファイバ部 6 0 a が配置され、その周囲に複数のファイバからなる第 2 の光ファイバ部 6 0 b が配置されている。図 3 0 の光ファイバ 5 2 b においては、第 2 の光ファイバ部 6 0 b の端面が中央部の第 1 の光ファイバ部 6 0 a の軸に関して回転対称となる放物面等の凹面を形成するように加工されており、さらにその端面には集光するコリメートレンズ（或いは集光レンズ）6 0 c が取り付けられている。

そして、各第 2 の光ファイバ部 6 0 b の端面から出射される光を焦点位置 F_0 にフォーカスすることができるようにしている。このようにすることにより、S / N が良い光イメージング情報を取得できる。

【 0 0 8 9 】

上記各実施例においては、超音波としてパルス又は連続波のいずれでも良く、さらに光検出器 4 a は、点検出器である Photodiode や光電子倍增管、1 次元ライン型検出器や CCD 等の 2 次元検出器のいずれを用いても良い。

【 0 0 9 0 】

また、上記各実施例においては、フーリエ変換にてドップラーシフト量を検出する構成にしても良い。

【 実施例 7 】

【 0 0 9 1 】

次に図 3 1 から図 3 4 を参照して本発明の実施例 7 を説明する。図 3 1 は本発明の実施例 7 の光イメージング装置 1 Z の構成を示す。本実施例は、超音波出射部と、光照射及び光検出部とが一体的に形成された超音波出射・光照射・検出部がラインに沿って複数個、1 次元的に配列された超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 を採用した構成である。この構成により、1 つの超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 を用いてスキャンを行うこと無しで 1 次元の光イメージング情報を得られるようにしたものである。これにより、1 次元の光イメージング情報を時間短縮して得られる効果を有する。

【 0 0 9 2 】

また、この超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 を 1 次元的にスキャンすることにより、2 次元の光イメージング情報が得られる。

なお、後述するように複数の超音波出射・光照射・検出部が 2 次元的に配置された超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 B を採用することにより、超音波トランスジューサ等のスキャンを行わないでも 2 次元のイメージング情報を得ることもできる。

【 0 0 9 3 】

なお、本実施例は、ドップラーシフト量 Δf を抽出することにより、散乱情報を算出するタイプの構成となっている。

光源装置 9 1 から出射される可視或いは近赤外の波長領域の光は、複数本（例えば p 本）の光ファイバを配列して構成された光ファイバアレイ 9 2 a を構成する各光ファイバに入射される。各光ファイバに入射された光は、光カプラ部 9 3 で光ファイバアレイ 9 2 c の光ファイバ側と光ファイバアレイ 9 2 b 側の光ファイバ 9 2 b i（ i は 1 ~ p の 1 つを代表）とに分岐される。

【 0 0 9 4 】

光ファイバアレイ 9 2 c の光ファイバに導光された光は、参照光生成部 5 5 において、図 2 4 の場合と同様に参照光が生成され、光カプラ部 9 3 側に戻る。

また、光ファイバアレイ 9 2 b 側の光ファイバ 9 2 b i に導光された光は、（超音波出

10

20

30

40

50

射・光照射・検出アレイ 9 5 を構成する) 超音波出射・光照射・検出部の超音波トランスジューサ 5 7 - i に設けた開口部を通して生体組織 7 側に照射される。

超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 は、図 3 1 の右下部分の拡大図に示すように例えば x 方向に複数の超音波出射・光照射・検出部が配置されている。そして、各超音波出射・光照射・検出部は、その構成要素となる超音波トランスジューサ 5 7 - i によりそれぞれ収束点 F で超音波を収束する。

【 0 0 9 5 】

かつその収束点 F には、光ファイバアレイ 9 2 b を構成する光ファイバ 9 2 b i の端面による光照射・検出部から光が照射されると共に、その収束点 F の近傍領域 R 1 を経たドップラーシフトした戻り光を受光する。

10

光ファイバアレイ 9 2 b の光ファイバ 9 2 b i により受光された光は、観測光として、光カプラ部 9 3 において光ファイバアレイ 9 2 c 側の光ファイバによる参照光と光混合されてドップラーシフトした干渉光が生成される。

各干渉光は、光ファイバアレイ 9 2 d の光ファイバにより導光され、その端面から光検出器アレイ 9 6 を構成する各光検出器 4 a にて受光され、光電変換される。光検出器アレイ 9 6 を構成する光検出器 4 a でそれぞれ光電変換された出力信号は、例えば複数チャンネルのスペクトルアナライザ 5 e に入力される。

【 0 0 9 6 】

そして、このスペクトルアナライザ 5 e により各光検出器 4 a から出力されるドップラシフト量 Δf の干渉信号を殆ど同時に抽出する。

20

このスペクトルアナライザ 5 e から出力される複数の干渉信号は、P C 6 a における複数の入力チャンネルから P C 6 a 内のメモリなどにストックされる。

また、本実施例におけるスキヤニング信号発生回路 2 4 B は、例えば超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 が取り付けられたスキヤニングデバイス 9 8 を例えば y 方向にスキャンさせるように駆動する。そして、2 次元の光イメージング情報を得られるようにしている。なお、ここではパルス発生器 2 1 ' は、図 2 4 のパルス発生器 2 1 とパワーアンプ 2 2 の機能を備えたものである。

【 0 0 9 7 】

図 3 2 は、超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 を、例えば y 方向にスキャンさせることにより、2 次元 (2 D) 光イメージング情報が得られる様子を示す。ライン状に配置された超音波出射・光照射・検出部により、x 方向の 1 次元 (1 D) 光イメージング情報が得られ、超音波出射・光照射・検出部を y 方向にスキャンすることにより 2 次元光イメージング情報が得られる。

30

なお、スキヤニング信号発生回路 2 4 B により、超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 を y 方向及び z 方向に 2 次元スキャンを行うように駆動して、3 次元光イメージング情報を得られるようにしても良い。

本実施例によれば、高速に 2 次元或いは 3 次元の光イメージング情報が得られる。

【 0 0 9 8 】

なお、得られる光イメージング情報の x 方向の解像度は、光ファイバアレイ 9 2 b の本数に依存するため、x 方向にもスキャンさせることにより、その解像度を飛躍的に向上させるようにしても良い。

40

図 3 3 は第 1 変形例の光イメージング装置における超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 B の概略の構成を示す。本変形例は、図 3 1 の光イメージング装置 1 Z において、光ファイバアレイ 9 2 a 、 9 2 b など構成する光ファイバの本数をより多くしている (例えば図 3 1 の場合の整数倍以上) 。これに対応して、超音波出射・光照射・検出部の数も増大する。

そして、本変形例では、光ファイバアレイ 9 2 b における端部側の超音波出射・光照射・検出部を x 、 y 方向に 2 次元的に配置して超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 B を構成している。

【 0 0 9 9 】

50

図 3 3 に示すように光ファイバアレイ 9 2 b は、例えば p 本ずつの光ファイバ 9 2 b 1 ~ 9 2 b p が m 組、例えば帯状に設けられたものであり、これらの各光ファイバ 9 2 b i は、スキャニングデバイス 9 8 に 2 次元的に設けた開口部にそれぞれ取り付けられている。

なお、このスキャニングデバイス 9 8 の底面側には、図 3 1 で示したような超音波トランスジューサ（図 3 3 では図示せず）が取り付けられている。そして、この超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 B をスキャンしない状態において、2 次元光イメージング情報（図 3 4 参照）を得ることができるようにしている。

なお本変形例においては、P C 6 a もスペクトルアナライザ 5 e から出力される出力信号を超音波出射・光照射・検出アレイ 9 5 B を構成する超音波出射・光照射・検出部の 2 次元配列に対応したアドレスのメモリにストックする。

10

【 0 1 0 0 】

また、本変形例では、スキャニング信号により、スキャニングデバイス 9 8 を z 方向に駆動することにより図 3 4 に示すように 3 次元光イメージング情報を得られるようにしている。

なお、本変形例に対しても、実施例 4 で説明したように x、y 方向にもスキャンすることにより、より高解像度の光イメージング情報を得るようにしても良い。本変形例においても高速に 2 次元或いは 3 次元の光イメージング情報を得ることができる。

なお、本変形例におけるさらに変形例として、スキャニングを行わないで 2 次元の光イメージング情報を得るようにしても良い。

20

【 0 1 0 1 】

なお、上述した各実施例において、光を収束させる構成にしても良い。上記の各実施例では、パルス超音波、又は連続超音波のいずれを用いてもよい。また、スペクトルアナライザなどの信号処理回路を用いずにフーリエ変換によりドップラーシフト量を検出しても良い。

なお、上記の各実施例においては、複素屈折率の実部に基づく光散乱情報を検出するものであるが、例えば、蛍光、りん光等の非弾性散乱情報に基づいて生体組織の情報を取得しても良い。

また、上述した各実施例を部分的に組み合わせる等して構成される実施例等も本発明に属する。

30

【産業上の利用可能性】

【 0 1 0 2 】

生体組織に超音波が照射された検査対象部位に光を照射し、超音波が照射された部位でドップラーシフトした光を観測光として検出し、複素屈折率の実部に相当する光散乱情報を検出して画像化できるようにすることにより、病変組織の構造変化に相関性が高い情報を得ることができ、病変組織の診断等に有効利用することができる。

【図面の簡単な説明】

【 0 1 0 3 】

【図 1】図 1 は本発明の被検体情報分析装置の代表的な構成例を示すブロック図。

【図 2】本発明の実施例 1 に係る光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

40

【図 3】図 3 は超音波収束領域付近においてドップラーシフトする様子の説明図。

【図 4】図 4 は実施例 1 の動作説明用のフローチャート。

【図 5】図 5 はフーリエ変換された信号の実数成分の角周波数に対する波形例を示す図。

【図 6】図 6 は第 1 変形例におけるレンズ保持部及びトランスジューサ保持部の構造を示す図。

【図 7】図 7 は第 2 変形例における超音波の収束点近傍領域でのドップラーシフトする様子の説明図。

【図 8】図 8 は本発明の実施例 2 に係る光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

。

【図 9】図 9 は実施例 2 の変形例におけるレンズ保持部及びトランスジューサ保持部の構

50

造を示す図。

【図 1 0】図 1 0 は本発明の実施例 3 に係る光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図 1 1】図 1 1 は実施例 3 の動作説明用のフローチャート。

【図 1 2】図 1 2 はフーリエ変換された信号の実数成分の角周波数に対する波形例を示す図。

【図 1 3】図 1 3 は第 1 変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図 1 4】図 1 4 は第 2 変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図 1 5】図 1 5 は本発明の実施例 4 に係る光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図 1 6】図 1 6 は実施例 4 の動作説明用のフローチャート。

【図 1 7】図 1 7 は実施例 4 の変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図 1 8】図 1 8 は実施例 5 に係る光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図 1 9】図 1 9 は実施例 5 の動作説明用のタイミングチャート。

【図 2 0】図 2 0 は実施例 5 の第 1 変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図 2 1】図 2 1 は実施例 5 の第 2 変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図 2 2】図 2 2 は実施例 5 の第 3 変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図 2 3】図 2 3 は実施例 5 の第 4 変形例における一部の構成を示す図。

【図 2 4】図 2 4 は本発明の実施例 6 に係る光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図 2 5】図 2 5 は光ファイバの端面の構造を示す図。

【図 2 6】図 2 6 は光カプラの構成例を示す図。

【図 2 7】図 2 7 は実施例 6 の第 1 変形例の光イメージング装置の全体構成を示すブロック図。

【図 2 8】図 2 8 は光イメージング装置を備えた第 2 変形例に係る内視鏡装置の構成を示すブロック図。

【図 2 9】図 2 9 は第 3 変形例の光イメージング装置における内視鏡の先端側の構成を示す図。

【図 3 0】図 3 0 は第 4 変形例における光ファイバの構成を示す斜視図。

【図 3 1】図 3 1 は本発明の実施例 7 に係る光イメージング装置の構成を示すブロック図。

【図 3 2】図 3 2 は実施例 7 における 1 次元走査により 2 次元光イメージング情報が得られる動作の説明図。

【図 3 3】図 3 3 は第 1 変形例における超音波・光照射・検出アレイ部の概略の構成を示す図。

【図 3 4】図 3 4 は図 3 3 の超音波・光照射・検出アレイ部による動作の説明図。

【符号の説明】

【0 1 0 4】

1 E、1 F ... 光イメージング装置

2 ... 超音波発生部

2 a ... 超音波トランスジューサ

3 ... 照明光発生部

3 b ... 光源装置

4 ... 反射光受光部

4 a ... 光検出器

5 ... 周波数情報抽出部

10

20

30


40

50


- 5 c ... 信号処理回路
- 6 ... 散乱情報抽出部
- 6' ... 被検体情報生成部
- 6 a ... P C
- 7 ... 生体組織
- 1 1 ... ユニット
- 1 2 ... スキャニングユニット
- 1 3 a ... ハーフミラー
- 1 6 ... 音響レンズ
- 2 4 ... スキャニング信号発生回路
- 3 3 ... C P U
- 3 5 ... モニタ
- 3 8 ... コリメートレンズ

10


【図 1】

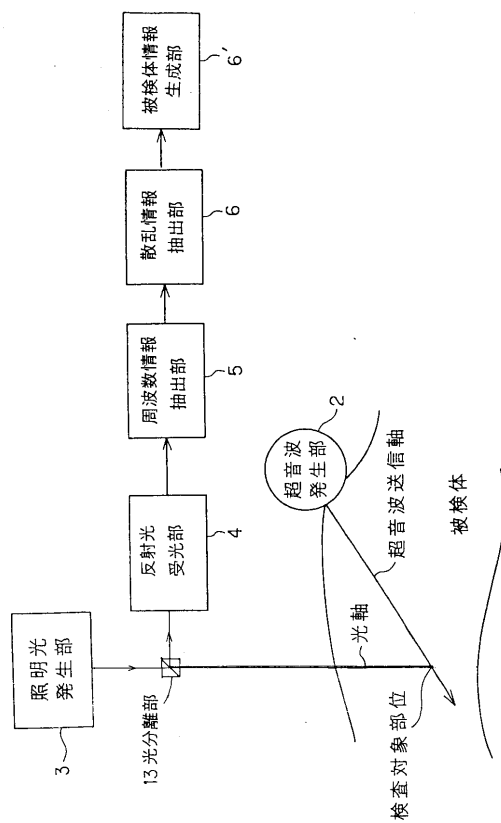


【図 2】

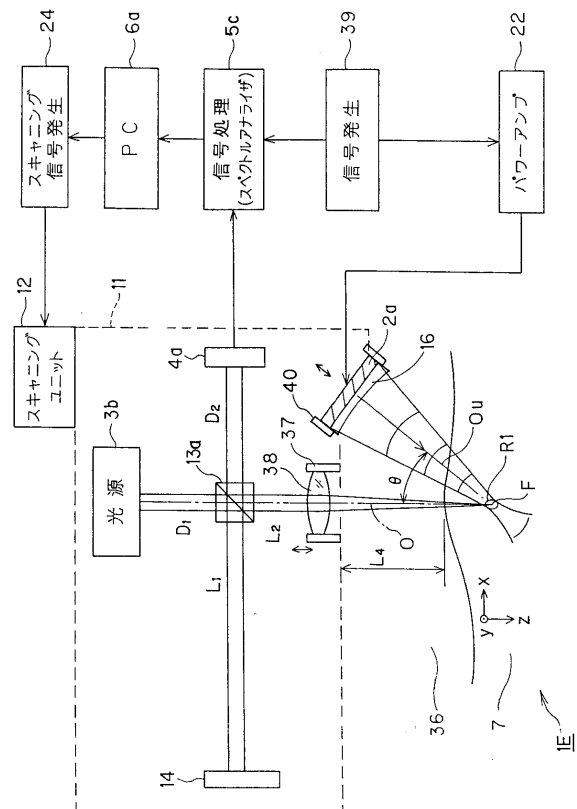


【図 3】

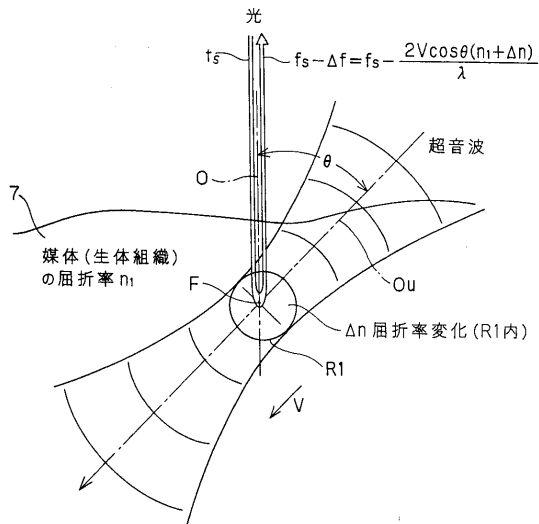


【図 4】

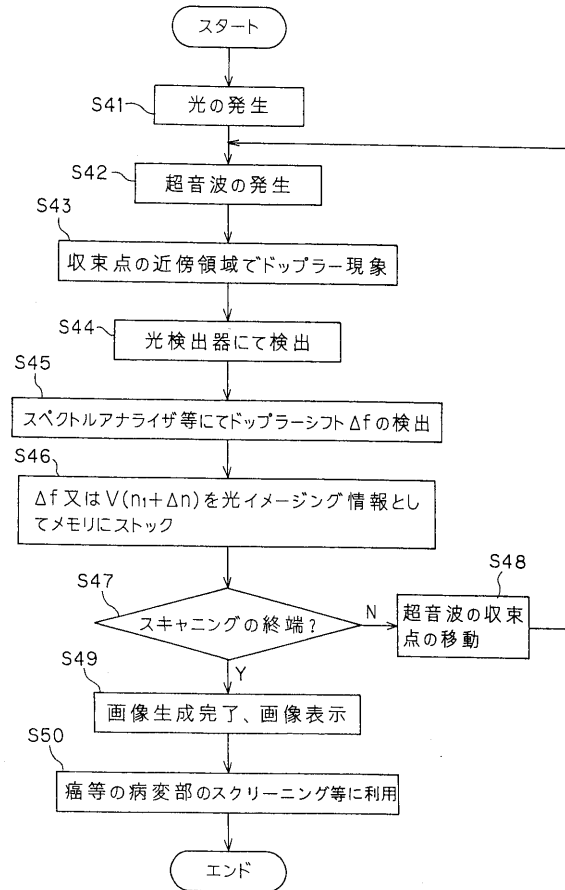


【図 5】

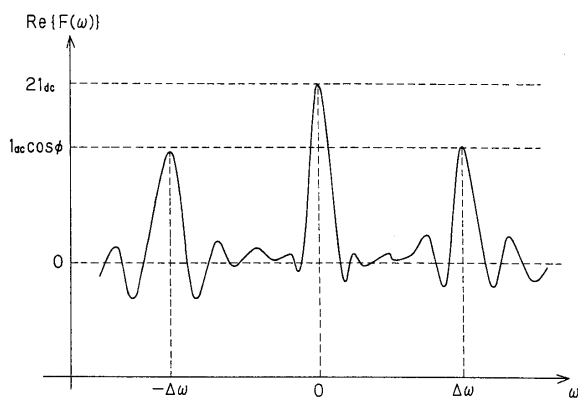


【図 6】

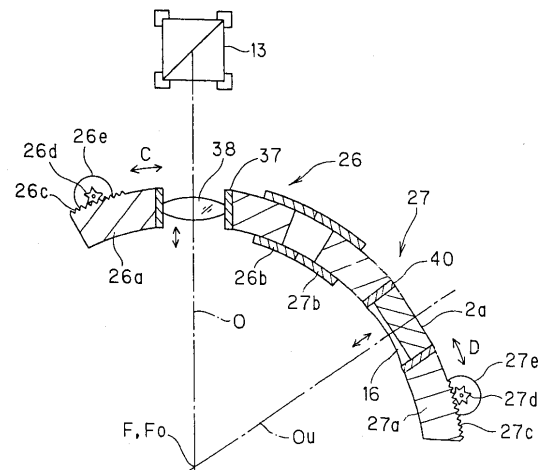


【図 7】

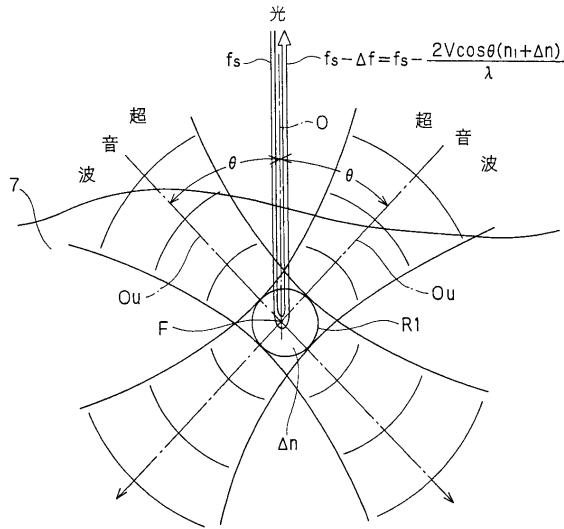


【図 8】

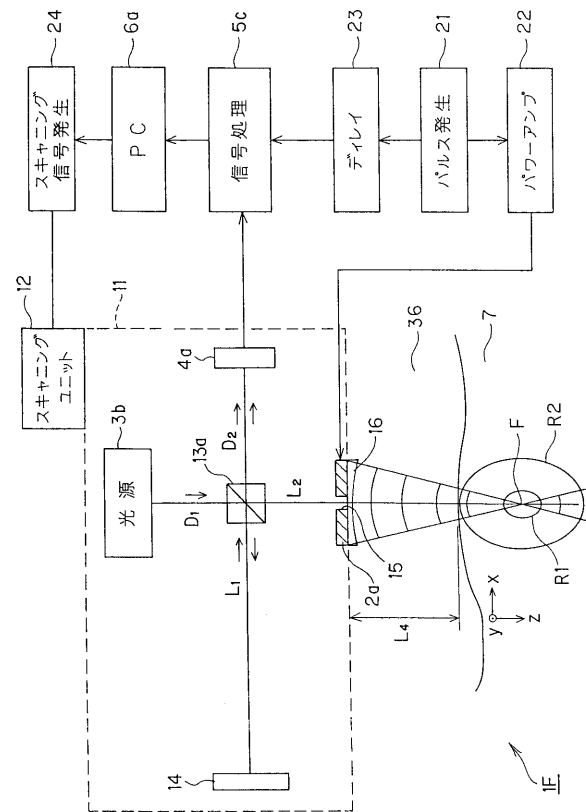


【図 9】

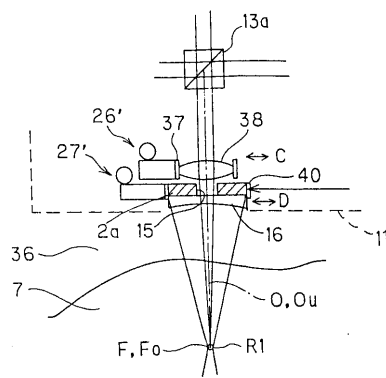


【図 10】

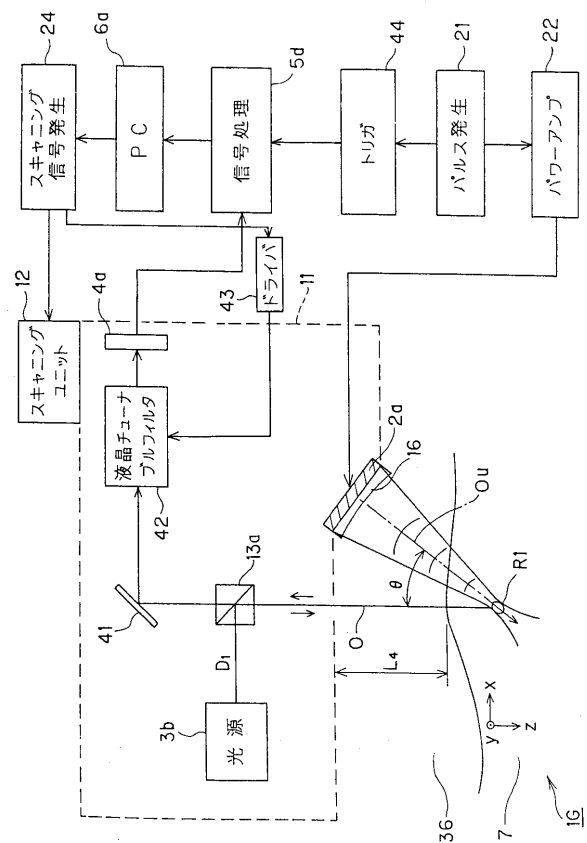


【図 1 1】

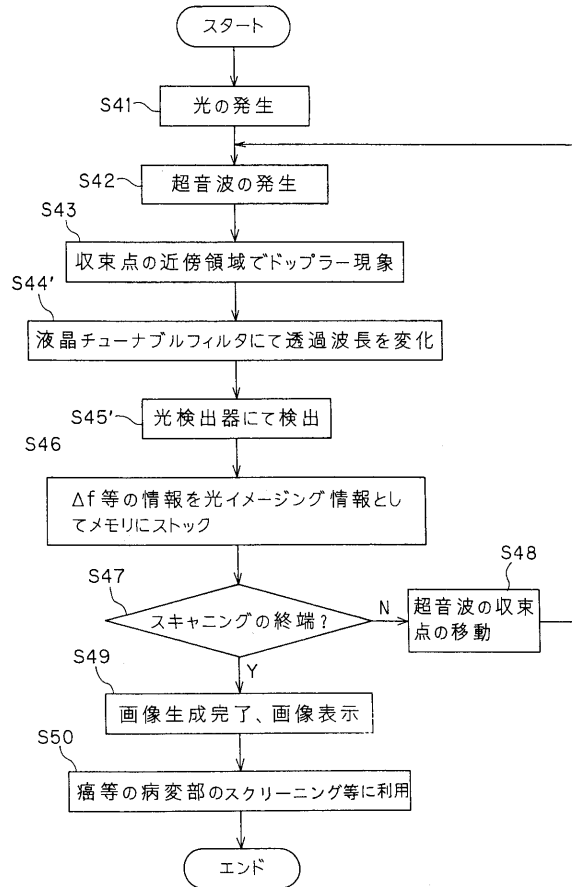


【図 1 2】

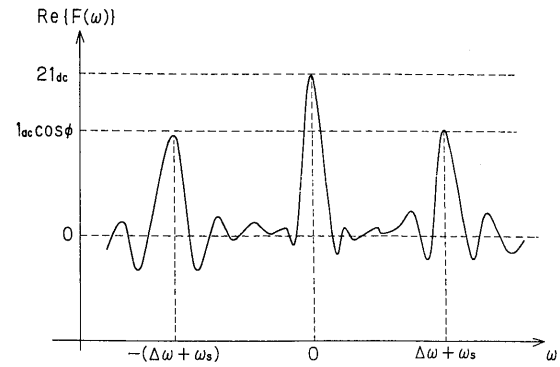


【図 1 3】

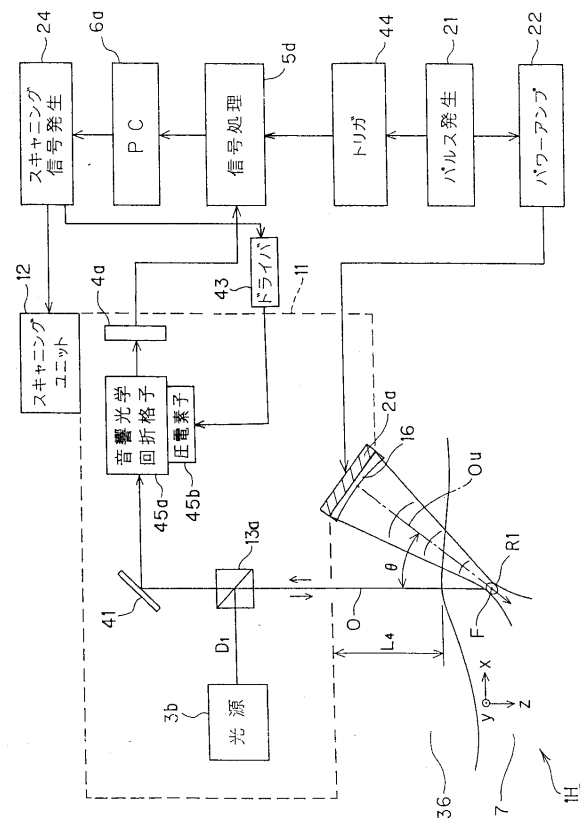


【図 1 4】

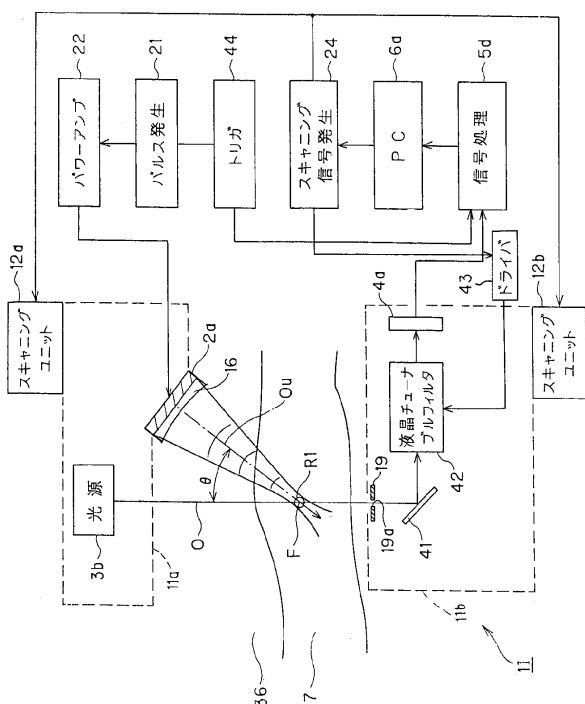


【 図 1 5 】

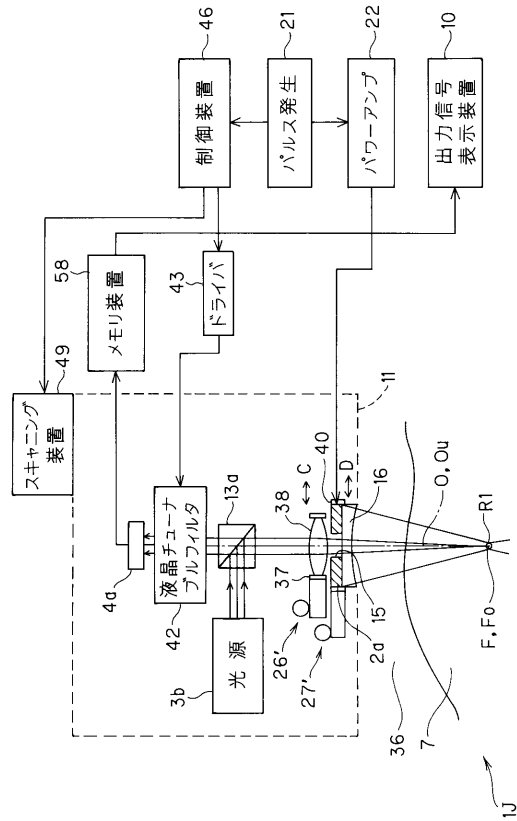


【 図 1 6 】

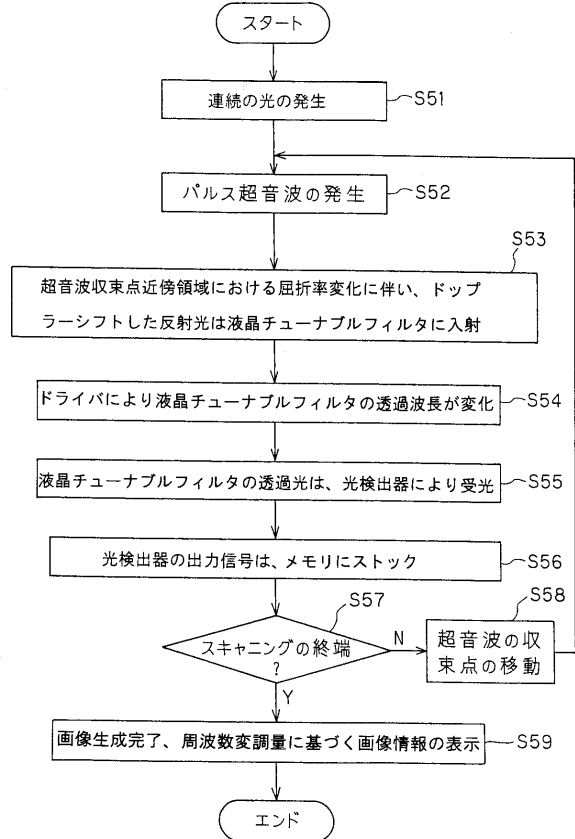


【 図 1 7 】

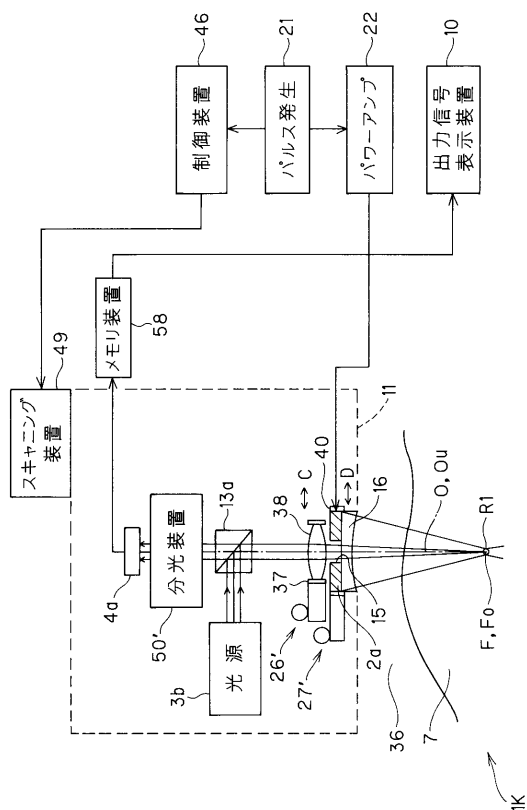


【 図 1 8 】

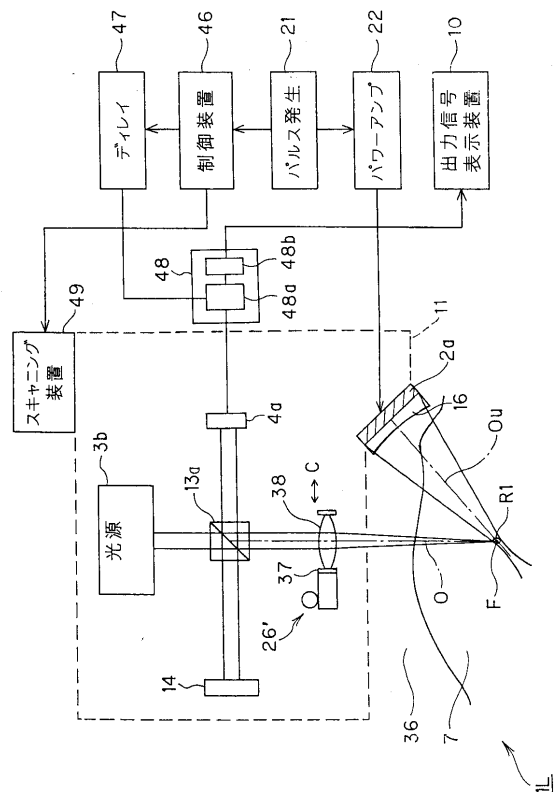


【 図 2 0 】

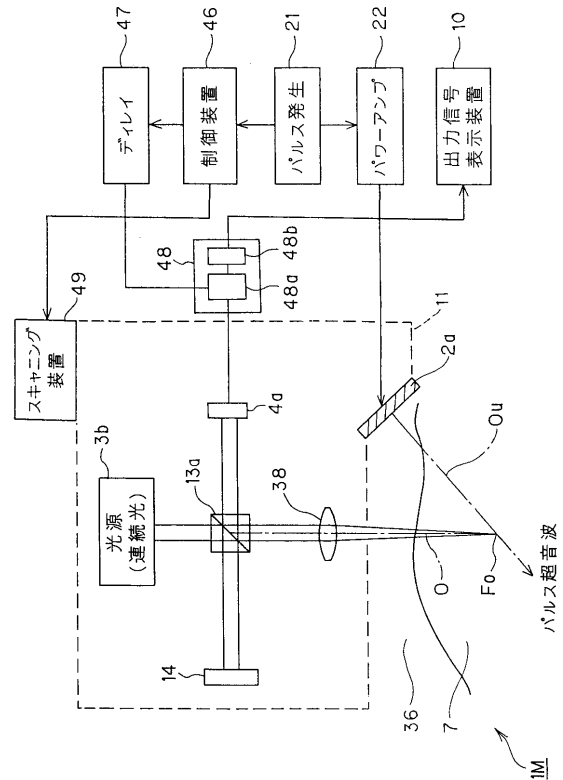


【 ㄨ 2 2 】

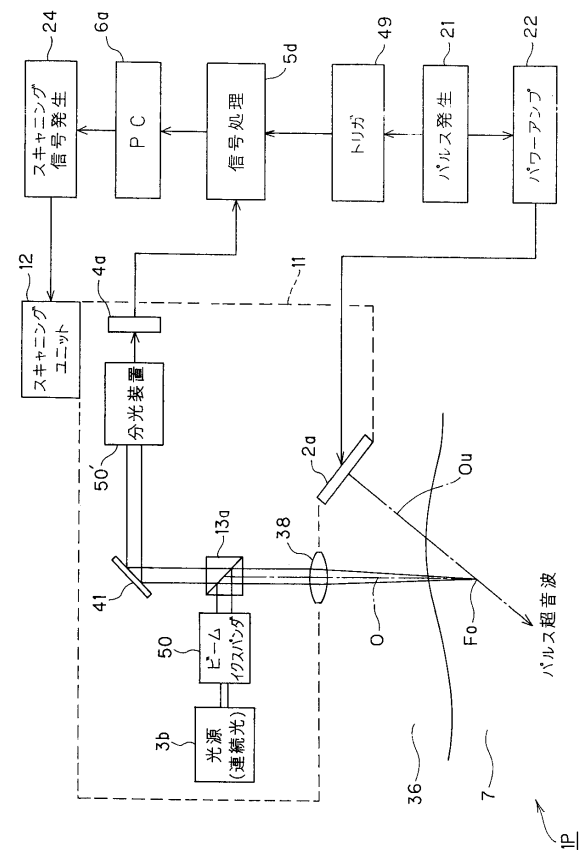


【図 23】

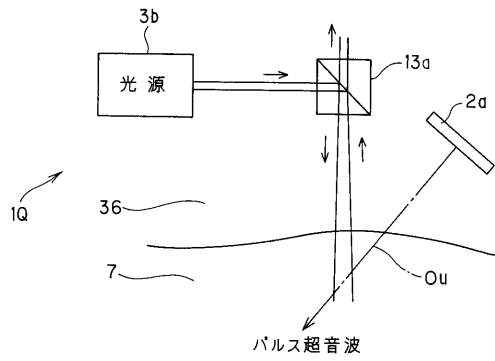


【図 24】

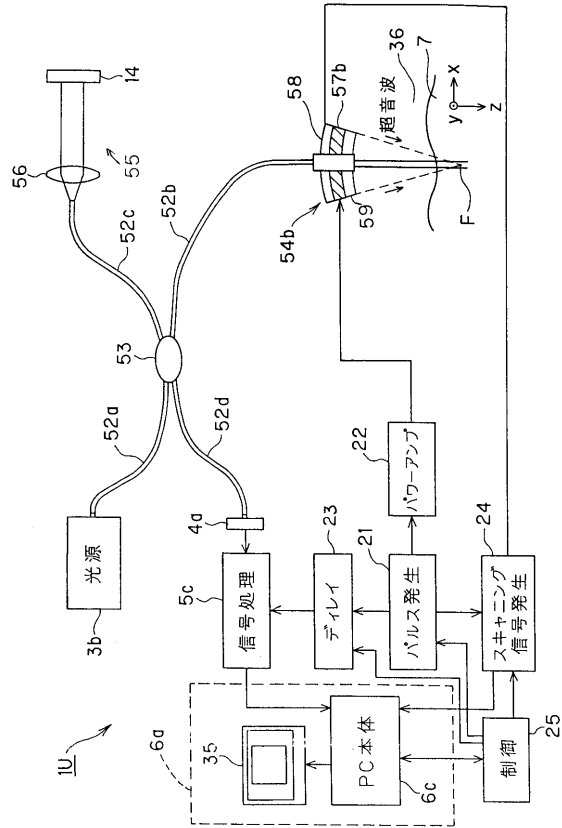


【図 25】

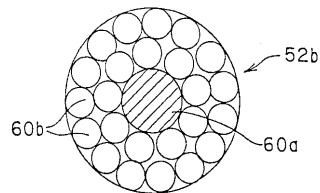


【図 26】

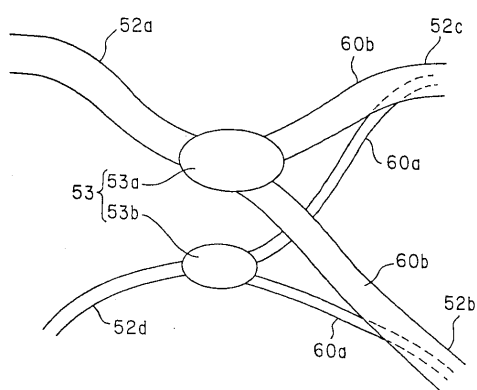


【図 27】

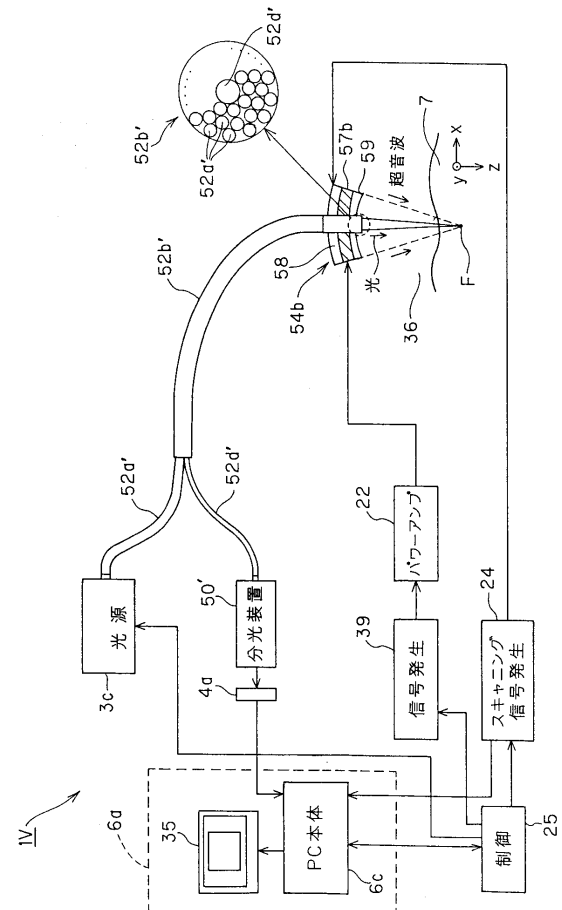


【図 28】

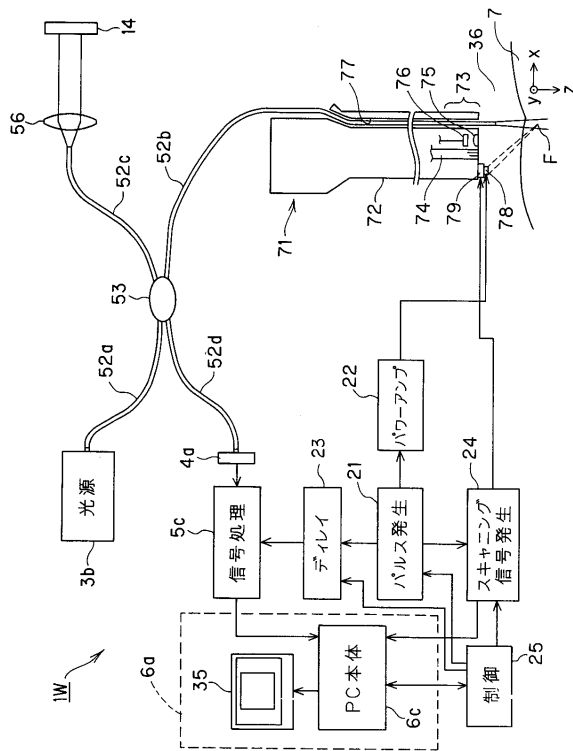


【図 29】

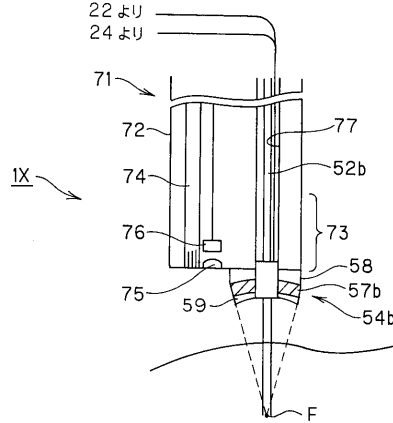


【図 30】

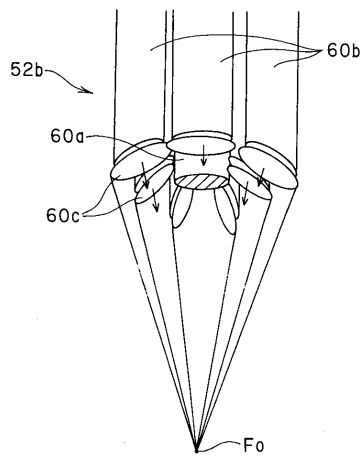


【図 31】

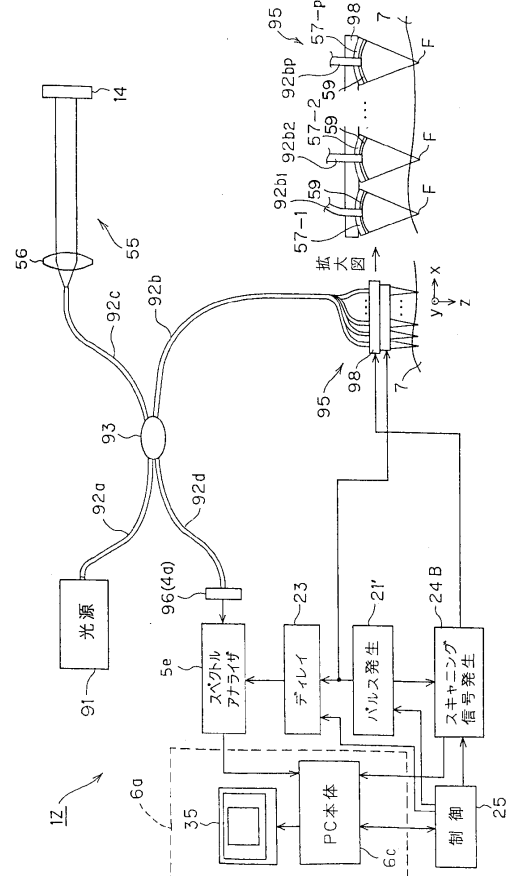


【図 3 2】

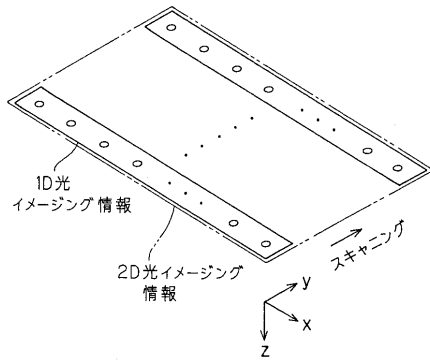

【図 3 3】

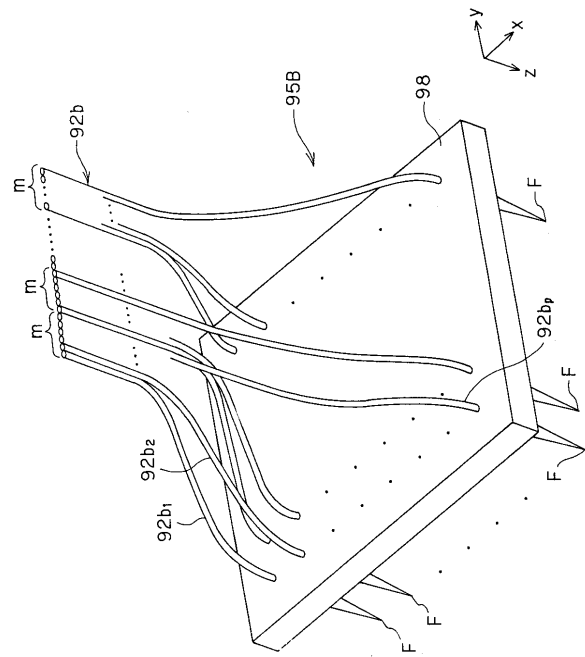

【図 3 4】

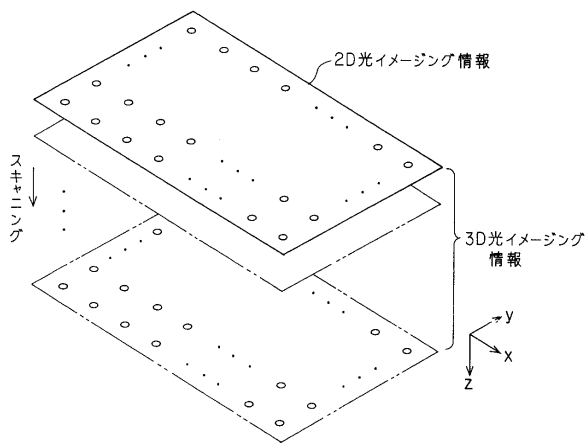

フロントページの続き

(56)参考文献 特開 2 0 0 5 - 2 2 4 3 9 9 (J P , A)
特開 2 0 0 0 - 1 9 7 6 5 3 (J P , A)
特開 2 0 0 6 - 2 0 4 4 3 0 (J P , A)
特開 2 0 0 6 - 2 8 0 4 4 9 (J P , A)

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)

G 0 1 N 2 1 / 1 7

A 6 1 B 1 / 0 0 , 8 / 0 0 , 1 0 / 0 0

G 0 1 B 1 7 / 0 0 , 1 7 / 0 6

专利名称(译)	被検体情報分析装置、内视镜装置及び被検体情報分析方法		
公开(公告)号	JP4939236B2	公开(公告)日	2012-05-23
申请号	JP2007005678	申请日	2007-01-15
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯医疗株式会社		
申请(专利权)人(译)	オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
[标]发明人	五十嵐 誠		
发明人	五十嵐 誠		
IPC分类号	G01N21/17 A61B1/00 A61B10/00 G01B17/06 A61B8/00		
FI分类号	G01N21/17.630 A61B1/00.300.D A61B10/00.E G01B17/06 A61B8/00 A61B1/00.550		
F-TERM分类号	2F068/AA38 2F068/CC07 2F068/DD11 2F068/FF03 2F068/FF28 2F068/GG07 2F068/GG09 2F068/JJ12 2F068/KK14 2F068/LL25 2F068/QQ10 2F068/QQ12 2F068/QQ31 2G059/AA02 2G059/AA06 2G059/BB12 2G059/CC16 2G059/EE02 2G059/EE07 2G059/EE09 2G059/EE12 2G059/EE16 2G059/FF02 2G059/HH01 2G059/HH06 2G059/JJ01 2G059/JJ02 2G059/JJ11 2G059/JJ17 2G059/JJ18 2G059/JJ22 2G059/KK04 2G059/MM01 2G059/MM10 2G059/PP04 4C061/BB08 4C061/GG01 4C061/HH51 4C161/BB08 4C161/GG01 4C161/HH51 4C601/DD23 4C601/EE30 4C601/LL40		
代理人(译)	伊藤 进		
其他公开文献	JP2008170363A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供了一种对象信息分析装置，内窥镜装置和对象信息分析方法，用于容易地获取包括对象中的检查目标部分的光的散射信息的对象的特征信息。 解决方案：超声波发生单元2沿预定的超声波透射轴向对象产生超声波，并且照明光产生单元3在发送超声波的对象中的检查目标部分处产生超声波。并产生照明光以便到达它。反射光接收单元4接收在检查目标部位中调频的光，从接收的光信号中提取频率信息提取单元5的频率信息，通过散射信息提取单元6提取关于检查目标部位的光的散射信息。等等，生成与对象的检查对象部分对应的对象的特征信息。点域1

【 図 1 】

