

(19) 日本国特許庁(JP)

## 再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

WO2007/119297

発行日 平成21年8月27日 (2009.8.27)

(43) 国際公開日 平成19年10月25日 (2007.10.25)

(51) Int.Cl.	F 1	テーマコード (参考)
<b>A61B 1/04</b> (2006.01)	A 61 B 1/04	4 C 0 6 1
<b>G06T 1/00</b> (2006.01)	G 06 T 1/00	5 B 0 5 7

## 審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 25 頁)


出願番号	特願2008-510749 (P2008-510749)	(71) 出願人	304050923 オリンパスメディカルシステムズ株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号
(21) 国際出願番号	PCT/JP2007/053588	(74) 代理人	100076233 弁理士 伊藤 進
(22) 国際出願日	平成19年2月27日 (2007.2.27)	(72) 発明者	西村 博一 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ リンパスメディカルシステムズ株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願2006-73184 (P2006-73184)	(72) 発明者	田中 秀樹 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ リンパスメディカルシステムズ株式会社内
(32) 優先日	平成18年3月16日 (2006.3.16)	(72) 発明者	中村 健次 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ リンパスメディカルシステムズ株式会社内
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】医療用画像処理装置及び医療用画像処理方法

## (57) 【要約】

画像処理装置3は、内視鏡6により撮像された内視鏡画像のR成分画像からその輝度情報をを利用して3次元形状と3次元形状の曲面の特徴量の情報とを算出する。また、画像処理装置3は、R、Gの両画像成分から発赤・褪色調の色調変化領域を検出し、その検出結果に応じて3次元形状の曲面における隆起性変化領域から隆起性病変としてのポリープを検出する場合の閾値としての検出基準の値を変更して、精度の高いポリープ検出を行うようしている。

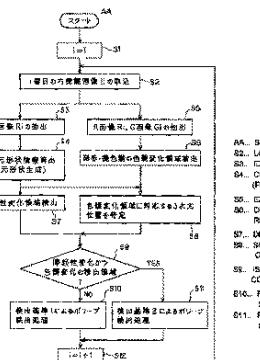

AA: START  
 S2: LOCATING R IMAGE IN ENDOSCOPIC RANGE (S2)  
 S4: COMPUTING THREE-DIMENSIONAL SHAPE DATA (FORMING THREE-DIMENSIONAL SHAPE)  
 S6: DETECTING AREA WITH COLOR CHANGE SUCH AS RED COLOR (S6)  
 S8: DETECTING AREA WITH ELEVATION CHANGE (S8)  
 S10: DETECTING THREE-DIMENSIONAL POSITION CORRESPONDING TO COLOR CHANGE AREA (S10)  
 S12: DETECTING THREE-DIMENSIONAL POSITION CORRESPONDING TO ELEVATION CHANGE AREA (S12)  
 S14: POLYPT DETECTION TREATMENT BASED ON DETECTION SYMTHOMA 1 (S14)  
 S16: POLYPT DETECTION TREATMENT BASED ON DETECTION SYMTHOMA 2 (S16)

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

複数の色信号からなる医療用画像における少なくとも1つの色信号に基づき病変候補領域を検出する病変候補領域検出手段と、

前記医療用画像から病変に伴い付隨した性状で発生する付隨領域を検出する付隨領域検出手段と、

前記付隨領域の検出結果に応じて前記病変候補領域から病変を検出する際の検出基準を変更する検出基準変更手段と、

を具備したことを特徴とする医療用画像処理装置。

**【請求項 2】**

10

前記病変候補領域検出手段は、前記医療用画像から前記少なくとも1つの色信号に基づき、3次元形状の情報を生成する3次元形状の情報生成手段を有し、生成された3次元形状の情報を利用して病変候補領域を検出することを特徴とする請求項1に記載の医療用画像処理装置。

**【請求項 3】**

前記付隨領域検出手段は、前記付隨領域として、発赤若しくは褪色等の色調変化の性状を呈する色調変化領域を検出することを特徴とする請求項1に記載の医療用画像処理装置。

**【請求項 4】**

前記付隨領域検出手段は、前記付隨領域として、白斑若しくは異常血管の異常所見の性状を呈する異常所見領域を検出することを特徴とする請求項1に記載の医療用画像処理装置。

20

**【請求項 5】**

前記検出基準変更手段は、前記検出基準として、生成された前記3次元形状の情報における曲面形状を表す特徴量のShape Index及びCurvednessの少なくとも一方の閾値を変更することを特徴とする請求項3に記載の医療用画像処理装置。

**【請求項 6】**

複数の色信号からなる医療用画像における少なくとも1つの色信号から病変候補領域を検出する病変候補領域検出手段と、

前記医療用画像から病変に伴い付隨した性状で発生する付隨領域を検出する付隨領域検出手段と、

30

前記病変候補領域検出手段により検出された病変候補領域と、前記付隨領域検出手段により検出された付隨領域とが相関する領域の有無により病変検出を行うことを特徴とする医療用画像処理装置。

**【請求項 7】**

複数の色信号からなる医療用画像における少なくとも1つの色信号に基づき病変候補領域を検出する病変候補領域検出手段と、

前記医療用画像から病変に伴い付隨した性状で発生する付隨領域の有無を検出する付隨領域検出手段と、

40

前記付隨領域の有無の検出結果に応じて前記病変候補領域から病変を検出する際の検出基準を変更する検出基準変更手段と、

を具備したことを特徴とする医療用画像処理方法。

**【請求項 8】**

前記病変候補領域検出手段は、前記医療用画像から前記少なくとも1つの色信号に基づき、3次元形状の情報を生成する3次元形状の情報生成手段を有し、生成された3次元形状の情報を利用して病変候補領域を検出することを特徴とする請求項7に記載の医療用画像処理方法。

**【請求項 9】**

前記付隨領域検出手段は、前記付隨領域として、発赤若しくは褪色の色調変化の性状を呈する色調変化領域を検出することを特徴とする請求項7に記載の医療用画像処理方

50

法。

#### 【請求項 10】

前記付隨領域検出ステップは、前記付隨領域として、白斑若しくは異常血管の性状を呈する異常所見領域を検出することを特徴とする請求項 7 に記載の医療用画像処理方法。

#### 【請求項 11】

前記検出基準変更ステップは、前記検出基準として、生成された前記 3 次元形状の情報における曲面形状を表す特徴量の *Shape Index* 及び *Curvedness* の少なくとも一方の閾値を変更することを特徴とする請求項 8 に記載の医療用画像処理方法。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【技術分野】

10

##### 【0001】

本発明は、医療用画像から病変部候補領域を検出し、ポリープ等の病変を検出するのに適した医療用画像処理装置及び医療用画像処理方法に関する。

##### 【背景技術】

##### 【0002】

近年、内視鏡は、例えば医療用分野における検診や診断等において広く用いられるようになった。

この場合、術者は、内視鏡の挿入部を患者の大腸等の体腔内に挿入して、挿入部の先端部に設けた撮像手段により体腔内を撮像し、モニタに表示される内視鏡画像を観察してポリープ等の病変部の検診や診断等の内視鏡検査を行う。このような場合、術者は患者に与える苦痛を少なく、かつ円滑に内視鏡検査を行うことが望まれるため、術者の負担が大きくなる。

##### 【0003】

このため、例えば第 1 の従来例としての特開 2004-180932 号公報には、X 線 CT 装置等による第 1 の画像診断装置と、X 線 TV 装置等の第 2 の画像診断装置によりそれぞれ同一関心領域に対する病変候補を検出し、これら 2 つの検出結果を相互に比較対象して検出結果を合成して術者に提示することにより、術者の見落としを防ぐことができるようしている。

##### 【0004】

また、第 2 の従来例としての特開 2005-192880 号公報においては、内視鏡画像から病変候補領域を色調情報から検出する画像処理方法が開示されている。

30

##### 【0005】

しかしながら、上記第 1 の従来例は、大腸等の体腔内を撮像した内視鏡画像からポリープ等の病変をスクリーニングする場合や診断するような場合には適用し難い。また、X 線 CT による画像では明確な半球状の隆起所見が無い場合には検出が困難である。

内視鏡画像の場合のよう光学的に体腔内を観察した画像においては、色情報も得られるため、色情報も病変検出等に利用できることが望ましい。

一方、第 2 の従来例は、色情報及び輪郭情報をを利用して、出血・発赤及び隆起・陥凹等を検出するようしている。しかし、この第 2 の従来例は、ポリープに生じる発赤・褪色調の色調変化の性状を付随的に呈する領域やポリープの周辺粘膜に生じる異常所見領域等の性状を付随的に呈する領域の情報を有効に利用していない。このため、これらの領域の情報を有効に利用して、病変をより精度良く若しくは高い信頼性で検出できることが望まれる。

また、2 次元画像から 3 次元の形状画像を生成して、より信頼度を向上した病変検出ができることが望まれる。

##### 【0006】

本発明は上述した点に鑑みてなされたもので、内視鏡画像のように色情報を有する医療用画像からポリープ等の病変を精度良く検出することができる医療用画像処理装置及び医療用画像処理方法を提供することを目的とする。

40

また、本発明は、3 次元の形状画像を利用して、より信頼度を向上した病変検出ができ

50

る医療用画像処理装置及び医療用画像処理方法を提供することを目的とする。

【発明の開示】

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明による第1の医療用画像処理装置は、複数の色信号からなる医療用画像における少なくとも1つの色信号に基づき病変候補領域を検出する病変候補領域検出手段と、前記医療用画像から病変に伴い付随した性状で発生する付随領域を検出する付随領域検出手段と、前記付随領域の検出結果に応じて前記病変候補領域から病変を検出する際の検出基準を変更する検出基準変更手段とを具備したことを特徴とする。

【0008】

また、本発明による第2の医療用画像処理装置は、複数の色信号からなる医療用画像における少なくとも1つの色信号から病変候補領域を検出する病変候補領域検出手段と、前記医療用画像から病変に伴い付随した性状で発生する付随領域を検出する付随領域検出手段と、前記病変候補領域検出手段により検出された病変候補領域と、前記付随領域検出手段により検出された付随領域とが相関する領域の有無により病変検出を行うことを特徴とする。

10

【0009】

更に、本発明による医療用画像処理方法は、複数の色信号からなる医療用画像における少なくとも1つの色信号に基づき病変候補領域を検出する病変候補領域検出ステップと、前記医療用画像から病変に伴い付随した性状で発生する付随領域の有無を検出する付随領域検出ステップと、前記付随領域の有無の検出結果に応じて前記病変候補領域から病変を検出する際の検出基準を変更する検出基準変更ステップとを具備したことを特徴とする。

20

【図面の簡単な説明】

【0010】

【図1】本発明の実施例1に係る、内視鏡システムの構成を示すブロック図である。

【図2】本発明の実施例1に係る、大腸のような管状部位内に挿入された内視鏡により撮像する様子を示す図である。

【図3A】図2の内視鏡に設けられた撮像装置により撮像された内視鏡画像例を示す図である。

【図3B】図2の内視鏡に設けられた撮像装置により撮像された内視鏡画像例を示す図である。

30

【図4】本発明の実施例1に係る、CPUによる画像処理機能を示すブロック図である。

【図5】本発明の実施例1の画像処理により隆起性病変としてのポリープを検出する処理を示すフローチャートである。

【図6】図5のステップS4の3次元形状情報算出の処理を示すフローチャートである。

【図7】図6のステップS12により算出されるShape Index SIの値による曲面形状を示す図である。

【図8】図5のステップS6の処理内容を示すフローチャートである。

【図9A】本発明の実施例2に係る、内視鏡に設けられた撮像装置により撮像された内視鏡画像例を示す図である。

40

【図9B】本発明の実施例2に係る、内視鏡に設けられた撮像装置により撮像された内視鏡画像例を示す図である。

【図10】本発明の実施例2に係る、CPUによる画像処理機能を示すブロック図である。

【図11】本発明の実施例2の画像処理により隆起性病変としてのポリープを検出する処理を示すフローチャートである。

【図12】図11のステップS51における粘膜性状情報判定の処理内容を示すフローチャートである。

【図13】図11のステップS51における異常血管増成判定の処理内容を示すフローチャートである。

50

## 【発明を実施するための最良の形態】

### 【0011】

以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。

#### (実施例1)

図1～図8は本発明の実施例1に係り、図1は内視鏡システムの構成を示すブロック図、図2は大腸のような管状部位内に挿入された内視鏡により撮像する様子を示す図、図3Aは図2の内視鏡に設けられた撮像装置により撮像された内視鏡画像例を示す図、図3Bは図2の内視鏡に設けられた撮像装置により撮像された内視鏡画像例を示す図、図4はCPUによる画像処理機能を示すブロック図、図5は画像処理により隆起性病変としてのポリープを検出する処理を示すフローチャート、図6は図5のステップS4の3次元形状情報算出の処理を示すフローチャート、図7は図6のステップS12により算出されるShape Index SIの値による曲面形状を示す図、図8は図5のステップS6の処理内容を示すフローチャートである。

10

### 【0012】

図1に示す内視鏡システム1は、内視鏡観察装置2と、この内視鏡観察装置2により得られた内視鏡画像に対して画像処理を行うパーソナルコンピュータ等により構成される内視鏡画像処理装置（以下、単に画像処理装置と略記）3と、この画像処理装置3により画像処理された画像を表示する表示モニタ4とから構成される。

### 【0013】

内視鏡観察装置2は、体腔内に挿入される内視鏡6と、この内視鏡6に照明光を供給する光源装置7と、内視鏡6の撮像手段に対する信号処理を行うカメラコントロールユニット（CCUと略記）8と、このCCU8から出力される映像信号が入力されることにより、撮像素子で撮影した内視鏡画像を表示するモニタ9とを有する。

20

### 【0014】

内視鏡6は、体腔内に挿入される挿入部11と、この挿入部11の後端に設けられた操作部12とを有する。また、挿入部11内には照明光を伝送するライトガイド13が挿通されている。

### 【0015】

このライトガイド13の後端は、光源装置7に接続される。そして、この光源装置7から供給される照明光をライトガイド13により転送し、挿入部11の先端部14に設けた照明窓に取り付けられた先端面から（伝送した照明光を）出射し、患部等の被写体を照明する。

30

### 【0016】

照明窓に隣接する観察窓に取り付けた対物レンズ15と、この対物レンズ15の結像位置に配置された固体撮像素子としての例えば電荷結合素子（CCDと略記）16とによる撮像装置17が設けてある。そして、このCCD16の撮像面に結蔵された光学像は、このCCD16により光電変換される。

40

### 【0017】

このCCD16は、信号線を介してCCU8と接続され、このCCU8からCCD駆動信号が印加されることにより、CCD16は光電変換した画像信号を出力する。この画像信号は、CCU8内の映像処理回路により信号処理され、映像信号に変換される。この映像信号はモニタ9に出力され、モニタ9の表示面には、内視鏡画像が表示される。この映像信号は、画像処理装置3にも入力される。

40

### 【0018】

この画像処理装置3は、内視鏡観察装置2から入力される内視鏡画像に対応する映像信号が入力される画像入力部21と、この画像入力部21から入力された画像データに対する画像処理を行う中央演算処理装置としてのCPU22と、このCPU22により画像処理を実行させる処理プログラム（制御プログラム）を記憶する処理プログラム記憶部23とを有する。

### 【0019】

50

また、この画像処理装置3は、画像入力部21から入力される画像データ等を記憶する画像記憶部24と、CPU22により処理された情報等を記憶する情報記憶部25と、CPU22により処理された画像データ及び情報等を記憶装置インターフェース26を介して記憶する記憶装置としてのハードディスク27と、CPU22により処理された画像データ等を表示するための表示処理を行う表示処理部28と、ユーザが画像処理のパラメータ等のデータ入力や指示操作を行うキーボード等からなる入力操作部29とを有する。

#### 【0020】

そして、この表示処理部28により生成された映像信号は、表示モニタ4に表示され、この表示モニタ4の表示面には画像処理された処理画像が表示される。なお、画像入力部21、CPU22、処理プログラム記憶部23、画像記憶部24、情報記憶部25、記憶装置インターフェース26、表示処理部28、入力操作部29は、データバス30を介して互いに接続されている。  
10

#### 【0021】

本実施例においては、図2に示すように、例えば大腸31のような管状部位（管状器官）に直視型の内視鏡6の挿入部11が挿入され、撮像装置17により撮像される。

#### 【0022】

図3A及び図3Bは、内視鏡6によって撮像された隆起性病変としてのポリープを有する2次元の内視鏡画像例を示している。

#### 【0023】

図3Aでは、発赤調部32を伴ったポリープを有する内視鏡画像を示す。なお、ポリープの頂部は、白色調の褪色部33となっている。  
20

また、図3Bは、図3Aの場合よりも広い領域で白色調の褪色部33が伴ったポリープを有する内視鏡画像を示す。

#### 【0024】

このように隆起性病変としてのポリープにおいては、発赤調や白色調（褪色調）の色調変化が付随した性状で発生する場合がしばしばある。本実施例では、このような色調変化を呈する色調変化領域を付随領域としてその有無を検出若しくは判定する。そして、このような色調変化領域の検出結果に応じて、その後に行うポリープ検出若しくは判定を行う際の検出基準を変更（或いは制御）、より具体的には検出基準の閾値を変更する。

#### 【0025】

また、本実施例においては、上記ポリープ検出を精度良く行うために、撮像された2次元の内視鏡画像から検査対象部位（例えば管腔形状の内面）の3次元形状を推定する。そして、推定された3次元形状の情報を用いて、ポリープ候補としての隆起性変化領域を検出する。  
30

#### 【0026】

そして、検出された隆起性変化領域に対応する部分（その周辺部を含む）に対して、上記色調変化を伴う付随領域の検出結果に応じて、ポリープ検出を行う検出基準の閾値を変更設定する。

#### 【0027】

具体的には、色調変化を伴う場合には、隆起性変化によりポリープ検出を行う際に適用する検出基準としては、色調変化を伴わない場合よりも、検出条件を緩和した検出基準を適用する。  
40

#### 【0028】

後述するように図5に示す方法でポリープ検出を行う例では、色調変化を伴わない場合には検出基準1、色調変化を伴う場合には、検出基準1よりも検出条件を緩和した検出基準2をそれぞれ閾値として隆起性変化によりポリープ検出（判定）を行うことになる。

#### 【0029】

このようにして、画像処理でポリープ検出を行うことにより、精度良く（或いは高い信頼性で）ポリープ検出結果を得られるようにしている。

#### 【0030】

図4は、本実施例の画像処理装置3内のCPU22による行う画像処理機能を示す。CPU22は、撮像され内視鏡画像のデータから明暗情報（或いは輝度情報）に基づいて、隆起性の病変候補領域としての隆起性変化領域を検出する病変候補領域検出手段としての隆起性変化領域検出機能22aと、内視鏡画像の複数の色信号から色調変化領域を検出する付随領域検出手段としての色調変化領域検出機能22bと、検出される隆起性変化領域に対して、隆起性病変としてのポリープ検出を行うポリープ検出機能22dと、このポリープ検出を行う際に色調変化領域が伴うか否かによって、ポリープ検出基準を変更設定する検出基準変更手段としての検出基準の設定機能22cとを有する。

#### 【0031】

また、このCPU22は、隆起性変化領域検出機能22aにより、隆起性変化領域を検出する場合、2次元の内視鏡画像の輝度情報を、その形状を推定する形状情報として用いることにより、3次元形状情報を生成する3次元形状情報生成機能22eを有する。  
10

#### 【0032】

次に本実施例による内視鏡画像からポリープ検出を行うまでの動作を説明する。

本実施例においては、図4に示した各機能をソフトウェアにより実現している。つまり、CPU22は、処理プログラム記憶部23に記憶（格納）された処理プログラムを読み出し、CPU22はこの処理プログラムに従って処理を行うことにより、図5に示すポリープ検出の画像処理を実行する。

#### 【0033】

図1に示す内視鏡観察装置2及び画像処理装置3の電源が投入されると、内視鏡6の撮像装置17で撮像され、CCU8で信号処理された内視鏡画像（の映像信号）がモニタ9で表示されると共に、画像処理装置3にも画像入力部21を経て入力される。  
20

#### 【0034】

そして、術者が、図示しないキーボード等の画像処理開始キー等を操作することにより、その指示信号がCPU22に送られ、CPU22は図5のポリープ検出を行うための画像処理を開始する。

#### 【0035】

最初のステップS1においてCPU22は、内視鏡画像Iの番号を示すパラメータiを初期値i=1に設定し、次のステップS2において例えば図1のハードディスク27或いは画像記憶部24に順次格納されるi番目のRGB信号からなる内視鏡画像Iiを取り込む。  
30

#### 【0036】

本実施例における一連の処理は動画像として連続して入力される各フレームの内視鏡画像Iiについて適用されるものとする。この場合に限定されるものでなく、例えば数フレームおきの内視鏡画像に対して図5の画像処理を行うようにしても良い。また、ハードディスク27その他にファイリングされた内視鏡画像に対して図5の画像処理を行うようにしても良い。

ステップS2の後、ステップS3においてCPU22は、内視鏡画像IiにおけるR信号成分（R画像と略記）Riを抽出し、次のステップS4においてCPU22は、R画像Riの3次元形状情報を明暗変化（輝度情報の変化）に基づき算出（生成）する。本実施例では、CPU22は、R画像Riを用いて3次元形状情報を算出するようにしているが、この他に例えば輝度信号成分の画像を用いて算出しても良い。  
40

#### 【0037】

2次元のR画像Riから3次元形状情報を算出する処理方法を図6に示す。

2次元の画像から3次元形状情報を算出するためには、図6のステップS21に示すようにCPU22は3次元形状を推定（生成）する。

#### 【0038】

3次元形状を生成する方法としては、例えばShape from Shadingがある。このShape from Shadingによる3次元形状の生成方法は、照明光源からの照明光で照明された対象部位の反射光の強度が、その面の傾き状態で変化し、  
50

その変化が伴った反射光で撮像された内視鏡画に反映されることを利用したものであり、例えば、「コンピュータビジョン、投影中心に点光源がある場合の Shape-from-Shading—内視鏡形状からの3次元形状復元— 岡谷、出口：p.p. 19-26, 1996」にこの方法が記載されている。また、他の2次元の内視鏡画像から推定された3次元形状を算出（生成）する方法を利用しても良い。

#### 【0039】

そして、次のステップS22においてCPU22は、算出された3次元形状の各曲面において、曲面形状を表す特微量であるShape Index SI及びCurvedness CVを算出する。Shape Index SI及びCurvedness CVは、以下のようにして算出される。

#### 【0040】

CPU22は、算出された3次元形状に対して、注目する3次元位置（x、y、z）を含む局所領域（曲面）におけるそのR画素値fにおける1階偏微分係数fx、fy、fz及び2階偏微分係数fxx, fyy, fz, fxy, fyz, fxzを算出する。

#### 【0041】

これらの係数を用いて、CPU22は、「電子情報通信学会、信学技報（MI2003-102）, 形状情報に基づく3次元腹部CT像からの大腸ポリープ自動検出手法に関する検討 木村、林、北坂、森、末長 p.p. 29-34, 2004」中に記載されているようにガウス曲率K, 平均曲率Hを算出する。

一方、曲面の主曲率k1, k2 (k1 ≥ k2) は、ガウス曲率Kと、平均曲率Hを用いて、

$$k_1 = H + (H^2 - K)^{1/2} \quad k_2 = H - (H^2 - K)^{1/2} \quad (1)$$

と表される。

#### 【0042】

また、この場合における曲面形状を表す特微量であるShape Index SI及びCurvedness CVは、それぞれ、

$$SI = 1/2 - (1/\pi) \operatorname{arc \tan} [(k_1 + k_2) / (k_1 - k_2)] \quad (2)$$

$$CV = ((k_1^2 + k_2^2) / 2)^{1/2} \quad (3)$$

となる。

#### 【0043】

CPU22は、このようにして、3次元の各曲面におけるShape Index SI及びCurvedness CVを3次元形状情報として算出する。

#### 【0044】

Shape Index SIは、図7に示すように曲面形状を0から1までの値を持つ指標で表す。この場合、Shape Index SIが0の場合には、曲面形状は凹型となり、1の場合は凸型となる。つまり、このShape Index SIの値が1に近い値程、凸型の隆起形状の特徴を有する。

#### 【0045】

従って、Shape Index SIの値を1に近い閾値として検出基準を設定し、この閾値よりも大きなShapeIndex SIの値を持つ領域を検出することにより、隆起性病変としてのポリープを画像処理上で客観的に検出することが可能になる。なお、後述する図5のステップS10に用いる検出基準1では、Shape Index SIの閾値として (SI =) 0.9に、ステップS11における検出基準2ではShape Index SIの閾値として (SI =) 0.8に設定して行う。

#### 【0046】

また、Curvedness CVは、曲率半径の逆数を表し、対象曲面の凸型の領域の大きさを限定する場合に利用される。このようにして、図5におけるステップS4の処理が行われる。

#### 【0047】

そして、本実施例においては、以下に説明するように隆起性病変としてのポリープ検出の画像処理を行う場合、CPU22は、検出基準1と検出基準2とを用いて行う。

10

20

40

50

## 【0048】

一方、図5のステップS5においてCPU22は、内視鏡画像IiにおけるR画像Riと、内視鏡画像IiにおけるG信号成分（G画像Giと略記）を抽出する。そして、次のステップS6においてCPU22は、発赤・褪色調の色調変化を示す色調変化領域の検出を行う。

## 【0049】

ステップS6における色調変化領域の検出処理は、例えば図8に示すように行う。最初のステップS31においてCPU22、R画像Ri及びG画像Giに対して暗部・ハレーションあるいは残渣等の不適画素を除外する処理を行う。暗部・ハレーションの除去は、暗部及びハレーションに対応して設定した閾値を用いて簡単に除去することができる。また、残渣は、残渣の色調及びその部分の形状判定等とを組み合わせて除去することができる。10

## 【0050】

次のステップS32においてCPU22は、例えば $8 \times 8$ の小領域に分割する処理を行う。

そして、次のステップS33においてCPU22は、分割された小領域の番号を表すパラメータmと、小領域内の画素の番号を表すパラメータjとを初期値1に設定する。なお、小領域の番号付けを行う場合、ステップS31の処理により、除外された画素が、その小領域内である割合、例えば50%を超えた場合には、その小領域は処理対象から除外する（mの番号に割り付けない）。つまり、小領域に対しても、不適当な小領域は、処理対象20から除外する。

## 【0051】

次のステップS34においてCPU22は、j番目の画素の色度 $g_j / r_j$ 算出する。ここで、 $g_j$ は、G画像Giの（m番目の）小領域内のj番目の画素の輝度レベル、 $r_j$ はR画像Riの（m番目の）小領域内のj番目の画素の輝度レベルを表す。そして、次のステップS35においてCPU22は、jが小領域内の最後の画素番号jendか否かの判定を行う。これに該当しない場合には、ステップS36においてCPU22はjを1つ増大させた後、ステップS34に戻り、同様の処理を繰り返す。

## 【0052】

このようにして、m番目の小領域内の最後の画素番号jendまで色度 $g_j / r_j$ を算出したら、ステップS37に進む。30

## 【0053】

このステップS37において、CPU22は、そのm番目の小領域の色度平均値 $\mu_{grm}$ を算出する。そして、次のステップS38において、CPU22は、小領域の番号mが、最後の番号jendか否かの判定を行う。これに該当しない場合には、ステップS39において、CPU22は、mを1つ増大させた後、ステップS34に戻り、ステップS34～S39の処理を繰り返す。

## 【0054】

このようにして、mが最後の番号jendに一致した場合には、ステップS40に進み、このステップS40において、CPU22は、全ての小領域の色度平均値 $\mu_{gr}$ 及び標準偏差 $\sigma_{gr}$ の算出を行う。40

## 【0055】

そして、次のステップS41においてCPU22は、ステップS37において算出されたm番目の小領域の色度平均値 $\mu_{grm}$ が、全ての小領域の場合の色度平均値 $\mu_{gr}$ 及び標準偏差 $\sigma_{gr}$ を用いて、発赤及び褪色調の色調変化の小領域か否かの判定を行う。

## 【0056】

具体的には、ステップS41に示すようにCPU22は、小領域の色度平均値 $\mu_{grm}$ が、正規分布すると見なし、その色度平均値 $\mu_{grm}$ が全ての小領域の色度平均値 $\mu_{gr}$ の分布位置から $\pm (1.5 \times \sigma_{gr})$ の範囲内にあるか否かの判定を行う。

ステップS41の判定条件を満たす場合には、ステップS42に示すようにCPU2250

は、その小領域は発赤及び褪色調の色調変化の小領域でないと検出（判定）する。

【0057】

一方、ステップS41の条件から逸脱する場合には、ステップS43に示すようにCPU22は、発赤又は褪色調の色調変化の小領域として検出する。

【0058】

より具体的には、色度平均値 $\mu_{grm}$ が色度平均値 $\mu_{gr}$ の分布位置から $-1.5 \times \sigma_{gr}$ より外側に外れた場合に対しては発赤、また色度平均値 $\mu_{grm}$ が色度平均値 $\mu_{gr}$ の分布位置から $+1.5 \times \sigma_{gr}$ より外側に外れた場合に対しては褪色調の色調変化の小領域として検出（判定）する。

【0059】

10

検出（判定）の結果は、小領域の番号m或いは小領域の2次元位置の情報とともに情報記憶部25（図1参照）等に記憶される。そして、以下に説明する図5のステップS9の判定において、その検出結果の情報が利用される。

【0060】

なお、図8におけるステップS41からS43までの処理は、小領域の番号mを変えて、1からmendまで行う。このようにして処理対象の全ての小領域に対してステップS42若しくはS43の処理を行った後、図5のステップS7又はステップS8の処理に進む。

【0061】

なお、上述の説明では、色度 $g_j/r_j$ を用いた例で説明したが、色度として $b_j/g_j$ を加えてもよい。この場合には、黄色調粘膜の検出に対応することができる。

【0062】

また、図8の処理において、色度平均値 $\mu_{grm}$ と $\mu_{gr}$ の比 $\mu_{rate} = \mu_{grm}/\mu_{gr}$ に基づき、例えば $\mu_{rate} < 0.5$ なら発赤調、 $\mu_{rate} > 1.5$ なら褪色調として検出するようにもよい。

【0063】

続いて、図5のステップS7においてCPU22は、ステップS4で算出された3次元形状情報に基づき、隆起性変化領域の検出の処理を行う。例えば、上述したShape Index SIの値が0.8以上の小領域の部分を検出する。

【0064】

30

さらに、ステップS8において、CPU22は、ステップS4による3次元形状情報及びステップS6による色調変化領域検出の情報の対応付けを行うことにより、ステップS6で検出された色調変化領域に含まれる各画素或いはその小領域が3次元形状上のどの位置に相当するかを特定する。

【0065】

次のステップS9においてCPU22は、ステップS7及びS8による各結果に基づく判定処理を行う。具体的にはCPU22は、ステップS7において検出した3次元形状上の隆起性変化領域が、ステップS8において特定された色調変化領域に該当するか否かを判定する。

【0066】

40

そして、ステップS9における判定結果がNO、すなわち色調変化を伴わない隆起性変化であれば、ステップS10においてCPU22は、検出基準1によるポリープ検出処理を適用する。

【0067】

一方、ステップS9における判定結果がYES、すなわち色調変化を伴う隆起性変化であれば、ステップS11においてCPU22は、検出基準2によるポリープ検出処理を適用する。

【0068】

50

このように本実施例では、ステップS10及びS11に示すようにステップS9による判定結果に応じて、ポリープ検出を行う検出基準或いは評価基準を変更して行う。この場

合、色調変化が検出された場合には、その領域及びその領域周辺部はポリープの可能性が高いので、隆起性変化の特徴を有する部分を、色調変化が検出されない場合よりも検出条件を緩和して検出することにより、精度良くポリープ或いはポリープ候補を検出する。

【0069】

また、ポリープ検出処理は種々のものが適用可能であるが、本実施例においては上述したShape Index S Iによる検出基準を採用する。

隆起性病変としてのポリープを示す凸型（或いはカップ）形状を検出するためのShape Index S Iの閾値として検出基準1を（S I =）0.9に、検出基準2は（S I =）0.8に設定する（なお、上述のように1に近いほど凸型形状となる）。そして、ステップS 10或いはS 11においてCPU 22は、検出基準の0.9或いは0.8のShape Index S Iと比較し、その値よりも大きい場合に小領域がポリープと検出（判定）する。10

【0070】

この場合、例えばCurvedness C Vは、検出基準1及び2のいずれにおいても（C V =）0.2を閾値として、この値より大きい場合にポリープとして検出（判定）する。

【0071】

なお、上記説明では色調変化を伴う場合と、伴わない場合とで検出基準として、Shape Index S Iの値を変更しているが、以下のようにCurvedness C Vの値を変えて検出基準を変更するようにしても良い。

つまり、検出基準1としてShape Index S Iの閾値を0.9及びCurvedness C Vの閾値を0.20とし、検出基準2としてShape Index S Iの閾値を0.9及びCurvedness C Vの閾値を0.15にするようにしても良い。20

【0072】

また、検出基準1に対して検出基準2の場合には、Shape Index S Iの閾値とCurvedness C Vの閾値を下げるよう変更しても良い。

【0073】

例えば、検出基準1としてShape Index S Iの閾値を0.9及びCurvedness C Vの閾値を0.20とし、検出基準2としてShape Index S Iの閾値を0.85及びCurvedness C Vの閾値を0.15にするようにしても良い。

【0074】

このようにしてステップS 10或いはステップS 11においてCPU 22は、検出基準1或いは2を閾値に設定して、隆起性変化領域におけるShape Index S Iの値によりポリープ検出の処理を行う。30

【0075】

そして、その検出結果を、例えば図1のハードディスク27に検出対象の内視鏡画像I iと関連付けて格納すると共に、表示処理部28を経て表示モニタ4に、例えば検出対象の内視鏡画像I iと並べて表示する。

【0076】

そして、図5のステップS 12においてCPU 22はiを1つ大きくして次の内視鏡画像I iに対して同様の処理を行う。

【0077】

このような画像処理を行う本実施例によれば、ポリープの場合に付随的に発生する色調変化の特徴量に対応した色調変化情報を参照することで検出基準の値若しくは条件値を変更（制御）することが可能となり、検出対象がポリープか否かの検出精度（若しくは検出の信頼性）を向上することができる。つまり、一方のみの検出でポリープ検出を行う場合の画像処理の場合に比較して、両方の検出を組み合わせることによって、より精度の高いポリープ検出を可能とする。40

【0078】

なお、上述の説明では、曲面形状を表す特徴量であるShape Index S I及びCurvedness C Vの閾値を用いてステップS 10或いはステップS 11でポリープ検出処理を行う場合を説明したが、隆起性変化領域における基準面からの高さの情報に基づいて検出を行うよ50

うにしても良い。

【0079】

この場合には、検出基準1の場合の高さの閾値を、H1とした場合には、検出基準とす  
てH1より小さい閾値H2に変更すれば良い。以上により、色調変化を伴う場合は、ポリ  
ープ検出における検出条件を緩和するように変更(制御)することにより、高精度のポリ  
ープ検出が可能となる。

【0080】

なお、本実施例においては病変検出の手段或いは方法として隆起性病変としてのポリ  
ープの場合で説明したが、本実施例はこれに限定されるものでなく、陥凹性病変に対しても  
適用可能であることは明らかである。

10

【0081】

この場合には、例えば図5において、ステップS7において、隆起性変化領域検出の処  
理の代わりに陥凹性変化領域を検出するように変更し、またステップS9も同様に変更す  
れば良い。

また、ステップS10及びステップS11における検出基準も、陥凹性病変の特徴量に  
近い値に変更する。このようにすれば、陥凹性病変に対しても適用可能である。

【0082】

(実施例2)

次に、図9～図13を参照して本発明の実施例2を説明する。

本実施例においても、明暗変化に基づき算出される3次元情報(形状情報)から隆起性  
変化領域の検出を適用し、隆起性病変としてのポリープ検出を行う。

20

【0083】

ポリープは、周辺粘膜において異常所見をともなう場合がある。逆にいうと、粘膜に異  
常所見が見られる場合にはポリープが発生している可能性も高まっている。粘膜の異常所  
見としては、例えば図9Aに示す白斑や、図9Bに示す異常血管の増成があげられる。

【0084】

本実施例では、この異常所見に着目し、粘膜表面に異常所見を呈する場合には、形状情  
報によるポリープ検出の検出基準(パラメータや閾値等)を変更することにより、ポリ  
ープ検出の精度の向上を図ることを可能とする。

【0085】

30

具体的には、周辺粘膜に異常所見を伴う隆起性変化領域に対しては、異常所見を伴わ  
ない場合よりも、検出条件を緩和した検出基準を適用する。

【0086】

本実施例における画像処理装置3の構成は図1と同様であり、処理内容が異なる。本実  
施例では画像処理装置3におけるCPU22は、図10に示す処理機能を有する。つまり、  
実施例1における図4で示した色調変化領域検出機能22bの代わりに、異常所見領域  
の検出機能22fを有する。なお、この異常所見領域は、以下に説明するように粘膜性状  
所見判定の処理で検出(判定)される。

【0087】

次に図11を参照して、本実施例における画像処理によりポリープ検出の動作を説明す  
る。図11に示すフローチャートの処理におけるステップS1からステップS5までは、  
図5のフローチャートの処理におけるステップS1からステップS5と同様であるため、  
その説明を省略する。

40

【0088】

ステップS5においてCPU22は、内視鏡画像IiにおけるR画像Riと、内視鏡画  
像IiにおけるG画像Giを抽出し、次のステップS51においてCPU22は、(異常  
所見領域を検出する)粘膜性状所見判定の処理を行う。

【0089】

この粘膜性状所見判定の処理において、CPU22は、内視鏡画像Iiにおいて特徴的  
な粘膜性状所見を呈する領域が異常所見を呈する領域か否かの判定を行う。本実施例では

50

R画像R<sub>i</sub>及びG画像G<sub>i</sub>を使用するものとして、上記のようにステップS51において、後述する一連の処理の適用により、白斑、異常血管増成等の異常所見領域の検出を行う。

【0090】

続いて、図5のステップS7と同様に、ステップS4で算出された3次元形状の情報に基づく隆起変化領域の検出を行う。

【0091】

続いて、ステップS52においてCPU22は、ステップS51及びS7による各検出結果に基づく判定処理を行う。このステップS52の判定処理により、異常所見がなければステップS10へ、異常所見があればステップS11に進む。

10

【0092】

実施例1の場合と同様に、ステップS10においてCPU22は、検出基準1によるポリープ検出処理を適用する。また、ステップS11においてCPU22は、検出基準2によるポリープ検出処理を適用する。そして、ステップS10及びS11の処理の後、ステップS12を経てステップS2に戻る。

【0093】

ポリープ検出処理は、種々のものが適用可能であり、例えば実施例1の場合と同様にShape Index SIによる検出やCurvedness CVの閾値を用いる等して行う。

【0094】

本実施例における図11におけるステップS51の粘膜性状所見判定の処理を図12及び図13のフローチャートを参照して説明する。

20

【0095】

粘膜性状所見判定の処理として、本実施例では図12に示す白斑の異常所見の検出処理と、図13に示す異常血管増成の異常所見の検出処理とを行う。まず、図12の白斑の異常所見の検出処理を説明する。

【0096】

最初のステップS61においてCPU22は、暗部・ハレーション及び残渣等の不適画素除外の処理を行う。次のステップS62においてCPU22は、各画素の色度g<sub>j/r</sub><sub>j</sub>の算出を行う。ここで、添え字jは、画素番号を表す。

30

【0097】

次のステップS63において、CPU22は、閾値処理による2値化処理を行う。この場合、例えば(色度の)閾値V<sub>th</sub>を0.8に設定し、この閾値V<sub>th</sub>を用いてg<sub>j/r</sub><sub>j</sub> > 0.8ならば1、それ以外、つまりg<sub>j/r</sub><sub>j</sub> ≤ 0.8ならば0とする2値化を行い、2値化された2値化画像を生成する。

【0098】

続くステップS64において、CPU22は、2値化画像に対して2値化の値が1の画素を追跡して、領域のラベル付けを行うラベリング処理を行い、2値化画像からラベリング画像を生成する。

【0099】

次のステップS65において、CPU22は、ラベリング処理で生成されたラベリング画像に対して、白斑の小塊検出処理を行う。つまり、ラベリング画像中に白斑による小塊に対応するものが発生しているか否かの白斑の小塊検出を行う。

40

【0100】

白斑の小塊検出を行う場合、例えば伸長度(=面積/細線化長)を用いる。そしてラベリング画像に対して伸長度の値Eを検出し、その値Eが(判定基準の)閾値V<sub>th</sub>(例えばV<sub>th</sub>=10)より小さいか否かを比較する。そして、E < V<sub>th</sub>(=10)となる小塊数Nを算出する。

【0101】

なお、伸長度でなく、円形度やモーメント特徴量等を検出基準として小塊数Nを算出するようにしても良い。

50

次のステップS66において、CPU22は、ステップS65で検出された小塊数Nが白斑検出の検出基準の閾値Nth（例えばHth=20）より大きいか否かの判定を行う。そして、この条件N>Nthを満たす場合には、ステップS67に示すようにCPU22は、このラベリング画像（G画像Gi及びR画像Ri）で、白斑検出と判定し、逆にこの条件を満たさない場合には、ステップS68において白斑検出無しと判定する。

#### 【0102】

ステップS67、S68の検出結果は、ステップS52の判定に利用される。つまり、白斑検出の有無により異常所見の有無として利用される。

#### 【0103】

また、ステップS51の粘膜性状所見判定の処理として、次に説明する図13の異常血管増成による異常所見の検出処理を行う。異常血管増成を検出するために、内視鏡画像Iiから局所的な太い血管と細かい複雑な分岐を検出する処理を行う。<sup>10</sup>

#### 【0104】

最初のステップS71からステップS74までは、図12とほぼ同様の処理を行う。つまり、ステップS71においてCPU22は、暗部・ハレーション及び残渣等の不適画素の除外の処理を行い、次のステップS72において、各画素の色度gj/rjの算出を行う。また、次のステップS73においてCPU22は、閾値処理による2値化処理を行う。この場合には、図12の場合とは異なる閾値Vthを用いて2値化を行う。

#### 【0105】

CPU22は、例えば、閾値Vthを0.2に設定し、この閾値Vthを用いてgj/rj<0.2ならば1、それ以外、つまりgj/rj≥0.2ならば0とする2値化を行い、2値化された2値化画像を生成する。<sup>20</sup>

#### 【0106】

そして、次のステップS74でラベリングの処理を行い、この場合には、ラベリング画像として細線画像を作成する。

#### 【0107】

そして次のステップS75において、CPU22は、異常血管増成に対応した特微量検出の処理を行う。この特微量検出の処理としては、細線画像に対して、分岐・交差点数を検出する。そして、次のステップS76においてCPU22は、分岐・交差点数の閾値若しくは判別関数を用いて異常血管増成の検出の有無を行う。<sup>30</sup>

#### 【0108】

なお、特微量検出の処理として、分岐・交差点数を用いて行う代わりに、伸長度等を用い、閾値を超える伸長度の数を検出し、その数が異常血管増成検出の閾値を超えるか否かにより異常血管増成の検出（判別）を行うようにしても良い。

#### 【0109】

図13の処理による検出結果は、ステップS52の判定に利用される。ステップS52においてCPU22は、ステップS7により検出された隆起性変化領域が、その粘膜性状所見として図12による白斑の検出を伴うものか若しくは図13による異常血管増成の検出を伴うものに該当するか否かの判定を行う。

#### 【0110】

そして、このステップS52による判定処理の結果以後は、図5に示した実施例1の場合の処理と同様に行う。<sup>40</sup>

#### 【0111】

つまり、ステップS52の判定処理により、異常所見を伴うものでない場合には、ステップS10においてCPU22は、検出基準1を適用してポリープ検出を行い、異常所見を伴う場合には、ステップS11においてCPU22は、検出基準2を適用してポリープ検出を行う。そして、ステップS10、S11の処理の後、画像のパラメータiを1つ大きくして、次の内視鏡画像Iiに対して同様の処理を行う。

#### 【0112】

検出基準1及び検出基準2は、上述したようにShape Index SIによる検出やCurvedness<sup>50</sup>

sCVの閾値を用いる等して行う。

【0113】

なお、上述の説明において、G画像G<sub>i</sub>に対して、白斑或いは異常血管増成を検出するための検出フィルタを適用してそれらを検出するようにしてもよい。

【0114】

また、白斑或いは異常血管増成等の異常所見領域が複数フレームにわたって検出された場合には、他のフレームに対しても検出基準2を適用してポリープ検出を行うように検出基準を変更(制御)することも可能である。

【0115】

このように本実施例によれば、粘膜性状所見の判定処理により、異常所見が検出された場合と検出されない場合とに応じて、隆起性変化領域に対する検出基準を変更して隆起性病変検出としてのポリープの検出を行うことにより、精度の高いポリープの検出を行うことができる。

10

【0116】

なお、図11における画像処理の順序を変更しても良い。例えばステップS51の前にステップS7の処理を行うようにしても良い。また、計算量を低減するために、ステップS7による3次元の隆起性を有しない非隆起性変化部の検出領域に対応する領域に対してステップS51による粘膜性状所見の判定処理を行うようにしても良い。つまり、本実施例における異常所見の領域は隆起性病変としてのポリープの周辺部において付随的に発生するため、隆起性病変変化領域の周辺の平坦部、周辺粘膜に対してこれらの異常所見を検出)するようにしてもよい。

20

【0117】

また、検出基準1、2としては、上述したようにShape Index S<sub>I</sub>による検出やCurvednessCVの閾値を用いる場合に限定されるものでなく、実施例1において説明したように基準面からの高さの値等に基づいて隆起性病変を検出するようにしても良い。この場合にも、粘膜表面において白斑や異常血管増成をともなう場合はポリープ検出における感度をより高めるよう制御することとなり、高精度のポリープ検出が可能となる。

30

【0118】

なお、本実施例における病変検出手段及び方法は、隆起性病変の場合に限らず、実施例1において説明したように陥凹性病変に対しても同様に適用可能である。

【0119】

なお、上述した実施例1及び実施例2において、画像処理により病変を検出する場合、色調変化或いは異常所見の領域(つまり付随領域)を検出した場合の検出結果に応じて、輝度情報に基づいて隆起性病変領域等の病変候補を検出する際の検出基準を変更する場合で説明したが、両方の検出結果から総合的に病変を検出するようにしても良い。

40

【0120】

また、これらの実施例における他の検出方法或いは検出手段として、両方が相関性を持つ領域が存在するか否かにより、病変候補が病変であるか否かを検出するようにしても良い。例えば、病変である可能性が十分に高いと考えられる領域のみを検出したような要望に対応するためには、両方で病変候補として検出されるような相関性がある場合に病変候補として検出すると、病変部分の検出の精度を高くすることができる。

【0121】

なお、実施例1及び実施例2においては、病変検出手法として3次元形状推定に基づく手法について説明したが、本発明はこれに限定されるものでない。例えば、2次元のR画像に対する帯域通過フィルタリングによりエッジを抽出の上、閾値処理による2値化を行い、公知のハフ変換により、ポリープ様病変が呈する円弧形状を示すエッジを検出する手法を適用することが考えられる。

【0122】

このような場合においても、病変候補として検出するエッジの長さ、面積、或いは円弧の曲率等を検出基準とし、病変部若しくは周辺部の異常所見に基づき検出基準を変更する

50

ことも可能である。

【0123】

また、上述した実施例においては、病変検出手法としてShape Index S I 及びCurvedness S C Vに対する閾値処理に基づく手法について説明したが、本発明はこれに限定されるものでない。例えば、閾値処理でなく、凸型、C U P型等の各形状所見を有する画像群を教師データとして用意し、算出した各特徴量を用いた識別器による検出手法にも利用することが可能である。例えば、公知の線形判別関数を用いた識別器を使用する場合、異常所見が存在する場合においては、各形状における線形判別関数の適用により得られる値に対する重み付けを制御することにより、凸型形状等を検出し易くする等の制御が可能となる。

10

【0124】

なお、上述した実施例等を部分的に組み合わせたり、画像処理する順序を変更したりする变形例等も本発明に属する。

【0125】

以上説明したように本発明によれば、内視鏡画像等の色情報を有する医療用画像における輝度情報からポリープ等の病変候補領域を検出すると共に、病変に伴い付随した性状で発生する発赤・褪色調部分等の色調変化等を伴う付随領域を検出し、付随領域の検出結果に応じて病変候補領域から病変を検出する検出基準を変更することにより、精度の高い病変検出を行うことができるという産業上の利用可能性を有する。

【0126】

また、本発明は、以下に記載する付記に述べる特徴を有するものである。

20

(付記1)

複数の色信号からなる医療用画像における少なくとも1つの色信号に基づき病変候補領域を検出する病変候補領域検出手段と、前記医療用画像から病変に伴い付随した性状で発生する付随領域を検出する付随領域検出手段と、前記付随領域の検出結果に応じて前記病変候補領域から病変を検出する際の検出基準を変更する検出基準変更手段とを具備したことを特徴とする医療用画像処理装置。

【0127】

(付記2)

前記病変候補領域検出手段は、前記医療用画像から前記少なくとも1つの色信号に基づき、3次元形状の情報を生成する3次元形状の情報生成手段を有し、生成された3次元形状の情報を利用して病変候補領域を検出することを特徴とする付記1に記載の医療用画像処理装置。

30

【0128】

(付記3)

前記付随領域検出手段は、前記付随領域として、発赤若しくは褪色等の色調変化の性状を呈する色調変化領域を検出することを特徴とする付記1に記載の医療用画像処理装置。

【0129】

(付記4)

前記付随領域検出手段は、前記付随領域として、白斑若しくは異常血管の異常所見の性状を呈する異常所見領域を検出することを特徴とする付記1に記載の医療用画像処理装置。

40

。

【0130】

(付記5)

前記検出基準変更手段は、前記検出基準として、生成された前記3次元形状の情報における曲面形状を表す特徴量のShape Index及びCurvednessの少なくとも一方の閾値を変更することを特徴とする付記3に記載の医療用画像処理装置。

【0131】

(付記6)

複数の色信号からなる医療用画像における少なくとも1つの色信号から病変候補領域を検出する病変候補領域検出手段と、前記医療用画像から病変に伴い付随した性状で発生す

50

る付随領域を検出する付随領域検出手段と、前記病変候補領域検出手段により検出された病変候補領域と、前記付随領域検出手段により検出された付随領域とが相関する領域の有無により病変検出を行うことを特徴とする医療用画像処理装置。

【0132】

(付記7)

複数の色信号からなる医療用画像における少なくとも1つの色信号に基づき病変候補領域を検出する病変候補領域検出手段と、前記医療用画像から病変に伴い付随した性状で発生する付随領域の有無を検出する付随領域検出手段と、前記付随領域の有無の検出結果に応じて前記病変候補領域から病変を検出する際の検出基準を変更する検出基準変更ステップとを具備したことを特徴とする医療用画像処理方法。 10

【0133】

(付記8)

前記病変候補領域検出手段は、前記医療用画像から前記少なくとも1つの色信号に基づき、3次元形状の情報を生成する3次元形状の情報生成ステップを有し、生成された3次元形状の情報をを利用して病変候補領域を検出することを特徴とする付記7に記載の医療用画像処理方法。

【0134】

(付記9)

前記付随領域検出手段は、前記付随領域として、発赤若しくは褪色の色調変化の性状を呈する色調変化領域を検出することを特徴とする付記7に記載の医療用画像処理方法 20。

【0135】

(付記10)

前記付随領域検出手段は、前記付随領域として、白斑若しくは異常血管の性状を呈する異常所見領域を検出することを特徴とする付記7に記載の医療用画像処理方法。

【0136】

(付記11)


前記検出基準変更ステップは、前記検出基準として、生成された前記3次元形状の情報における曲面形状を表す特微量のShape Index及びCurvednessの少なくとも一方の閾値を変更することを特徴とする付記8に記載の医療用画像処理方法。 30

【0137】


(付記12)

前記検出基準として、生成された前記3次元形状の情報における曲面形状を表す特微量のShape Index及びCurvednessの少なくとも一方若しくは基準面からの高さの閾値を変更することを特徴とする付記3に記載の医療用画像処理装置。


【図 1】

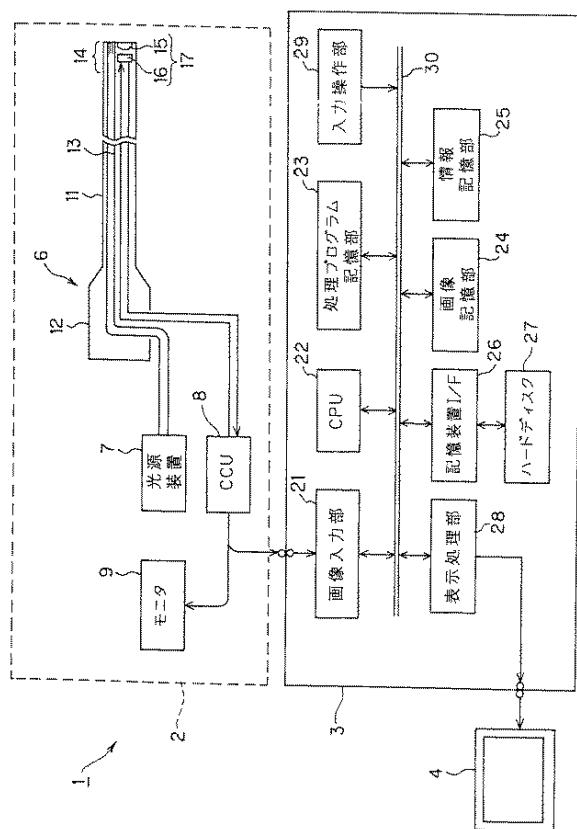


【図 2】

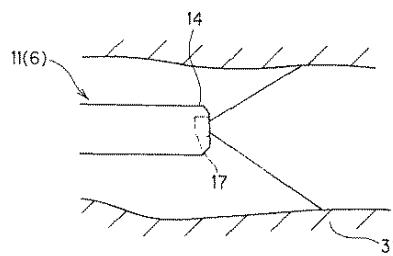


【図 3 A】

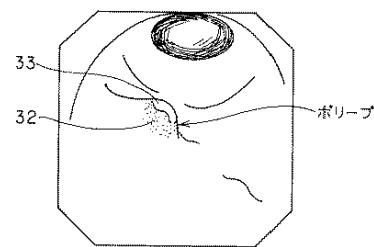


【図 3 B】

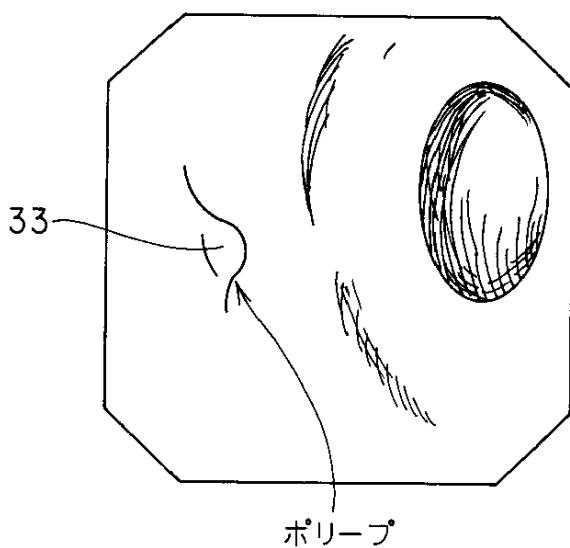


【図 4】

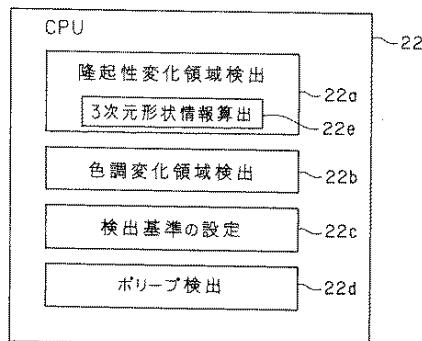


【図5】

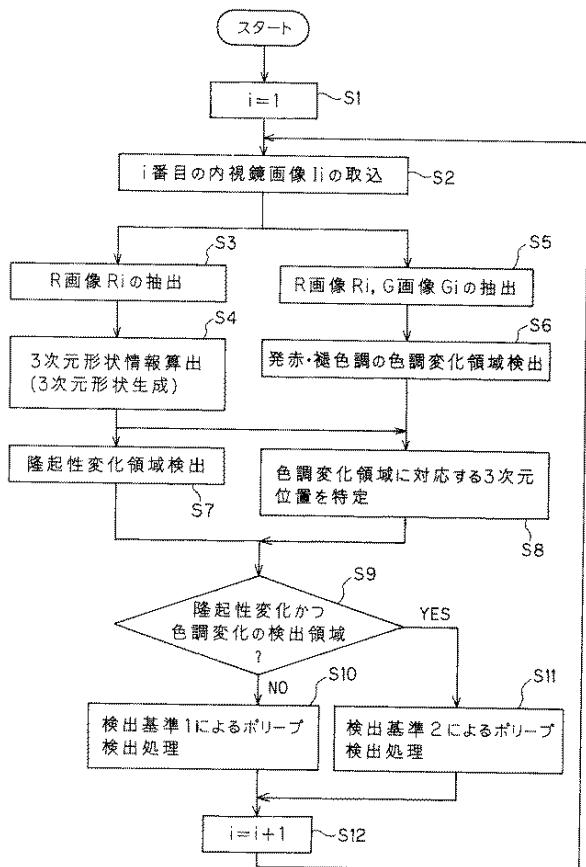


【図6】

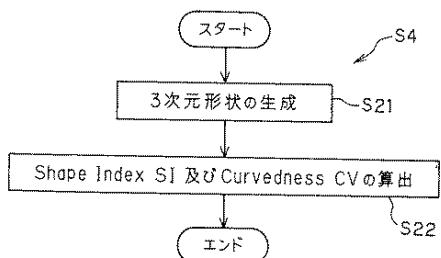


【図7】

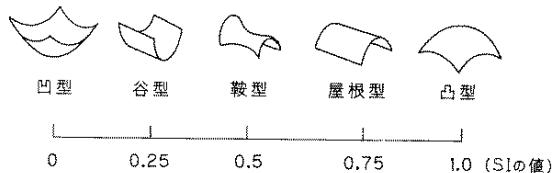


【図8】

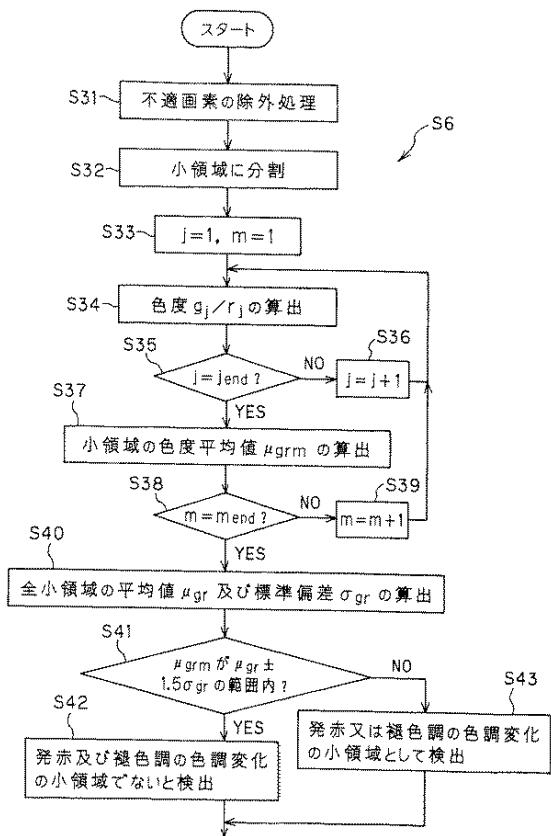


【図9 A】

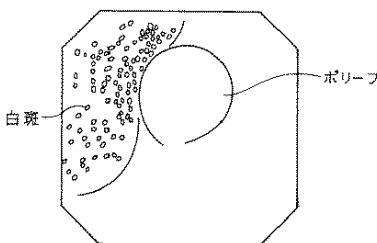


【図9 B】

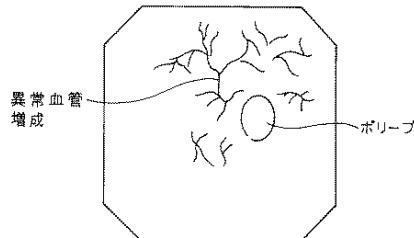


【図10】

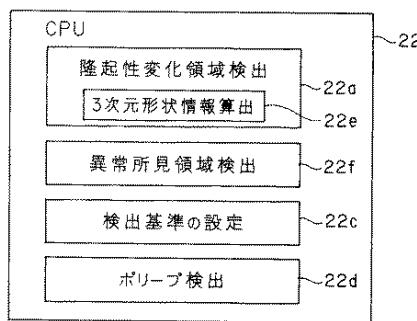


【図11】

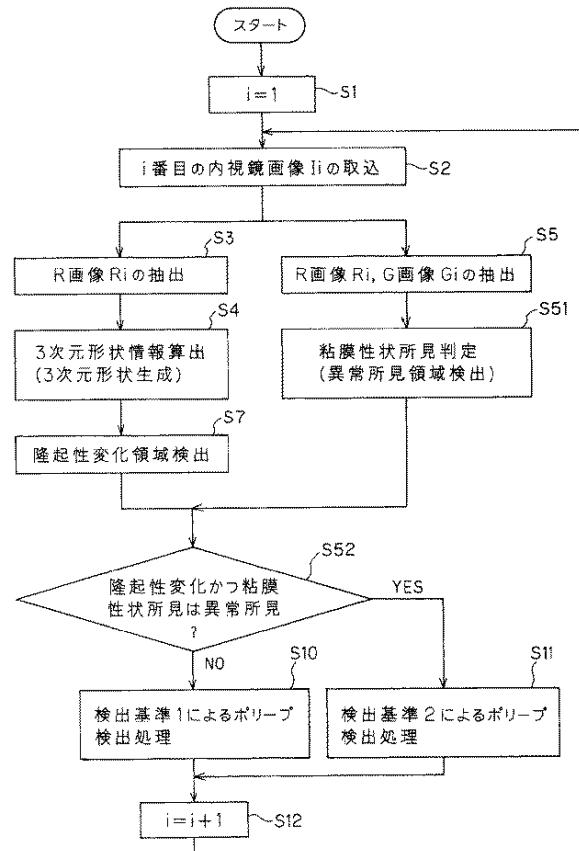

【図12】

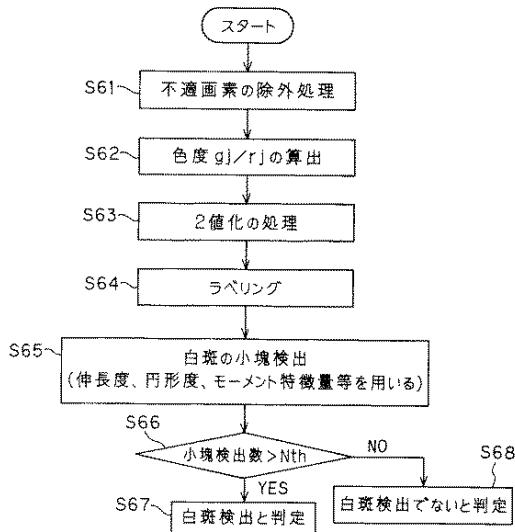

【図13】

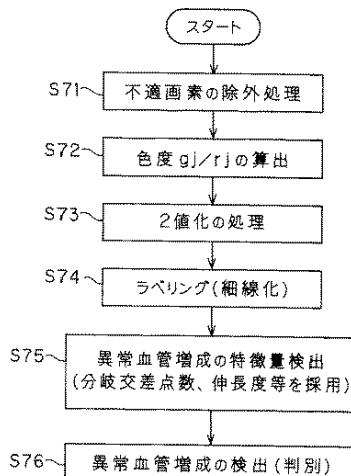

专利名称(译)	医学图像处理设备和医学图像处理方法		
公开(公告)号	<a href="#">JPWO2007119297A1</a>	公开(公告)日	2009-08-27
申请号	JP2008510749	申请日	2007-02-27
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯医疗株式会社		
申请(专利权)人(译)	オリンパスメディカルシステムズ株式会社		
[标]发明人	西村博一 田中秀樹 中村健次 井上涼子 沢美穂		
发明人	西村 博一 田中 秀樹 中村 健次 井上 涼子 沢 美穂		
IPC分类号	A61B1/04 G06T1/00		
CPC分类号	A61B1/04 G06T7/0012 G06T2207/10068 G06T2207/30032		
FI分类号	A61B1/04.370 G06T1/00.290.Z		
F-TERM分类号	4C061/AA04 4C061/BB02 4C061/CC06 4C061/DD00 4C061/GG01 4C061/LL02 4C061/SS22 4C061/SS23 4C061/WW02 4C061/YY03 4C061/YY12 5B057/AA07 5B057/CA01 5B057/CA08 5B057/CA12 5B057/CA16 5B057/CB13 5B057/CB16 5B057/CE16 5B057/CF04 5B057/DA08 5B057/DA17 5B057/DB02 5B057/DB06 5B057/DB09 5B057/DC25		
代理人(译)	伊藤 进		
优先权	2006073184 2006-03-16 JP		
其他公开文献	<a href="#">JP5242381B2</a>		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

## 摘要(译)

图像处理装置3使用内窥镜6的亮度信息，从内窥镜6拍摄的内窥镜图像的R成分图像算出三维形状的曲面的三维形状和特征量信息。此外，图像处理装置3从R和G图像分量两者中检测出红色/褪色色调改变区域，并且根据检测结果，将三维形状的曲面中的升高的改变区域视为升高的病变。改变用作用于检测息肉的阈值的检测基准的值，以执行高精度的息肉检测。

