

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号  
特許第4994737号  
(P4994737)

(45) 発行日 平成24年8月8日(2012.8.8)

(24) 登録日 平成24年5月18日(2012.5.18)

(51) Int.Cl.

F I

A 6 1 B 1/04 (2006.01)

A 6 1 B 6/03 (2006.01)

G 0 6 T 1/00 (2006.01)

A 6 1 B 1/04 3 7 2

A 6 1 B 6/03 3 6 0 G

G 0 6 T 1/00 2 9 0 Z

G 0 6 T 1/00 3 1 5

請求項の数 4 (全 19 頁)

|           |                              |           |                     |
|-----------|------------------------------|-----------|---------------------|
| (21) 出願番号 | 特願2006-205142 (P2006-205142) | (73) 特許権者 | 304050923           |
| (22) 出願日  | 平成18年7月27日 (2006.7.27)       |           | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 |
| (65) 公開番号 | 特開2008-29520 (P2008-29520A)  |           | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号   |
| (43) 公開日  | 平成20年2月14日 (2008.2.14)       | (74) 代理人  | 100076233           |
| 審査請求日     | 平成21年6月5日 (2009.6.5)         |           | 弁理士 伊藤 進            |
|           |                              | (72) 発明者  | 田中 秀樹               |
|           |                              |           | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ |
|           |                              |           | リンパスメディカルシステムズ株式会社内 |
|           |                              | (72) 発明者  | 西村 博一               |
|           |                              |           | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ |
|           |                              |           | リンパスメディカルシステムズ株式会社内 |
|           |                              | (72) 発明者  | 沢 美穂                |
|           |                              |           | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オ |
|           |                              |           | リンパスメディカルシステムズ株式会社内 |

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 医療用画像処理装置及び医療用画像処理方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

医療用撮像装置から入力される体腔内の生体組織の像の2次元画像に基づき、前記生体組織の3次元モデルを推定する3次元モデル推定手段と、

前記3次元モデルにおいて、隆起形状を有する病変の検出対象領域を設定する検出対象領域設定手段と、

前記検出対象領域に含まれる各データ点における形状の状態を示す形状特徴量を算出する形状特徴量算出手段と、

前記検出対象領域に存在する、局所的な隆起形状の病変領域の検出に用いる閾値を決定する閾値決定手段と、

前記閾値決定手段により決定された閾値と前記形状特徴量算出手段により算出された形状特徴量とに基づいて前記病変領域を検出する3次元形状検出手段と

を備え、

前記閾値決定手段は、

前記医療用撮像装置から入力される体腔内の生体組織の像の前記2次元画像の撮像位置を視点とし、前記検出対象領域上の一の点を注目点とした時の、前記視点から前記注目点に至る視線ベクトルと前記注目点の前記検出対象領域での法線ベクトルとのなす角に基づき、前記病変領域の検出に用いる前記閾値を決定する

ことを特徴とする医療用画像処理装置。

【請求項 2】

医療用撮像装置から入力される体腔内の生体組織の像の２次元画像に基づき、前記生体組織の３次元モデルを推定する３次元モデル推定手段と、

前記３次元モデルにおいて、隆起形状を有する病変の検出対象領域を設定する検出対象領域設定手段と、

前記検出対象領域に含まれる各データ点における形状の状態を示す形状特徴量を算出する形状特徴量算出手段と、

前記検出対象領域に存在する、局所的な隆起形状の病変領域の検出に用いる閾値を決定する閾値決定手段と、

前記閾値決定手段により決定された閾値と前記形状特徴量算出手段により算出された形状特徴量とに基づいて前記病変領域を検出する３次元形状検出手段と

を備え、

前記形状特徴量算出手段は、

前記検出対象領域に含まれる各データ点のデータ密度分布に基づき、前記形状特徴量を算出し、

前記閾値決定手段は、

前記データ密度分布に基づき、前記病変領域の検出に用いる前記閾値を決定する

ことを特徴とする医療用画像処理装置。

#### 【請求項３】

医療用撮像装置から入力される体腔内の生体組織の像の２次元画像に基づき、前記生体組織の３次元モデルを推定する３次元モデル推定ステップと、

前記３次元モデルにおいて、隆起形状を有する病変の検出対象領域を設定する検出対象領域設定ステップと、

前記検出対象領域に含まれる各データ点における形状の状態を示す形状特徴量を算出する形状特徴量算出ステップと、

前記検出対象領域に存在する、局所的な隆起形状の病変領域の検出に用いる閾値を決定する閾値決定ステップと、

前記閾値決定ステップにより決定された閾値と前記形状特徴量算出ステップにより算出された形状特徴量とに基づいて前記病変領域を検出する３次元形状検出ステップと

を備え、

前記閾値決定ステップは、

前記医療用撮像装置から入力される体腔内の生体組織の像の前記２次元画像の撮像位置を視点とし、前記検出対象領域上の点を注目点とした時の、前記視点から前記注目点に至る視線ベクトルと前記注目点の前記検出対象領域での法線ベクトルとのなす角に基づき、前記病変領域の検出に用いる前記閾値を決定する

ことを特徴とする医療用画像処理方法。

#### 【請求項４】

医療用撮像装置から入力される体腔内の生体組織の像の２次元画像に基づき、前記生体組織の３次元モデルを推定する３次元モデル推定ステップと、

前記３次元モデルにおいて、隆起形状を有する病変の検出対象領域を設定する検出対象領域設定ステップと、

前記検出対象領域に含まれる各データ点における形状の状態を示す形状特徴量を算出する形状特徴量算出ステップと、

前記検出対象領域に存在する、局所的な隆起形状の病変領域の検出に用いる閾値を決定する閾値決定ステップと、

前記閾値決定ステップにより決定された閾値と前記形状特徴量算出ステップにより算出された形状特徴量とに基づいて前記病変領域を検出する３次元形状検出ステップと

を備え、

前記形状特徴量算出ステップは、

前記検出対象領域に含まれる各データ点のデータ密度分布に基づき、前記形状特徴量を算出し、

10

20

30

40

50

前記閾値決定ステップは、

前記データ密度分布に基づき、前記病変領域の検出に用いる前記閾値を決定することを特徴とする医療用画像処理方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、医療用画像処理装置及び医療用画像処理方法に関し、特に、生体組織の像の2次元画像に基づき、該生体組織の3次元モデルを推定する医療用画像処理装置及び医療用画像処理方法に関する。

【背景技術】

10

【0002】

従来、医療分野において、X線診断装置、CT、MRI、超音波観測装置及び内視鏡装置等の画像撮像機器を用いた観察が広く行われている。このような画像撮像機器のうち、内視鏡装置は、例えば、体腔内に挿入可能な挿入部を有し、該挿入部の先端部に配置された対物光学系により結像した体腔内の像を固体撮像素子等の撮像手段により撮像して撮像信号として出力し、該撮像信号に基づいてモニタ等の表示手段に体腔内の像の画像を表示するという作用及び構成を有する。そして、ユーザは、モニタ等の表示手段に表示された体腔内の像の画像に基づき、例えば、体腔内における臓器等の観察を行う。

【0003】

また、内視鏡装置は、消化管粘膜の像を直接的に撮像することが可能である。そのため、ユーザは、例えば、粘膜の色調、病変の形状及び粘膜表面の微細な構造等を総合的に観察することができる。

20

【0004】

さらに、内視鏡装置は、局所的な隆起形状を有する病変が存在する所定の画像を検出可能な画像処理方法として、例えば、特開2005-192880号公報（特許文献1）等に記載されている画像処理方法を用いることにより、ポリープ等の病変部位が含まれる画像を検出することもまた可能である。

【0005】

この特許文献1に記載されている画像処理方法は、入力された画像が有する輪郭を抽出するとともに、該輪郭の形状に基づき、該画像における局所的な隆起形状を有する病変を検出することができる。

30

【0006】

また、従来、大腸ポリープ検出処理においては、2次元画像から3次元データを推定し、3次元特徴量（Shape Index/Curvedness）を用いて大腸ポリープを検出している（非特許文献1）。この3次元特徴量は、参照点における偏微分係数を3次元データから算出して、偏微分係数を使用して算出することにより実現する。そして、大腸ポリープ検出処理では、3次元特徴量を閾値処理することにより、ポリープ候補を検出する。

【特許文献1】特開2005-192880号公報

【非特許文献1】電子情報通信学会、信学技報（MI2003-102）、形状情報に基づく3次元腹部CT像からの大腸ポリープ自動検出手法に関する検討 木村、林、北坂、森、末長 pp. 29～34, 2004

40

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

しかしながら、従来より3次元データの推定手法として使用される”Shape From Shading”法は、対象の反射/散乱特性や対象への2次光による影響を受けるため、従来の大腸ポリープ検出処理は、検出精度の低下及び誤検出の発生といった課題を有している。

【0008】

また、この”Shape From Shading”法は、画像に応じて3次元デー

50

タ密度の疎密が発生する。3次元特徴量の標準誤差（標本値が平均値に対してどの程度の範囲内に分布するかを示す統計指標）は、3次元データ密度の疎密による影響を受ける。この標準誤差によっても、従来の大腸ポリープ検出処理は、検出精度の低下及び誤検出の発生といった課題を有している。

#### 【0009】

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、対象の2次元画像の観察状態に適切に適応した処理を実行し、局所的な隆起形状を有する病変を検出する場合の検出精度を、従来に比べて向上させることのできる医療用画像処理装置及び医療用画像処理方法を提供することを目的としている。

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0010】

本発明の一態様の医療用画像処理装置は、医療用撮像装置から入力される体腔内の生体組織の像の2次元画像に基づき、前記生体組織の3次元モデルを推定する3次元モデル推定手段と、前記3次元モデルにおいて、隆起形状を有する病変の検出対象領域を設定する検出対象領域設定手段と、前記検出対象領域に含まれる各データ点における形状の状態を示す形状特徴量を算出する形状特徴量算出手段と、前記検出対象領域に存在する、局所的な隆起形状の病変領域の検出に用いる閾値を決定する閾値決定手段と、前記閾値決定手段により決定された閾値と前記形状特徴量算出手段により算出された形状特徴量とに基づいて前記病変領域を検出する3次元形状検出手段とを備え、前記閾値決定手段は、前記医療用撮像装置から入力される体腔内の生体組織の像の前記2次元画像の撮像位置を視点とし、前記検出対象領域上の一の点を注目点とした時の、前記視点から前記注目点に至る視線ベクトルと前記注目点の前記検出対象領域での法線ベクトルとのなす角に基づき、前記病変領域の検出に用いる前記閾値を決定する。

本発明の他の態様の医療用画像処理装置は、医療用撮像装置から入力される体腔内の生体組織の像の2次元画像に基づき、前記生体組織の3次元モデルを推定する3次元モデル推定手段と、前記3次元モデルにおいて、隆起形状を有する病変の検出対象領域を設定する検出対象領域設定手段と、前記検出対象領域に含まれる各データ点における形状の状態を示す形状特徴量を算出する形状特徴量算出手段と、前記検出対象領域に存在する、局所的な隆起形状の病変領域の検出に用いる閾値を決定する閾値決定手段と、前記閾値決定手段により決定された閾値と前記形状特徴量算出手段により算出された形状特徴量とに基づいて前記病変領域を検出する3次元形状検出手段とを備え、前記形状特徴量算出手段は、前記検出対象領域に含まれる各データ点のデータ密度分布に基づき、前記形状特徴量を算出し、前記閾値決定手段は、前記データ密度分布に基づき、前記病変領域の検出に用いる前記閾値を決定する。

#### 【0011】

また、本発明の一態様の医療用画像処理方法は、医療用撮像装置から入力される体腔内の生体組織の像の2次元画像に基づき、前記生体組織の3次元モデルを推定する3次元モデル推定ステップと、前記3次元モデルにおいて、隆起形状を有する病変の検出対象領域を設定する検出対象領域設定ステップと、前記検出対象領域に含まれる各データ点における形状の状態を示す形状特徴量を算出する形状特徴量算出ステップと、前記検出対象領域に存在する、局所的な隆起形状の病変領域の検出に用いる閾値を決定する閾値決定ステップと、前記閾値決定ステップにより決定された閾値と前記形状特徴量算出ステップにより算出された形状特徴量とに基づいて前記病変領域を検出する3次元形状検出ステップとを備え、前記閾値決定ステップは、前記医療用撮像装置から入力される体腔内の生体組織の像の前記2次元画像の撮像位置を視点とし、前記検出対象領域上の点を注目点とした時の、前記視点から前記注目点に至る視線ベクトルと前記注目点の前記検出対象領域での法線ベクトルとのなす角に基づき、記病変領域の検出に用いる前記閾値を決定する。

また、本発明の他の態様の医療用画像処理方法は、医療用撮像装置から入力される体腔内の生体組織の像の2次元画像に基づき、前記生体組織の3次元モデルを推定する3次元モデル推定ステップと、前記3次元モデルにおいて、隆起形状を有する病変の検出対象領

10

20

30

40

50

域を設定する検出対象領域設定ステップと、前記検出対象領域に含まれる各データ点における形状の状態を示す形状特徴量を算出する形状特徴量算出ステップと、前記検出対象領域に存在する、局所的な隆起形状の病変領域の検出に用いる閾値を決定する閾値決定ステップと、前記閾値決定ステップにより決定された閾値と前記形状特徴量算出ステップにより算出された形状特徴量とに基づいて前記病変領域を検出する３次元形状検出ステップとを備え、前記形状特徴量算出ステップは、前記検出対象領域に含まれる各データ点のデータ密度分布に基づき、前記形状特徴量を算出し、前記閾値決定ステップは、前記データ密度分布に基づき、前記病変領域の検出に用いる前記閾値を決定する。

【発明の効果】

【００１２】

10

本発明によれば、対象の２次元画像の観察状態に適切に適応した処理を実行し、局所的な隆起形状を有する病変を検出する場合の検出精度を、従来に比べて向上させることができるという効果がある。

【発明を実施するための最良の形態】

【００１３】

以下、図面を参照しながら本発明の実施例について述べる。

【実施例１】

【００１４】

図１ないし図６は本発明の実施例１に係わり、図１は医療用画像処理装置が用いられる内視鏡システムの全体構成の一例を示す図、図２は図１のＣＰＵの機能構成を示す機能ブロック図、図３は図２のＣＰＵの処理の流れを示すフローチャート、図４は図３の閾値Ｔ１、Ｔ２の決定処理の流れを示すフローチャート、図５は図４の処理で用いられる「Ｚ座標－閾値Ｔ１、Ｔ２」閾値テーブルデータを示す図、図６は図４の処理を説明する図である。

20

【００１５】

図１に示すように、本実施例の内視鏡システム１は、医療用観察装置２と、医療用画像処理装置３と、モニタ４とを有して要部が構成されている。

【００１６】

前記医療用観察装置２は、被写体を撮像するとともに、該被写体の像の２次元画像を出力する観察装置である。また、医療用画像処理装置３は、パーソナルコンピュータ等により構成され、医療用観察装置２から出力される２次元画像の映像信号に対して画像処理を行うとともに、該画像処理を行った後の映像信号を画像信号として出力する画像処理装置である。さらにモニタ４は、医療用画像処理装置３から出力される画像信号に基づく画像を表示する表示装置である。

30

【００１７】

前記医療用観察装置２は、内視鏡６と、光源装置７と、カメラコントロールユニット（以降、ＣＣＵと略記する）８と、モニタ９とを有して要部が構成されている。

【００１８】

前記内視鏡６は、被検体の体腔内に挿入されるとともに、該体腔内に存在する生体組織等の被写体を撮像して撮像信号として出力するものである。前記光源装置７は、内視鏡６により撮像される被写体を照明するための照明光を供給するものである。前記ＣＣＵ８は、内視鏡６に対する各種制御を行うとともに、内視鏡６から出力される撮像信号に対して信号処理を行い、２次元画像の映像信号として出力するものである。前記モニタ９は、ＣＣＵ８から出力される２次元画像の映像信号に基づき、内視鏡６により撮像された被写体の像を画像表示するものである。

40

【００１９】

前記内視鏡６は、体腔内に挿入される挿入部１１と、挿入部１１の基端側に設けられた操作部１２とを有して構成されている。また、挿入部１１内の基端側から、挿入部１１内の先端側の先端部１４にかけての部分には、光源装置７から供給される照明光を伝送するためのライトガイド１３が挿通されている。

【００２０】

50

前記ライトガイド１３は、先端側が内視鏡６の先端部１４に配置されるとともに、後端側が前記光源装置７に接続される。

【００２１】

ライトガイド１３がこのような構成を有することにより、光源装置７から供給される照明光は、ライトガイド１３により伝送された後、挿入部１１の先端部１４の先端面に設けられた、図示しない照明窓から出射される。そして、図示しない照明窓から照明光が出射されることにより、被写体としての生体組織等が照明される。

【００２２】

内視鏡６の先端部１４には、図示しない照明窓に隣接する図示しない観察窓に取り付けられた対物光学系１５と、対物光学系１５の結像位置に配置され、例えば、ＣＣＤ（電荷結合素子）等により構成される撮像素子１６とを有する撮像部１７が設けられている。このような構成により、対物光学系１５により結像された被写体の像は、撮像素子１６により撮像された後、撮像信号として出力される。なお、撮像素子１６は、ＣＣＤに限らずＣ－ＭＯＳセンサにより構成してもよい。

【００２３】

前記撮像素子１６は、信号線を介してＣＣＵ８に接続されている。そして、撮像素子１６は、ＣＣＵ８から出力される駆動信号に基づいて駆動するとともに、ＣＣＵ８に対し、撮像した被写体の像に応じた撮像信号を出力する。

【００２４】

また、ＣＣＵ８に入力された撮像信号は、ＣＣＵ８の内部に設けられた図示しない信号処理回路において信号処理されることにより、２次元画像の映像信号として変換されて出力される。ＣＣＵ８から出力された２次元画像の映像信号は、モニタ９及び医療用画像処理装置３に対して出力される。これにより、モニタ９は、ＣＣＵ８から出力される映像信号に基づく被写体の像を２次元画像として表示する。

【００２５】

医療用画像処理装置３は、医療用観察装置２から出力される２次元画像の映像信号に対し、Ａ／Ｄ変換を行って出力する画像入力部２１と、画像入力部２１から出力される映像信号に対して画像処理を行う、中央演算処理装置としてのＣＰＵ２２と、該画像処理に関する処理プログラムが書き込まれた処理プログラム記憶部２３と、画像入力部２１から出力される映像信号等を記憶する画像記憶部２４と、ＣＰＵ２２が行う画像処理における演算結果等を記憶する解析情報記憶部２５とを有して構成される。

【００２６】

また、医療用画像処理装置３は、記憶装置インターフェース（Ｉ／Ｆ）２６と、記憶装置Ｉ／Ｆ２６を介してＣＰＵ２２の画像処理結果としての画像データ、ＣＰＵ２２が画像処理にて使用する各種データ等を記憶する、記憶装置としてのハードディスク２７と、ＣＰＵ２２の画像処理結果としての画像データに基づき、該画像データをモニタ４に画像表示するための表示処理を行うとともに、該表示処理を行った後の画像データを画像信号として出力する表示処理部２８と、ＣＰＵ２２が行う画像処理におけるパラメータ及び医療用画像処理装置３に対する操作指示をユーザが入力可能な、キーボードあるいはマウス等のポインティングデバイス等により構成される入力操作部２９とを有する。そして、モニタ４は、表示処理部２８から出力される画像信号に基づく画像を表示する。

【００２７】

なお、医療用画像処理装置３の画像入力部２１、ＣＰＵ２２、処理プログラム記憶部２３、画像記憶部２４、解析情報記憶部２５、記憶装置インターフェース２６、表示処理部２８及び入力操作部２９のそれぞれは、データバス３０を介して相互に接続されている。

【００２８】

図２に示すように、ＣＰＵ２２は、３次元モデル推定手段としての３次元モデル推定部２２ａ、検出対象領域設定手段としての検出対象領域設定部２２ｂ、形状特徴量算出手段としての形状特徴量算出部２２ｃ、３次元形状検出手段としての３次元形状検出部２２ｄ、閾値決定手段としての閾値決定部２２ｅ、ポリープ決定部２２ｆの各機能部からなる。

## 【0029】

なお、本実施例では、これら機能部は、CPU 22が行うソフトウェアにて実現される。また、これら機能部の詳細な作用については後述する。

## 【0030】

次に、このように構成された、本実施例の内視鏡システム1の作用について、図3及び図4のフローチャートを用い、図5及び図6を参照して説明する。

## 【0031】

まず、ユーザは、内視鏡システム1が有する各部の電源を投入した後、被検体の体腔内に内視鏡6の挿入部11を挿入する。

## 【0032】

そして、ユーザにより挿入部11が被検体の体腔内に挿入されると、例えば、該体腔内に存在する生体組織等である被写体の像が、先端部14に設けられた撮像部17により撮像される。そして、撮像部17により撮像された被写体の像は、撮像信号としてCCU8に対して出力される。

## 【0033】

CCU8は、図示しない信号処理回路において、撮像部17の撮像素子16から出力される撮像信号に対して信号処理を行うことにより、該撮像信号を2次元画像の映像信号として変換して出力する。そして、モニター9は、CCU8から出力される映像信号に基づき、撮像部17により撮像された被写体の像を2次元画像として表示する。また、CCU8は、撮像部17の撮像素子16から出力される撮像信号に対して信号処理を行うことにより得られた2次元画像の映像信号を、医療用画像処理装置3に対して出力する。

## 【0034】

医療用画像処理装置3に対して出力された2次元画像の映像信号は、画像入力部21においてA/D変換された後、CPU22に入力される。

## 【0035】

そして、図3に示すように、CPU22の3次元モデル推定部22aは、ステップS1にて画像入力部21から出力される2次元画像に対し、例えば、“Shape From Shading”法等を用い、該2次元画像の輝度情報等に基づく幾何学的な変換等の処理を施すことにより、該2次元画像に応じた3次元モデルを推定し、3次元モデルの各データ点の座標を記憶装置I/F26を介してハードディスク27に格納する。

## 【0036】

次に、CPU22の検出対象領域設定部22bは、ステップS2にて画像入力部21から出力される2次元画像の色調変化と、図3のステップS1の処理により推定した3次元モデルの隆起性変化とを検出することにより、該3次元モデルにおける隆起形状を有する病変を検出するための処理の適用対象となる領域としての、検出対象領域である対象領域を設定する。

## 【0037】

具体的には、CPU22の検出対象領域設定部22bは、例えば、画像入力部21から出力される2次元画像を、R（赤）画像、G（緑）画像及びB（青）画像の各プレーン画像に分離した後、該R画像に応じて推定した3次元モデルのデータに基づいて隆起性変化を検出するとともに、該R画像及びG画像の色度に基づいて色調変化を検出する。そして、CPU22の検出対象領域設定部22bは、前記隆起性変化の検出結果及び前記色調変化の検出結果に基づき、前記隆起性変化及び前記色調変化の両方が検出された領域を、前記対象領域として設定する。

## 【0038】

その後、CPU22の形状特徴量算出部22cは、ステップS3にて対象領域の局所偏微分係数を算出する。具体的には、CPU22の形状特徴量算出部22cは、算出された3次元形状に対して、注目する3次元位置（ $x$ 、 $y$ 、 $z$ ）を含む局所領域（曲面）におけるそのR画素値 $f$ における1階偏微分係数 $f_x$ 、 $f_y$ 、 $f_z$ 、及び2階偏微分係数 $f_{xx}$ 、 $f_{yy}$ 、 $f_{zz}$ 、 $f_{xy}$ 、 $f_{yz}$ 、 $f_{xz}$ を算出する。

## 【0039】

さらに、CPU 22の形状特徴量算出部22cは、ステップS4にて3次元モデルの処理対象領域に存在する各データ点に対し、(3次元形状)の形状特徴量として、局所偏微分係数に基づき、Shape Index値及びCurvedness値を算出する処理を行う。

## 【0040】

すなわち、これらの局所偏微分係数を用いて、CPU 22の形状特徴量算出部22cは、ガウス曲率K、平均曲率Hを算出する。

## 【0041】

一方、曲面の主曲率 $k_1$ 、 $k_2$  ( $k_1 \geq k_2$ ) は、ガウス曲率Kと、平均曲率Hを用いて

$$k_1 = H + (H^2 - K)^{1/2} \quad k_2 = H - (H^2 - K)^{1/2} \quad (1)$$

と表される。

## 【0042】

また、この場合における曲面形状を表す特徴量であるShape Index S I 及びCurvedness C Vは、それぞれ

$$S I = 1/2 - (1/\pi) \arctan [(k_1 + k_2)/(k_1 - k_2)] \quad (2)$$

$$C V = ((k_1^2 + k_2^2)/2)^{1/2} \quad (3)$$

となる。

## 【0043】

CPU 22の形状特徴量算出部22cは、このようにして、3次元の各曲面におけるShape Index S I 及びCurvedness C Vを3次元形状情報として算出し、解析情報記憶部25に格納する。

## 【0044】

前述したShape Index値は、3次元モデルが有する各データ点における凹凸の状態を示すための値であり、0以上1以下の範囲内の数値として示される。具体的には、3次元モデル内に存在する個々のデータ点において、Shape Index値が0に近い場合には凹型形状の存在が示唆され、また、Shape Index値が1に近い場合には凸型形状の存在が示唆される。

## 【0045】

また、前述したCurvedness値は、3次元モデルが有する各データ点における曲率を示すための値である。具体的には、3次元モデル内に存在する個々のデータ点において、Curvedness値が小さければ小さい程鋭く曲がった曲面の存在が示唆され、また、Curvedness値が大きければ大きい程鈍く曲がった曲面の存在が示唆される。

## 【0046】

次に、CPU 22の閾値決定部22eは、ステップS5にて3次元モデルの対象領域に存在する各データにおいて、Shape Index値及びCurvedness値の各値と比較する閾値T1、T2の決定処理を行う。このステップS5の閾値T1、T2の決定処理の詳細は、後述する。

## 【0047】

また、CPU 22の3次元形状検出部22dは、ステップS6にて3次元モデルの対象領域に存在する各データ点において、Shape Index値及びCurvedness値の各値と、閾値決定部22eが決定した閾値T1、T2との比較処理を行うことにより、該各データ点のうち、隆起形状を有するデータ群として検出する。具体的には、CPU 22は、3次元モデルの処理対象領域に存在する各データ点のうち、例えば、Shape Index値が閾値T1より大きく、かつ、Curvedness値が閾値T2より大きい複数のデータ点を、隆起形状を有するデータ群として検出する。

## 【0048】

そして、CPU 22のポリープ決定部22fは、ステップS7にて3次元モデルにおいて隆起形状を有するデータ群として検出した複数のデータ点各々が、ポリープ等の病変に由来する隆起形状に該当するデータ点であるかを判別する隆起形状判別処理を行う。



## 【0049】

その後、CPU 22のポリープ決定部22fは、ステップS8にて病変に由来する隆起形状に該当するデータ点からなるデータ群を有する領域をポリープ領域として決定し、病変領域であるポリープを検出する。

## 【0050】

そして、CPU 22は、その検出結果を、例えば図1のハードディスク27に検出対象の内視鏡画像と関連付けて格納すると共に、表示処理部28を経てモニタ4に、例えば検出対象の内視鏡画像と並べて表示する。

## 【0051】

これにより、モニタ4には、ポリープ等の病変に由来する隆起形状が存在する位置をユーザが容易に認識可能であるような、被写体の3次元モデルが画像表示される。

10

## 【0052】

次に、上記のステップS5の閾値T1、T2の決定処理について説明する。図4に示すように、CPU 22の閾値決定部22eは、ステップS51にてパラメータ*i*を1に設定し、ステップS52にて3次元モデルの対象領域内の第*i*番目のデータ点の3次元座標( $x_i, y_i, z_i$ )を解析情報記憶部25より取得する。

## 【0053】

そして、CPU 22の閾値決定部22eは、ステップS53にて記憶装置I/F26を介して、ハードディスク27に格納されている、図5に示すような「Z座標—閾値T1、T2」閾値テーブルデータから、Z座標 $z_i$ に基づき、閾値T1( $i$ )、T2( $i$ )を読み出す。そして、CPU 22の閾値決定部22eは、ステップS54にて第*i*番目のデータ点のShape Index値及びCurvedness値の閾値T1( $i$ )、T2( $i$ )として解析情報記憶部25に格納する。

20

## 【0054】

そして、CPU 22の閾値決定部22eは、ステップS55にてパラメータ*i*が3次元モデルの対象領域内の全てのデータ点の数Nに達したかどうか判断し、 $i > N$ でないならばステップS56にてパラメータ*i*をインクリメントしてステップS52に戻る。CPU 22の閾値決定部22eは、ステップS55において3次元モデルの対象領域内の全てのデータ点での閾値T1( $i$ )、T2( $i$ )を決定するまで、上記のステップS52～S56の処理を繰り返す。

30

## 【0055】

なお、Z座標値とT1、T2との関係を、「Z座標—閾値T1、T2」閾値テーブル(図5参照)に示す値の1次または2次関数の当てはめにより数式化して、数式演算により求めるように構成してもよい。

## 【0056】

2次元画像において、光源から近いほど、粘膜下からの散乱光が増大し、他の位置の反射光(2次光)の入射量も増大する。また、大腸内視鏡画像は腸管の撮像画像であるため、腸管方向が画像内にある場合において奥行き方向の遠い位置での画像部分は、腸管壁を斜めからみたときの画像を撮像していることとなり、腸壁に対する正面視のときと比べて、反射光や散乱光の角度特性が異なってくる。すなわち、閾値判定点のZ座標に応じて、ポリープ候補検出のためのShape Index(凹凸性を示す指標)と、Curvedness(凹凸の鋭さを示す指標)の最適な閾値組み合わせが異なってくる。例えば図6は、同一の閾値組み合わせでポリープ候補検出を行った例であるが、手前の本来のポリープ250だけではなく、奥のほうのなだらかな凸部251や、峰状に近い凸部252を検出してしまっている。

40

## 【0057】

上述したように本実施例では、3次元データの着目点における位置(Z座標)を用いて閾値を補正するため、対象の反射/散乱特性や対象への2次光による影響を除外した閾値をポリープ検出処理に使用でき、ポリープ候補の検出精度を向上させることができる。よって、ユーザに対して、大腸内視鏡検査においてポリープ候補発見率の向上を促すことが可能となる。

50

## 【実施例 2】

## 【0058】

図 7 ないし図 11 は本発明の実施例 2 に係わり、図 7 は閾値  $T1$ 、 $T2$  の決定処理の流れを示すフローチャート、図 8 は図 7 の処理で用いられる「なす角－乗算値」閾値テーブルデータを示す図、図 9 は図 7 の処理を説明する第 1 の図、図 10 は図 7 の処理を説明する第 2 の図、図 11 は図 7 の処理を説明する第 3 の図である。

## 【0059】

実施例 2 は、Shape Index 値及び Curvedness 値の各値と比較する閾値  $T1$ 、 $T2$  の決定処理が実施例 1 と異なり、構成は実施例 1 と同じであるので、異なる点のみ説明する。

## 【0060】

本実施例の Shape Index 値及び Curvedness 値の各値と比較する閾値  $T1$ 、 $T2$  の決定処理では、図 7 に示すように、CPU 22 の閾値決定部 22e は、ステップ S51 にてパラメータ  $i$  を 1 に設定し、ステップ S52 にて 3 次元モデルの対象領域内の第  $i$  番目のデータ点の 3 次元座標 ( $x_i$ ,  $y_i$ ,  $z_i$ ) を解析情報記憶部 25 より取得する。

## 【0061】

そして、CPU 22 の閾値決定部 22e は、ステップ S57 にて視点座標と前記座標点の差分を計算して、視線ベクトルを生成する。視点位置の座標 ( $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ ) は、図 3 のステップ S1 において決定されており、この視線ベクトル  $V_0$  ( $V_{x0}$ ,  $V_{y0}$ ,  $V_{z0}$ ) は、( $x_i - x_0$ ,  $y_i - y_0$ ,  $z_i - z_0$ ) となる。

## 【0062】

次に、CPU 22 の閾値決定部 22e は、ステップ S58 にて第  $i$  番目のデータ点における法線ベクトル  $V_i$  ( $V_{xi}$ ,  $V_{yi}$ ,  $V_{zi}$ ) を算出する。この法線ベクトル  $V_i$  は、図 3 のステップ S2 において求めた 2 次曲面  $f$  について、データ点における微分値 ( $f_x$ ,  $f_y$ ,  $f_z$ ) を計算することにより求まる。また、CPU 22 の閾値決定部 22e は、ステップ S59 にて視線ベクトルと法線ベクトルのなす角  $\theta_i$  を算出する。このなす角  $\theta_i$  は、ベクトルの内積公式により求める。

## 【0063】

なお、本実施例では、図 8 に示すような「なす角－乗算値」閾値テーブルデータ及び閾値のデフォルト値  $T1(0)$ 、 $T2(0)$  がハードディスク 27 に格納されている。

## 【0064】

次に、CPU 22 の閾値決定部 22e は、ステップ S60 にて、ハードディスク 27 に格納されている「なす角－乗算値」閾値テーブルデータより、求めたなす角  $\theta_i$  に対応する乗算値  $\alpha_i$ 、 $\beta_i$  を抽出すると共に、閾値のデフォルト値 ( $T1(0)$ 、 $T2(0)$ ) をハードディスク 27 から取得し、閾値のデフォルト値  $T1$ 、 $T2$  と乗算値  $\alpha_i$ 、 $\beta_i$  をそれぞれ乗算した値  $T1(i)$  ( $= \alpha_i \times T1(0)$ )、 $T2(i)$  ( $= \beta_i \times T2(0)$ ) を求める。

## 【0065】

そして、CPU 22 の閾値決定部 22e は、ステップ S54 にて第  $i$  番目のデータ点の Shape Index 値及び Curvedness 値の閾値  $T1(i)$ 、 $T2(i)$  として解析情報記憶部 25 に格納する。

## 【0066】

そして、CPU 22 の閾値決定部 22e は、ステップ S55 にてパラメータ  $i$  が 3 次元モデルの対象領域内の全てのデータ点の数  $N$  に達したかどうか判断し、 $i > N$  でないならばステップ S56 にてパラメータ  $i$  をインクリメントしてステップ S52 に戻る。CPU 22 の閾値決定部 22e は、ステップ S55 において 3 次元モデルの対象領域内の全てのデータ点での閾値  $T1(i)$ 、 $T2(i)$  を決定するまで、上記の図 7 のステップ S52、S57～S60、S54～S56 の処理を繰り返す。

## 【0067】

この閾値  $T1(i)$ 、 $T2(i)$  により、図 3 に示したステップ S6 における、3 次元モデルの対象領域に存在する各データ点においての、Shape Index 値及び Curvedness 値の各値と、閾値決定部 22e が決定した閾値  $T1$ 、 $T2$  との比較処理を実行する。

## 【0068】

大腸内視鏡画像は、腸壁に対する正面視/斜視により、反射光や散乱光の角度特性が異なるため、閾値判定点の腸壁の法線ベクトルと、視線角とがなす角度に応じて、ポリープ候補検出のためのShape Index値及びCurvedness値の最適な閾値組み合わせが異なってくる。

## 【0069】

例えば図9は、半球状のサンプル100を正面視により撮像した画像であるが、“Shape From Shading”法によって3次元データを生成すると、視点から見た画像が反射光や散乱光の角度特性により半楕円球状に伸びてしまうという問題がある。

## 【0070】

本実施例では、3次元データの着目点における位置、角度情報を用いて閾値を補正するため、実施例1と同様な効果に得ることができ、また、テーブル値とデフォルト値を掛け合わせる構成であるため、デフォルト値の変更に応じて、最適な閾値を求めることが可能となる。

## 【0071】

なお、例えば特開2003-93328号公報等に開示されている内視鏡画像の視野内管腔検出方法を用いることで、内視鏡画像の視野内管腔検出の有無により、画像全体における平均的な閾値を決定する構成も可能である。

## 【0072】

例えば、図10に示すように、視野内に管腔101全体を検出した場合には、腸管表面の法線ベクトルと視線角とのなす角は、画像全体の平均値として大きい値をとる。よって、例えば図8の閾値テーブルのなす角=60~の値を使用して乗算値 $\alpha_i = 1.03$ 、 $\beta_i = 0.90$ を抽出し、閾値を $T1 = 1.03 \times T1(0)$ 、 $T2 = 0.90 \times T2(0)$ として決定する。

## 【0073】

また、図11に示すように、視野内に管腔101全体を検出しなかった場合には、腸管表面の法線ベクトルと視線角とのなす角度は、画像全体のへ閾値として、小さい値をとる。よって、例えば図8の閾値テーブルのなす角=20~30の値を使用して乗算値 $\alpha_i = 1.01$ 、 $\beta_i = 0.98$ を抽出し、閾値を $T1 = 1.01 \times T1(0)$ 、 $T2 = 0.98 \times T2(0)$ として決定する。

## 【実施例3】

## 【0074】

図12ないし図16は本発明の実施例3に係わり、図12は局所偏微分係数の算出処理を説明する図、図13は図12の局所偏微分係数の算出処理の流れを示すフローチャート、図14は図13の処理の後段の閾値 $T1$ 、 $T2$ の決定処理の流れを示すフローチャート、図15は図13の処理で用いられるデータ点数 $M_i$ と閾値 $T1$ 、 $T2$ との対応を示す閾値テーブルを示す図、図16は図13の局所偏微分係数の算出処理の変形例の流れを示すフローチャートである。

## 【0075】

実施例3は、局所偏微分係数の算出処理（図3のステップS3）及びShape Index値及びCurvedness値の各値と比較する閾値 $T1$ 、 $T2$ の決定処理（図3のステップS5）が実施例1と異なり、構成は実施例1と同じであるので、異なる点のみ説明する。

## 【0076】

実施例1では、固定サイズの立方または球の範囲内に存在する3次元データ点を用いていた。このため、実施例1で適用した局所偏微分係数の算出処理（図3のステップS3）では、図12に示すように、3次元データ点の疎密が生じるため、推定される局所偏微分係数の標準誤差はデータが疎になると大きくなる。データが密である範囲を基準として閾値を設定した場合には、データが疎である範囲において取りこぼしが発生してしまう。また、データが疎である範囲を基準として閾値を設定した場合には、データが密である範囲において誤検出が増加してしまう。

## 【0077】

本実施例の局所偏微分係数の算出処理は、3次元データ点取得領域を決定する処理が加えられている点が実施例1と異なる。

## 【0078】

本実施例の局所偏微分係数の算出処理では、まず、図3のステップS2によって算出された腸管表面上の点のうちの着目する1つの点について、当該位置における腸管表面の2次曲面方程式の係数を推定算出し、2次曲面方程式を偏微分することにより局所偏微分係数を求める。2次曲面方程式は、着目する1つの点を中心とする立方または球の局所領域を設定し、局所領域内に存在する、自身を含めた3次元データ点の座標値から行列を作成し（9点以上の座標値が必要となる）、その擬似逆行列を生成することにより求める。

10

## 【0079】

具体的には、本実施例の局所偏微分係数の算出処理では、図13に示すように、CPU22の形状特徴量算出部22cは、ステップS31にてパラメータ*i*を1に設定し、ステップS32にて第*i*番目の3次元データ点における局所偏微分係数を算出するにあたり、まず変数*L*に初期値*L0*をセットする。

## 【0080】

続いて、CPU22の形状特徴量算出部22cは、ステップS33にて3次元モデルの対象領域内の第*i*番目のデータ点の3次元座標（*x<sub>i</sub>*, *y<sub>i</sub>*, *z<sub>i</sub>*）を解析情報記憶部25より取得する。

## 【0081】

20

そして、CPU22の形状特徴量算出部22cは、ステップS34にてハードディスク27に記憶している、腸管表面を示す3次元データ点列から、第*i*番目のデータ点の座標（*x<sub>i</sub>*, *y<sub>i</sub>*, *z<sub>i</sub>*）を中心とする立方範囲（*x<sub>i</sub>*±*L*, *y<sub>i</sub>*±*L*, *z<sub>i</sub>*±*L*）の範囲内に存在するデータ点情報を取得する。このデータ点情報の数*n<sub>i</sub>*をカウントする。

## 【0082】

次に、CPU22の形状特徴量算出部22cは、ステップS35にてカウント数*n<sub>i</sub>*と所定の値*K*とを比較して、カウント数*n<sub>i</sub>*が*K*よりも大きい場合には、ステップS36での2次元曲面方程式の係数算出処理、ステップS37での局所偏微分係数の算出処理をおこない、図3のステップS3のShape Index／Curvednessの算出処理へと進む。

## 【0083】

30

カウント数*n<sub>i</sub>*が所定の値*K*以下の場合には、ステップS38にて*L*に対して所定の増分*LS*を加算して前記範囲を拡張した後、ステップS34に戻り、範囲内にあるデータ点情報をカウントしなおす。

## 【0084】

そして、CPU22の形状特徴量算出部22cは、ステップS39にてパラメータ*i*が3次元モデルの対象領域内の全てのデータ点の数*N*に達したかどうか判断し、*i* > *N*でないならばステップS56にてパラメータ*i*をインクリメントしてステップS32に戻る。CPU22の形状特徴量算出部22cは、ステップS39において3次元モデルの対象領域内の全てのデータ点での2次元曲面方程式の係数算出、局所偏微分係数の算出が完了するまで、上記の図12のS32～S39、S56の処理を繰り返す。

40

## 【0085】

以上の処理により、局所領域内に含まれる3次元データ点数が所定数以上になるように局所領域のサイズ変更を行う。

## 【0086】

また、本実施例のShape Index値及びCurvedness値の各値と比較する閾値*T1*, *T2*の決定処理では、図14に示すように、CPU22の閾値決定部22eは、ステップS51にてパラメータ*i*を1に設定し、ステップS52にて3次元モデルの対象領域内の第*i*番目のデータ点の3次元座標（*x<sub>i</sub>*, *y<sub>i</sub>*, *z<sub>i</sub>*）を解析情報記憶部25より取得する。

## 【0087】

そして、CPU22の閾値決定部22eは、ステップS61にてこの3次元座標（*x<sub>i</sub>*

50

、 $y_i, z_i$ )を中心とする立方領域を、所定の値 $L$ を使用して設定する。すなわち、 $\{(x_i', y_i', z_i') \mid x_i - L \leq x_i' \leq x_i + L, y_i - L \leq y_i' \leq y_i + L, z_i - L \leq z_i' \leq z_i + L\}$ と設定する。この立方領域内にあるデータ点数 $M_i$ を、ハードディスク27に格納されている3次元データ点列を元にして数える。

【0088】

なお、ハードディスク27内には、図15に示す、データ点数 $M_i$ と閾値 $T1, T2$ とが対応する閾値テーブルを記憶している。

【0089】

そして、CPU22の閾値決定部22eは、ステップS62にて前記のデータ点数 $M_i$ を元にして、閾値テーブルからデータ点数 $M_i$ に対応する閾値 $T1, T2$ を取得する。

10

【0090】

続いて、CPU22の閾値決定部22eは、ステップS54にて第 $i$ 番目のデータ点のShape Index値及びCurvedness値の閾値 $T1(i), T2(i)$ として解析情報記憶部25に格納する。

【0091】

そして、CPU22の閾値決定部22eは、ステップS55にてパラメータ $i$ が3次元モデルの対象領域内の全てのデータ点の数 $N$ に達したかどうか判断し、 $i > N$ でないならばステップS56にてパラメータ $i$ をインクリメントしてステップS52に戻る。CPU22の閾値決定部22eは、ステップS55において3次元モデルの対象領域内の全てのデータ点での閾値 $T1(i), T2(i)$ を決定するまで、上記の図14のステップS52、S61、S62、S54～S56の処理を繰り返す。

20

【0092】

なお、データ点数 $M_i$ が0～8である場合には、閾値処理が無効であるため、閾値 $T1, T2$ は無効であることを示す値0が代入される。また、座標を中心とする立方領域内のデータ点数を数えるように構成しているが、 $x_k'^2 + y_k'^2 + z_k'^2 < L$ の条件を加えて、座標を中心とする球領域内のデータ点数を数えるように構成してもよい。

【0093】

このように本実施例では、局所領域内に含まれる3次元データ点数が所定数以上になるように局所領域のサイズ変更を行うと共に、3次元データの点密度に応じて3次元特徴量(Shape Index値及びCurvedness値)を求めるための閾値 $T1, T2$ を設定するので、3次元データの密度に応じて、ポリープ検出処理における処理パラメータを変更することにより、ポリープ候補の検出精度を向上させることができ、大腸内視鏡検査においてポリープ候補発見率の向上を促すことが可能となる。

30

【0094】

なお、範囲内に存在するデータ点数が多すぎる場合には、2次曲面方程式の係数算出時の処理時間が増大する。

【0095】

そこで、本実施形態の局所偏微分係数の算出処理の変形例である図16の処理フローに示すように、CPU22の形状特徴量算出部22cは、ステップS40にて、取得したデータ点数が所定の値 $J$ ( $K < J$ )よりも大きいかどうか判断し、大きい場合には、ステップS41にて2次曲面方程式の係数算出に用いるデータ点を $K+1$ に抑えるように構成してもよい。

40

【0096】

この場合には、取得したデータ点数と所定の値 $J$ との比較により、カウント数 $n_i$ が $J$ より大きい場合には、データ点情報のうちの $K+2$ 番目以降のデータを削除して、2次曲面方程式の係数を算出することにより実現する。

【0097】

本発明は、上述した実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲において、種々の変更、改変等が可能である。

【図面の簡単な説明】

50

## 【0098】

【図1】本発明の実施例1に係る医療用画像処理装置が用いられる内視鏡システムの全体構成の一例を示す図

【図2】図1のCPUの機能構成を示す機能ブロック図

【図3】図2のCPUの処理の流れを示すフローチャート

【図4】図3の閾値T1, T2の決定処理の流れを示すフローチャート

【図5】図4の処理で用いられる「Z座標-閾値T1, T2」閾値テーブルデータを示す図

【図6】図4の処理を説明する図

【図7】本発明の実施例2に係る閾値T1, T2の決定処理の流れを示すフローチャート

【図8】図7の処理で用いられる「「なす角-乗算値」閾値テーブルデータを示す図

10

【図9】図7の処理を説明する第1の図

【図10】図7の処理を説明する第2の図

【図11】図7の処理を説明する第3の図

【図12】本発明の実施例3に係る局所偏微分係数の算出処理を説明する図

【図13】図12の局所偏微分係数の算出処理の流れを示すフローチャート

【図14】図13の処理の後段の閾値T1, T2の決定処理の流れを示すフローチャート

【図15】図13の処理で用いられるデータ点数Miと閾値T1, T2との対応を示す閾値テーブルを示す図

【図16】図12の局所偏微分係数の算出処理の変形例の流れを示すフローチャート

【符号の説明】

20

## 【0099】

1…内視鏡システム

2…医療用観察装置

3…医療用画像処理装置

4、9…モニタ

6…内視鏡

7…光源装置

8…CCU

11…挿入部

12…操作部

30

13…ライトガイド

14…先端部

15…対物光学系

16…撮像素子

17…撮像部

21…画像入力部

22…CPU

22a…3次元モデル推定部

22b…検出対象領域設定部

22c…形状特徴量算出部

40

22d…3次元形状検出部

22e…閾値決定部

22f…ポリープ決定部

23…処理プログラム記憶部

24…画像記憶部

25…解析情報記憶部

26…記憶装置I/F

27…ハードディスク


28…表示処理部

29…入力操作部


50

30…データバス


【図1】

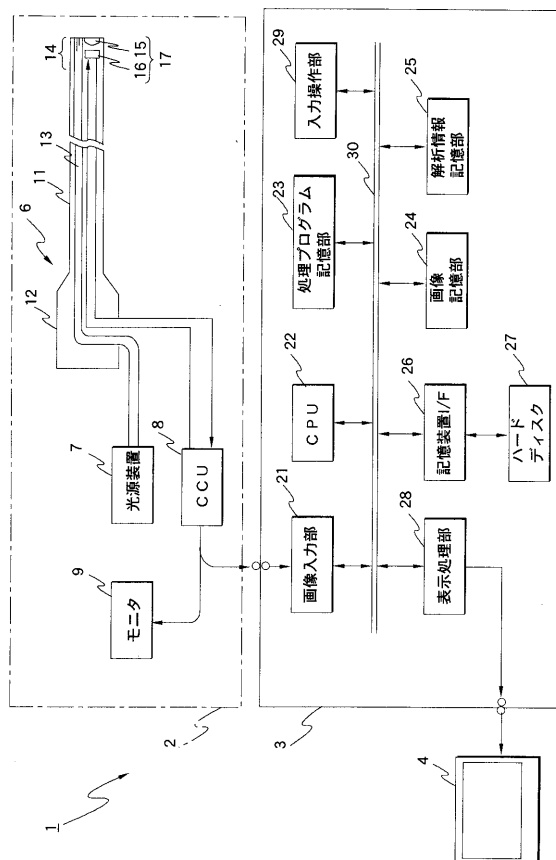


【図2】

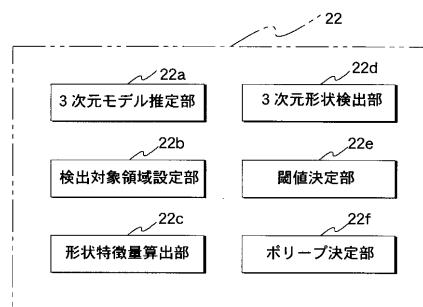

【図 3】

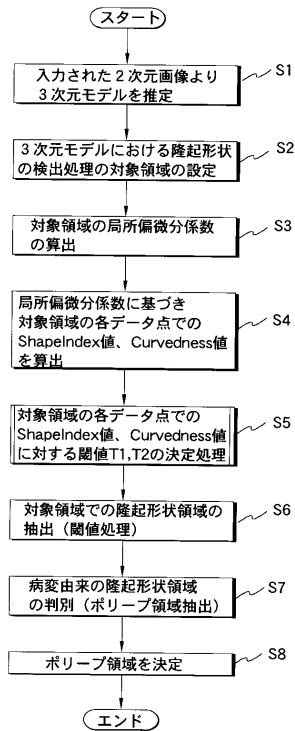


【図 4】

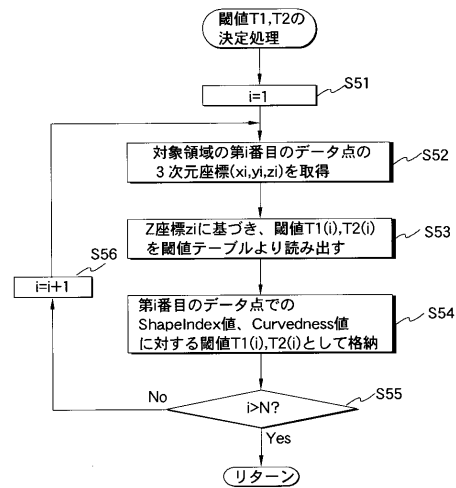


【図 5】

| Z座標   | T1   | T2   |
|-------|------|------|
| 0~10  | 0.90 | 0.15 |
| 10~20 | 0.90 | 0.14 |
| 20~30 | 0.91 | 0.13 |
| ⋮     | ⋮    | ⋮    |
| 50~   | 0.95 | 0.10 |

【図 6】

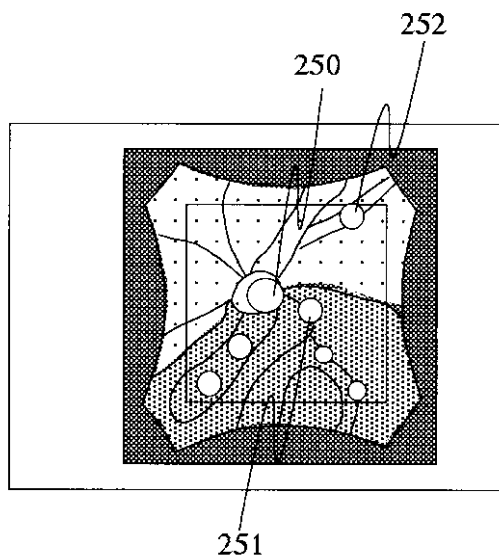

【図 7】

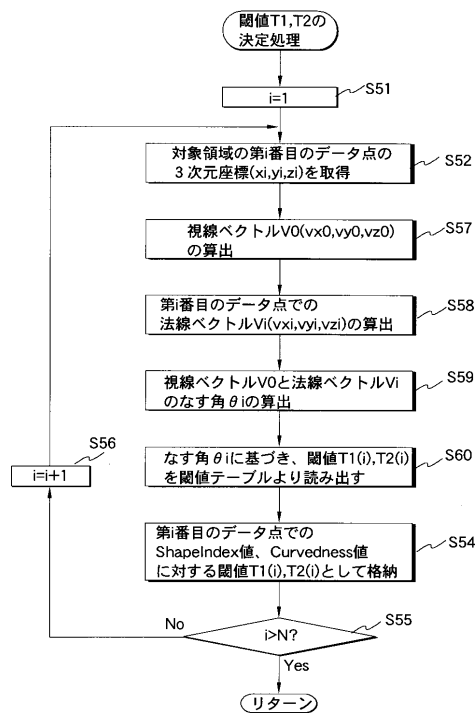





【図 8】

| なす角   | 乗算値 $\alpha$ | 乗算値 $\beta$ |
|-------|--------------|-------------|
| 0~10  | 1.00         | 1.00        |
| 10~20 | 1.00         | 0.99        |
| 20~30 | 1.01         | 0.98        |
| ⋮     | ⋮            | ⋮           |
| ⋮     | ⋮            | ⋮           |
| 60~   | 1.03         | 0.90        |


【図 9】

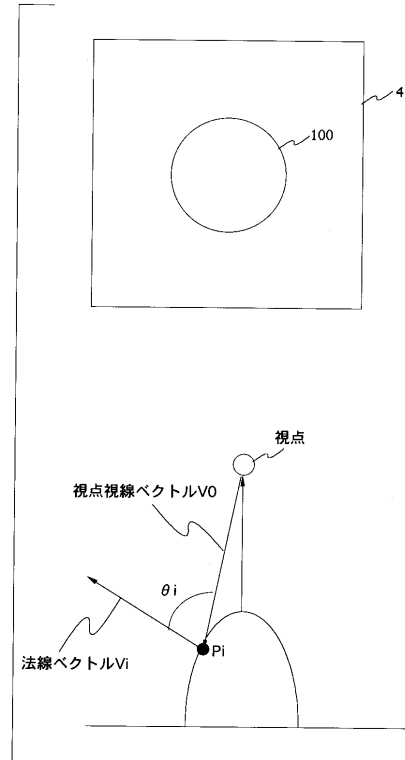


【図 10】

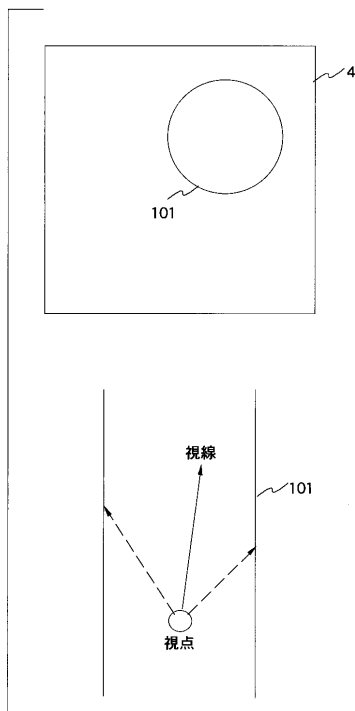


【図 11】

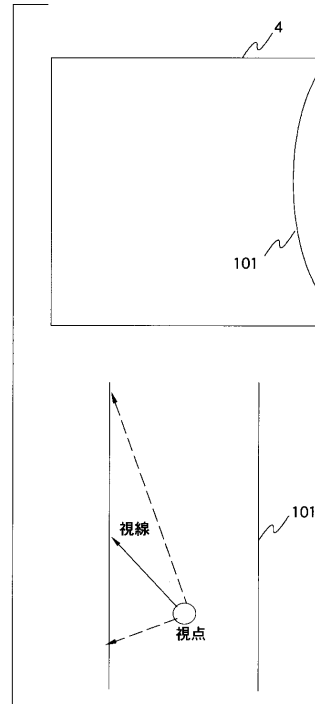


【図 1 2】

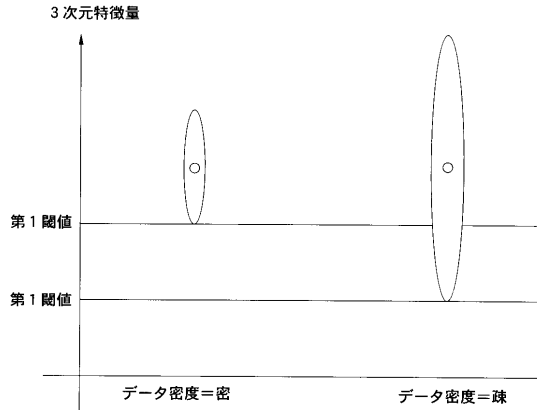

【図 1 3】

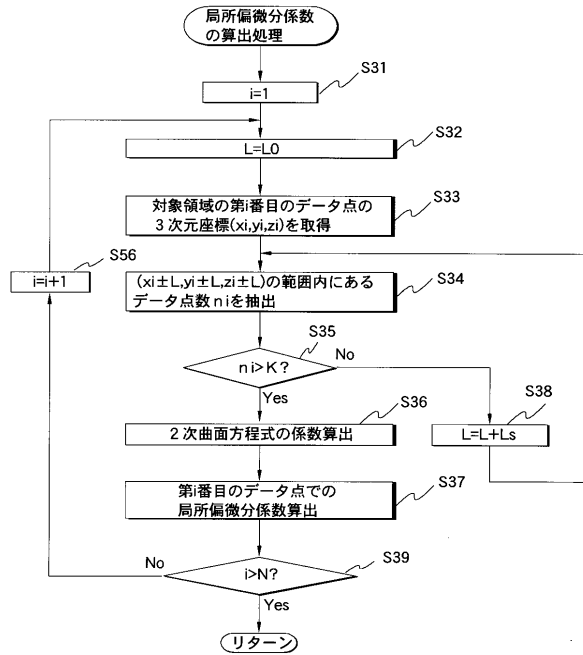


【図 1 4】

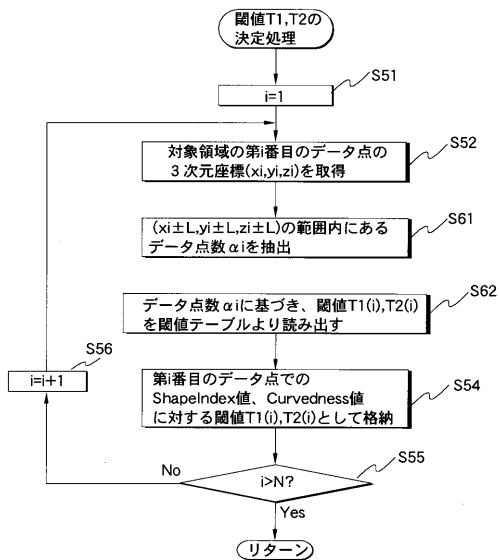

【図 1 5】

| データ点数 | T1   | T2   |
|-------|------|------|
| 0~8   | 0.0  | 0.0  |
| 9~13  | 0.90 | 0.14 |
| 14~18 | 0.91 | 0.13 |
| ...   | ...  | ...  |
| 29~   | 0.95 | 0.10 |

【図 1 6】

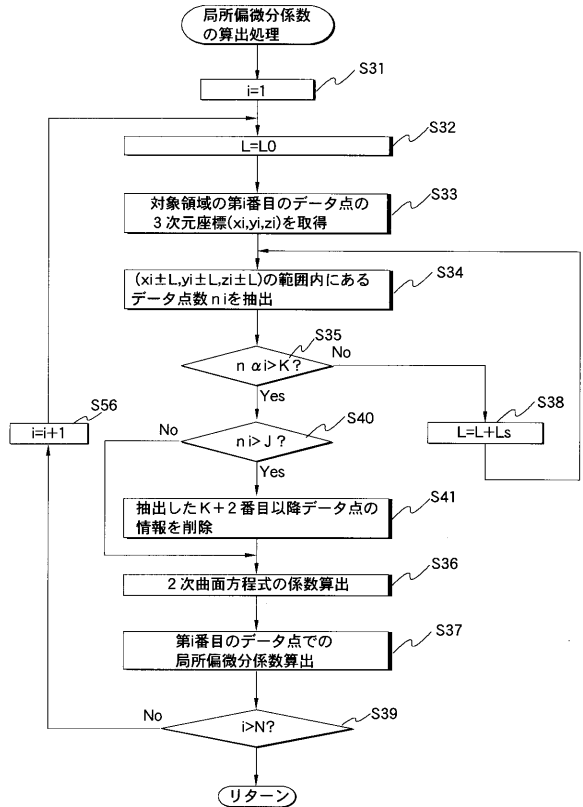

---

フロントページの続き

- (72)発明者 中村 健次  
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリジナルメディカルシステムズ株式会社内
- (72)発明者 井上 涼子  
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリジナルメディカルシステムズ株式会社内

審査官 長井 真一

- (56)参考文献 特開2006-187470 (JP, A)  
木村 崇博, 形状情報に基づく3次元腹部CT像からの大腸ポリープ自動検出手法に関する検討, 電子情報通信学会技術研究報告, 日本, 社団法人電子情報通信学会, 2004年 1月18日, 103(599), p. 29-34, URL, <http://ci.nii.ac.jp/naid/110003171926>

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
- |      |      |
|------|------|
| A61B | 1/04 |
| A61B | 6/03 |
| G06T | 1/00 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 医学图像处理设备和医学图像处理方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JP4994737B2</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 公开(公告)日 | 2012-08-08 |
| 申请号            | JP2006205142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 申请日     | 2006-07-27 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 奥林巴斯医疗株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | オリンパスメディカルシステムズ株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |
| 当前申请(专利权)人(译)  | オリンパスメディカルシステムズ株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |
| [标]发明人         | 田中秀樹<br>西村博一<br>沢美穂<br>中村健次<br>井上涼子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |
| 发明人            | 田中 秀樹<br>西村 博一<br>沢 美穂<br>中村 健次<br>井上 涼子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| IPC分类号         | A61B1/04 A61B6/03 G06T1/00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| CPC分类号         | A61B1/04 G06T7/0012 G06T2200/04 G06T2207/10068 G06T2207/30032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |
| FI分类号          | A61B1/04.372 A61B6/03.360.G G06T1/00.290.Z G06T1/00.315 A61B1/045.616 A61B1/045.618 A61B1/05 G06T7/00.612 G06T7/507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |            |
| F-TERM分类号      | 4C061/AA00 4C061/BB00 4C061/CC06 4C061/DD00 4C061/GG01 4C061/LL02 4C061/NN01 4C061/NN05 4C061/NN07 4C061/SS11 4C061/SS21 4C061/WW02 4C061/WW10 4C061/YY12 4C093/AA01 4C093/AA21 4C093/CA31 4C093/DA01 4C093/FD09 4C093/FF16 4C093/FF17 4C093/FF42 4C161/AA00 4C161/BB00 4C161/CC06 4C161/DD00 4C161/GG01 4C161/LL02 4C161/NN01 4C161/NN05 4C161/NN07 4C161/SS11 4C161/SS21 4C161/WW02 4C161/WW10 4C161/YY12 5B057/AA07 5B057/BA24 5B057/CA08 5B057/CA12 5B057/CA16 5B057/CB13 5B057/CB16 5B057/DA08 5B057/DB02 5B057/DB09 5B057/DC08 5B057/DC09 5L096/AA02 5L096/AA06 5L096/BA06 5L096/BA13 5L096/BA18 5L096/CA02 5L096/DA02 5L096/EA26 5L096/FA68 5L096/GA02 5L096/GA06 5L096/GA51 |         |            |
| 代理人(译)         | 伊藤 进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 审查员(译)         | 永井伸一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 其他公开文献         | JP2008029520A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |

#### 摘要(译)

要解决的问题：执行适当地适应于物体的二维图像的观察状态的处理，并且当检测具有局部凸起形状的病変时提高检测精度。解决方案：本实施例的内窥镜系统设置有医学观察装置，医学图像处理器和构成主要部分的监视器。医学图像处理器的CPU 22包括三维模型估计部分22a，检测对象区域设置部分22b，形状特征量计算部分22c，三维形状检测部分22d，阈值的各个功能部分决定部分22e和息肉决定部分22f。

図 2

