

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-103292
(P2005-103292A)

(43) 公開日 平成17年4月21日(2005.4.21)

(51) Int.Cl.⁷

A 61 B 17/34

A 61 B 1/00

F 1

A 61 B 17/34

A 61 B 1/00 320 E

テーマコード(参考)

4 C 0 6 0

4 C 0 6 1

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L 外国語出願 (全 32 頁)

(21) 出願番号 特願2004-285248 (P2004-285248)
 (22) 出願日 平成16年9月29日 (2004.9.29)
 (31) 優先権主張番号 506737
 (32) 優先日 平成15年9月30日 (2003.9.30)
 (33) 優先権主張国 米国(US)

(71) 出願人 595057890
 エシコン・エンドーサージェリィ・インコ
 ーポレイテッド
 Ethicon Endo-Surgery,
 Inc.
 アメリカ合衆国、45242 オハイオ州
 、シンシナティ、クリーク・ロード 45
 45
 (74) 代理人 100066474
 弁理士 田澤 博昭
 (74) 代理人 100088605
 弁理士 加藤 公延
 (74) 代理人 100123434
 弁理士 田澤 英昭

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 トロカールシール用の器具固定用組立体

(57) 【要約】

【課題】 内視鏡または他の器具をトロカール組立体に
 対して配置し易くした便利な固定機構を提供すること。

【解決手段】 トロカールスリーブに用いる固定用組立体
 であって、内部を貫通する開口を備えた固定用組立体
 ハウジングを含む。固定用組立体は、固定用組立体ハウ
 ジング内に配置されたカムレバー及び弾性ブロックを含
 む。カムレバーは、固定用組立体ハウジングに回動可能
 に取り付けられた第1の端部と、使用者が操作できるよ
 うに適合された自由な第2の端部とを含み、カムレバー
 を回動させて、弾性ブロックを固定用組立体ハウジング
 内を通る器具に係合させて器具を固定用組立体ハウジ
 グに固定することができる。

【選択図】 図25

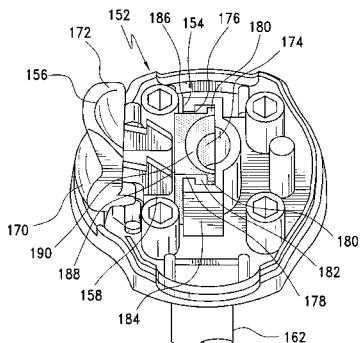

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

トロカールスリーブに用いる固定用組立体であって、
内部を貫通する開口を備えた固定用組立体ハウジングと、
前記固定用組立体ハウジング内に配置されたカムレバー及び弾性ブロックとを含み、
前記カムレバーが、前記固定用組立体ハウジングに回動可能に取り付けられた第1の端部と、使用者が操作できるように適合された自由な第2の端部とを含み、前記カムレバーを回動させて、前記弾性ブロックを前記固定用組立体ハウジング内を通る器具に係合させて前記器具を前記固定用組立体ハウジングに固定できることを特徴とする固定用組立体。

【請求項 2】

前記カムレバーが、その前記第1の端部に近接したカム面を含み、前記カム面が、前記固定用組立体ハウジングを通る器具と係合できるように前記弾性ブロックに選択に係合する形状及び大きさを有することを特徴とする請求項1に記載の固定用組立体。

【請求項 3】

前記カム面が、器具が前記固定用組立体ハウジング内にある時にのみ、付勢により前記弾性ブロックに接触するようにし、前記固定用組立体が使用されていない時は前記弾性ブロックに対して加えられる力を最小限にすることを特徴とする請求項1に記載の固定用組立体。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本願は、現在係属中の2003年9月30日出願の米国仮特許出願第60/506,737号（名称「トロカールシール用の器具固定用組立体（INSTRUMENT LOCK ASSEMBLY FOR TROCAR）」）に基づいている。

【0002】

本発明はトロカール組立体に関する。詳細には、本発明はトロカールスリーブ及び/またはトロカールオブチュレータに対して器具を所定の位置に固定するための構造に関する。

【背景技術】**【0003】**

トロカール組立体は、体内の内腔にアクセスするために用いられる外科器具である。トロカール組立体は通常、トロカールハウジング及びトロカールカニューレとからなるトロカールスリーブとトロカールオブチュレータとの2つの主な構成要素を含む。内部にトロカールオブチュレータが挿入されたトロカールカニューレは、体内の内腔にアクセスして腹腔鏡または関節鏡外科手術及び内視鏡処置を行うためにチューブを介して皮膚から挿入される。皮膚に刺入する際は、既に外科用メスで切開された皮膚にトロカールカニューレの先端部を配置する。トロカールオブチュレータは、先端部に丸い先端または切断縁を有する。トロカールオブチュレータの基端部に圧力を加えて、先端部を皮膚から体内の内腔まで前進させる。トロカールカニューレをトロカールオブチュレータによって形成された通路に挿入したら、トロカールオブチュレータは抜き取るが、トロカールカニューレは体内の内腔へのアクセス通路としてそのまま残す。

【0004】

トロカール組立体を患者の体内に挿入する際に、トロカール組立体と共に内視鏡または他の器具を利用する望ましい。しかしながら、内視鏡または他の器具をトロカール組立体に対して所望の位置に維持するが困難な場合がある。

【発明の開示】**【発明が解決しようとする課題】****【0005】**

従って、内視鏡または他の器具をトロカール組立体に対して配置し易くした便利な固定機構が要望されている。本発明はこのような固定機構を提供する。

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】**【0006】**

従って、本発明の目的は、トロカールスリープに用いる固定用組立体を提供することにある。固定用組立体は、内部を貫通する開口を備えた固定用組立体ハウジングを含む。固定用組立体はまた、固定用組立体ハウジング内に配置されたカムレバー及び弾性ロックを含む。カムレバーは、固定用組立体ハウジングに回動可能に取り付けられた第1の端部と、使用者が操作できるように適合された自由な第2の端部とを含み、カムレバーを回動させて、弾性ロックを固定用組立体ハウジング内を通る器具に係合させて器具を固定用組立体ハウジングに固定することができる。

【0007】

本発明の目的はまた、トロカールスリープに用いるオプチュレータを提供することにある。オプチュレータは、先端部、基端部、及び内部に延在する通路を有するシャフトを含む。オプチュレータはまた、シャフトの基端部に器具固定装置を含む。器具固定装置は、器具が通路内に挿入され固定された時に器具に当接させる圧縮可能な材料を含む。

【0008】

本発明の別の目的は、トロカールに用いる器具固定装置を提供することにある。器具固定装置は、内部を貫通する通路を有するハウジングと、器具がその通路内に挿入され固定された時にその器具に選択的に当接させるためにハウジング内に配置された圧縮可能な材料とを含む。

【0009】

本発明の他の目的及び利点は、本発明の特定の実施形態を説明する添付の図面を参照しながら以下の詳細の説明を読めば、明らかになるであろう。

【発明の効果】**【0010】**

内視鏡または他の器具をトロカール組立体に対して配置し易くした便利な固定機構が提供される。

【発明を実施するための最良の形態】**【0011】**

本発明の詳細な実施形態をここに開示する。しかしながら、開示する実施形態は本発明の単なる例示であって、様々な形態に組み合わせることができることを理解されたい。従って、ここに開示する詳細は、限定することが目的ではなく、請求の基礎をなし、また当業者が本発明を以下に実施し、かつ/または使用するための基礎である。

【0012】

トロカールシール組立体のための内視鏡固定用組立体を開示する。この固定用組立体は、内視鏡のトロカール組立体に対する配置を制御することができる。固定用組立体は、内視鏡を所定の位置に固定するように適合されているとして開示するが、本発明の概念から逸脱することなく他の器具の固定に用いることもできる。

【0013】

図1-図5に示されているように、トロカール組立体10は通常、トロカールカニューレ12、トロカールオプチュレータ14、及びトロカールハウジング(またはハンドル)16を含む。トロカールカニューレ12は、開口した先端部分20及び開口した基端部分22を有する内腔を画定している。基端部分22は、トロカールハウジング16の先端部分24内に延在し、そこで取り付けられている。トロカールハウジング16は、開口28を画定する開口した基端部分26を有する。開口28には、後述するように本発明に従って形成された基端側シール組立体30が設けられている。更に開口28には、基端側シール組立体30の下側に位置するダックビルシール組立体32が設けられている。本発明のシール組立体は、二重シールシステムの一部をなす基端側シール組立体として開示されているが、このシール組立体は、本発明の概念から逸脱することなく一重シールシステムに用いることもできる。

【0014】

10

20

30

40

50

一般に、トロカールスリーブ 4 4 は、トロカールカニューレ 1 2 及びトロカールハウジング 1 6 からなる。トロカールハウジング 1 6 は、第 1 のハウジング部材 3 6 及び第 2 のハウジング部材 3 8 を含む。第 2 のハウジング部材 3 8 は、第 2 のハウジング部材カバー 3 8 a 及び第 2 のハウジング部材ベース 3 8 b からなる。ハウジング 1 6 は 2 つの構成要素として開示されているが、本発明の概念から逸脱することなく 1 つの構成要素とすることもできることを理解されたい。図示されている 2 つの構成要素からなるハウジングは、試料の取り出しが容易である。

【 0 0 1 5 】

トロカールオプチュレータ 1 4 は、トロカールカニューレ 1 2 に対してスライド式に挿入及び取り出しが可能であり、基端側シール組立体 3 0 、ダックビルシール組立体 3 2 、及びトロカールハウジング 1 6 の開口 2 8 を介してトロカールハウジング 1 6 及びトロカールカニューレ 1 2 内に挿入できる。トロカールオプチュレータ 1 4 の基端部には、オプチュレータハンドル 3 4 が設けられており、その先端部には、尖端すなわちブレード（不図示）が形成されている。当分野でよく知られているように、基端側シール組立体 3 0 は、トロカールスリーブ 4 4 内に延在する器具（例えば、トロカールオプチュレータ及びトロカールを用いた処置に使用できるように適合された他の器具など）の外面にシール係合して、トロカールハウジング 1 6 を通る流体の通路を妨げている。

【 0 0 1 6 】

ロータリーラッチシステム

図 1 - 図 5 に示されているように、トロカールハウジング 1 6 は、詳細を後述する理由から選択的に結合される第 1 のハウジング部材 3 6 と第 2 のハウジング部材 3 8 とからなる。第 1 及び第 2 のハウジング部材 3 6 、 3 8 は、トロカールハウジング 1 6 内を選択的に通過する器具を受容できる形状及び大きさの整合した開口 4 0 、 4 2 を含む。

【 0 0 1 7 】

当業者であれば、トロカールスリーブ 4 4 を腹腔壁内に挿入している間、及び処置している間、第 1 及び第 2 のハウジング部材 3 6 、 3 8 が確実に固定するのが重要であることを理解できよう。しかしながら、例えば腹腔から試料を取り出す際に、第 1 のハウジング部材 3 6 を取り外すのが理想的である。第 1 のハウジング部材 3 6 を取り外すことにより、ダックビルシール組立体 3 2 と基端側シール組立体 3 0 の両方を通過させなくても、ダックビルシール組立体 3 2 のみを通過させて試料を得ることができ、サンプルの取り出しが容易になり、取り出す際にサンプルが損傷を受けにくくなる。

【 0 0 1 8 】

第 1 のハウジング部材 3 6 は、基端側シール組立体 3 0 を支持し、ダックビルシール組立体 3 2 が取り付けられた第 2 のハウジング部材 3 8 の上に位置する。第 1 のハウジング部材 3 6 は、内部を貫通する開口 4 0 を含む。基端側シール組立体 3 0 は、第 1 のハウジング部材 3 6 の開口 4 0 内に配置されている。

【 0 0 1 9 】

第 2 のハウジング部材 3 8 について述べると、第 2 のハウジング部材 3 8 は内部を貫通する開口 4 2 を含む。ダックビルシール組立体 3 2 は、第 2 のハウジング部材 3 8 の上面 5 0 に近接して第 2 のハウジング部材 3 8 の開口 4 2 内に配置されている。実際、詳細を後述する理由から、ダックビルシール組立体 3 2 の外周リム 5 2 が、第 1 のハウジング部材 3 6 の下面 5 4 に係合するように、第 2 のハウジング部材 3 8 の上面 5 0 に近接して直接配置されている。

【 0 0 2 0 】

第 1 のハウジング部材 3 6 と第 2 のハウジング部材 3 8 の結合は、ロータリーラッチ機構 5 6 によって容易になっている。具体的には、第 1 のハウジング部材 3 6 が、下方に延びた第 1 及び第 2 のアーム 5 8 を含む。下方に延びたそれぞれのアーム 5 8 は、下側を向いたカム面 6 0 及び上側を向いたラッチ面 6 2 を含む。

【 0 0 2 1 】

第 2 のハウジング部材 3 8 も同様に、第 1 のハウジング部材 3 6 の下方に延びた第 1 及

10

20

30

40

50

び第2のアーム58のそれぞれのラッチ面62にそれぞれ係合する第1及び第2のラッチ部材66を備えたラッチリング64を含む。ラッチリング64は、トロカールスリープ44の中心軸と同軸上にあり、ダックビルシール組立体32の外周の環状溝68内に延在している。好適な実施形態に従ったラッチリング64はトロカールハウジング16の中心軸を中心に回動するが、ラッチリング64は、本発明の概念から逸脱することなく他の軸を中心に回動することもできる。ラッチリング64は、トロカールスリープ44の中心軸を中心に回動できるが、ばね70によってトロカールハウジング16に取り付けられている。ばね70は、小さな付勢でラッチリング64を固定位置に保持している。しかしながら、ばね70が第1のハウジング部材36に取り付けられても、ラッチリング64の回動が可能である。第1及び第2のラッチ部材66はそれぞれ、第1のハウジング部材36の下方に延びた第1及び第2のアーム58の下側を向いたカム面60に係合する上側を向いたカム面72を含む。

10

【0022】

第1及び第2のラッチ部材66はそれぞれ、下側に延びたアーム58のカム面60と係合する大きさ及び形状を有する、上側を向いたカム面72を含む。同様に、第1及び第2のラッチ部材66は、下側に延びた第1及び第2のアーム58の外側を向いたラッチ面62に係合する大きさ及び形状を有する、内側を向いたラッチ面74を含む。

20

【0023】

実際、第1及び第2のハウジング部材36、38のラッチ動作は、下側に延びた第1及び第2のアーム58を第2のハウジング部材38の上面50に形成された孔76の中に通すことによって達成される。下側に延びた第1及び第2のアーム58がラッチリング64の第1及び第2のラッチ部材66に近接したそれぞれの孔76を通過すると、下側に延びた第1及び第2のアーム58のカム面60が第1及び第2のラッチ部材66のカム面72に係合する。この係合により、下側に延びた第1及び第2のアーム58が第1及び第2のラッチ部材66を越えて、ラッチリング64が回動できる。この回動は、ばね70による付勢に抗して行われる。

20

【0024】

下側に延びた第1及び第2のアーム58が第1及び第2のラッチ部材66を通過すると、ラッチリング64を付勢しているばね70により、ラッチリング64が元の位置に戻り、第1のハウジング部材36の外側を向いたラッチ面62が第2のハウジング部材38の内側を向いたラッチ面74に係合し、第1のハウジング部材36と第2のハウジング部材38が確実に結合される。第1及び第2のハウジング部材36、38は、ラッチリング64に取り付けられたレバー78を作動させて選択的に分離させることができる。レバー78の回動によりラッチリング64が回動し、第1及び第2のラッチ部材66が移動して下側に延びたアーム58との係合が解除される。

30

【0025】

第2のハウジング部材38の上面50には、第1のハウジング部材38の下側に延びたアーム58がわずかな隙間で通過できる孔76を含む。隙間がわずかであるため、下側に延びたアーム58が孔76の平面を殆ど移動できず曲がらない。従って、第1のハウジング部材36が第2のハウジング部材38にラッチされると、第1のハウジング部材36と第2のハウジング部材38とを力によって分離する唯一の手段は、下側に延びた第1及び第2のアーム58自体の剪断またはその脚部に対する純張力である。第1及び第2のアーム58は、孔76の大きさから、曲がってまたはスリップして外れることがない。従って、確実に取り付けられる。トロカールハウジング16は、レバー78を押して水平方向に回動させてばねの力に打ち勝ってラッチリング64がトロカールスリープ44の中心軸を中心に回動させて、分離することができる。外科医は、トロカールハウジング16の側面のスロットを介してレバー78を操作することができる。レバー78を押すと、ラッチリング64の第1及び第2のラッチ部材66が下側に延びた第1及び第2のアーム58を越えて回動し、第1のハウジング部材36が第2のハウジング部材38から解放される。

40

【0026】

50

第1のハウジング部材36は、ロータリーラッチ機構56によって第2のハウジング部材38に取り付けられており、注入された気体を維持するために第1のハウジング部材36と第2のハウジング部材38との間にシールが必要である。このシールは、第1のハウジング部材36の下面54に設けられた下側に延びたフランジ80を用いて、第2のハウジング部材38の上面50に近接したダックビルシール組立体32の一部を圧迫して達成することができる。フランジ80及びダックビルシール組立体32はそれぞれ、互いに反対に傾斜した表面を含む。従って、第1のハウジング部材36のフランジ80と第2のハウジング部材38のダックビルシール組立体32との傾斜した係合が得られる。従って、第1のハウジング部材36を容易に取り付けることができ、ダックビルシール組立体の性能に影響を与えることなく、シールに必要な距離を越えて垂直方向に移動させることができる。実際、この過度の移動は、ロータリーラッチ機構の機能の信頼性を得るために必要である。

10

【0027】

第1のハウジング部材36の下側に延びたフランジ80の傾斜した係合面は、ダックビルシール組立体32に径方向の力成分を付与する。この傾斜した係合面はまた、取り付けの力に変換される垂直方向の力成分を発生させる。この径方向の力が、係合構造すなわちダックビルシール組立体32の外周リム52を拡張させる。垂直方向の力は力全体の一部であるため、係合面の角度に比例して取り付けの力が減少する。

20

【0028】

径方向の力及び垂直方向の力に加えて、第1のハウジング部材36と第2のハウジング部材38とのシールが、下側に延びたフランジ80とダックビルシール組立体32の外周リム52との相互作用によってカム動作を生じさせる。ダックビルシール組立体32の外周リム52の径方向の動きにより、通常の動作におけるダックビルシール組立体の性能に悪影響を与えることなく、フランジ80に対してわずかに過剰な移動が可能となる。

30

【0029】

この過剰な移動に加えて、ダックビルシール組立体32の外周リム52の圧迫により、第1のハウジング部材36を第2のハウジング部材38から分離するのに役立つエネルギーが蓄えられる。この蓄えられたエネルギーにより、レバー78の動作によって第1のハウジング部材36が第2のハウジング部材38から容易に移動する。

30

【0030】

より具体的には、第1のハウジング部材36と第2のハウジング部材38の結合は、ダックビルシール組立体32の外周リム52に係合できる形状及び大きさを有する、第1のハウジング部材36の下面54に沿った外側に延びたフランジ80を設けて強化することができる。更に、下側に延びたフランジ80に内側を向いたテープを設け、外周リム52に外側を向いたテープを設けることができる。内側を向いたテープと外側を向いたテープとの相互作用により、第1のハウジング部材36と第2のハウジング部材38とを確実に取り付けることができる。具体的には、圧力を受けるとわずかに屈曲するように外周リム52に内向きのテープ面を設けて、互いに対向したテープ面を設けて、ラッチ機構の確実な結合に必要な寸法公差を大きくすることができる。

40

【0031】

第1のハウジング部材36と第2のハウジング部材38との適切な整合は、第1のハウジング部材36の下面54から下側に延びた整合ピン82と、第2のハウジング部材38の上面50に沿って形成された、整合ピン82を受容できる形状及び大きさを有する一致する孔84を設けて達成される。整合ピン82及びこれに一致する孔84を設けることにより、第1のハウジング部材36と第2のハウジング部材38を所望の構造に組み立てることができる。場合によっては、反対のラッチが係合するのを防止するために第2のピンを設けることもできる。これは安全面で、デザインに不可欠な部分である。トロカールオブチュレータ14は、唯1つの構造に第1のハウジング部材36を取り付けでき、第1のハウジング部材36は、唯1つの構造に第2のハウジング部材38を取り付けできる。

50

【0032】

上記したように、第1のハウジング部材36と第2のハウジング部材38を結合するために用いるロータリーラッチ機構56は様々な利点を提供する。具体的には、このロータリーラッチデザインにより、ラッチが絶対に外れないように第1のハウジング部材36を第2のハウジング部材38に確実に取り付けることができ、その一方で第1のハウジング部材36を容易に取り外すことができる。実際、第1のハウジング部材36の下側に延びた第1及び第2のアーム58が通過する孔76により、アーム58が曲がって外れてしまうことはない。加えて、ラッチ戻りばね70の力のベクトルが使用中に加わる外す力に対して垂直であるため、第1のハウジング部材36を取り付けるために必要な力は、所定の外す力とは別に加えることができる。これは、ラッチアームの弾性変形により外側シールハウジングに対する取り付け／取り外しをする一般的なラッチデザインとは対照的である。このようなタイプのデザインでは、組み立ての力と取り外しの力は、ラッチアームの曲げ特性によって互いに直接関連している。最後に、ラッチ機構は片手で簡単に操作することができる。

【0033】

第1のハウジング部材36の下側に延びたフランジ80とダックビルシール組立体32の外周リム52との傾斜した接触により、第1のハウジング部材36を第2のハウジング部材38に取り付けるために必要な組み立ての力が減少した。第1のハウジング部材36を平坦なシールの場合よりも長い距離圧迫しなければならないが、組み立てに必要な力は同じである。これにより、要求される所定の圧迫距離に対してデザイン部分の公差を大きくすることができる。加えて、ダックビルシール組立体32の外周リム52が隆起しているため、径方向の変位が可能となり、更に組み立てに必要な力が少なくなっている。

【0034】

補強シール組立体

図6-図10を参照すると、基端側シール組立体30が開示されている。このシール組立体は通常、キャップ86、クラウン88、径方向のシールの動きに用いられるベロー90、雌型保持リング94、プロテクタ92、シール本体98を構成する複数の補強シールセグメント96、雄型保持リング100、及び下部本体102を含む。補強シールセグメント96は、詳細を後述するように配置され、本発明に従ったシール組立体30を形成するために保持リング94と100との間に取り付けられる。

【0035】

図7-図10に、具体的に補強シールセグメント96が示されている。詳細を後述するように、基端側シール組立体30は、完全なシール本体98の形成に複数の補強シールセグメント96を用いている。補強シールセグメント86のそれぞれは、部分円錐の形態であって、具体的には約225度に亘る円錐の形態である。本発明の好適な実施形態に従った部分円錐形は約225度に亘る部分円錐を用いるが、本発明の概念から逸脱することなく他の形状の部分円錐も用いることができる。好適な実施形態に従って円錐形シールセグメントが開示されているが、本発明の概念から逸脱することなく平坦なシールセグメントを用いることもできる。

【0036】

補強シールセグメント96のそれぞれは、限定するものではないがポリイソブレンやシリコーンなどの架橋ポリマーのエラストマーから製造するのが好ましい。しかしながら、当業者であれば、本発明の概念から逸脱することなく他の材料も利用できることを理解できよう。

【0037】

実際、一連の補強シールセグメント96を用いて、器具を挿入するシール本体98を形成する。本発明の好適な実施形態に従えば、4つの補強シールセグメント96が整合し、互いに90度ずつずらされている。シールセグメント96は、「編み合わせ」構造に配置されている。すなわち、それぞれのシールセグメント96は、第1の面104及び第2の面106を含み、それぞれのシールセグメント96の第1の面104は、近接するシールセグメント96の第2の面106の上に配置され、シールセグメント96の編み合わせ組

10

20

30

40

50

立体が形成されている。

【0038】

次いで、補強シールセグメント96は、それらの外周縁108に沿って雄型リング100及び及び雌型保持リング94に結合され、完全なシール本体98が形成される。補強シールセグメント96の部分的な円錐形とそれらの相対的な角度位置により、結合されたシールセグメント96からシール本体98が形成され、器具が挿入されると個々のシールセグメント96が外側に押されて器具の通過する開口が形成され、器具を引き抜くと弾性的に内側に移動して開口が閉じられる。補強シールセグメント96の一般的な変形が図3に示されている。器具の挿入による変形が示されている。

【0039】

上記したように、それぞれの補強シールセグメントの96は通常、円錐の一部が切除された円錐の形態である。補強シールセグメント96は、中心シール部材110に取り付けられた外周縁108を含む。外周縁108は実質的に平坦であって同一平面上にあるが、中心シール部材110は部分円錐の形状である。

【0040】

中心シール部材110は、補強シールセグメント96の中心に設けられた補強パッド112によって強化されている。補強パッド112は、外周縁と中心シール部材110の自由縁との間に位置する。より具体的には、補強パッド112は、中心シール部材110によって画定された円錐の先端に位置し、補強パッド110の縁が、円錐の先端で中心シール部材110の自由縁と整合している。

【0041】

補強パッド112は、中心シール部材110の残りの部分と一体に形成されるが、中心シール部材110の厚みは基準部分の約2.5倍である。具体的には、中心シール部材110の補強パッド112は、約0.4318mm(0.017インチ)の厚みに形成され、中心シール部材110の残りの部分は約0.1778mm(0.007インチ)の厚みに形成される。本発明の好適な実施形態に従って厚みを開示したが、本発明の概念から逸脱することなく他の厚みを用いることもできる。補強パッド112と中心シール部材110の残りの部分との移行部は、補強パッド112と中心シール部材110の残りの部分の厚みの間に中心シール部材をテープ状にして形成することができる。更に、移行部に移行領域を設けない、すなわち明確な移行部とすることもできる。しかしながら、好適な実施形態では、応力集中部を含まずシールが良好にシールできる。また、シールセグメントは移行部のない平坦なパッドで形成することもできる。

【0042】

図7に示されているように、本発明の好適な実施形態に従えば、補強パッド112は、補強シールセグメント96によって画定された弧の中心に沿って概ね三角形の構造に形成されている。具体的には、補強パッド112は、中心シール部材110に沿って約90度の弧を占有する。当業者であれば理解できるように、本発明の概念から逸脱することなく、要求に応じて補強パッド112の形状及び大きさを様々に変えることができる。しかしながら、補強パッド112は、トロカール組立体10を通過する器具と接触する領域をカバーする形状及び大きさにすべきである。

【0043】

補強パッド112は、外科器具がトロカールカニューレ12内に挿入される時に外科器具と接触する可能性が最も高い中心シール部材110の部分に位置している。本発明の好適な実施形態に従えば、補強パッド112は中心に配置される。なぜなら、殆どの外科器具がトロカールハウジング16及びトロカールカニューレ12の中心に挿入されるためである。

【0044】

別の実施形態では、補強パッド112から中心シール部材110の基準の厚みまで傾斜した傾斜面を用いずに、補強パッド112をスムーズな曲線にして中心シール部材110の基準の厚みにスムーズに一致させることができることに留意されたい。

10

20

30

40

50

【0045】

基端側シール組立体30と挿入器具との抵抗が小さいのが望ましい。本発明の基端側シール組立体30により、シールの耐久性を損なうことなく抵抗を小さくすることができる。これは、上記したように補強パッド112を設けてシールの厚みを薄くすることで達成される。従って、従来技術のシール組立体とは異なり、器具に接触しない領域の厚みを薄くしてもシールの耐久性が損なわれない。

【0046】

本発明に従った補強パッド112を含むシール組立体は、シールセグメント96の全体の厚みを増大させずに、器具の挿入または引き戻しによるかぎ裂きや断裂を大幅に低減することができる。補強パッド112の領域が極めて厚いため、補強パッド112の器具がシール組立体98に接触する部分のテンティング(tenting)が起こらない。しかしながら、中心補強パッド112を取り囲む中心シール部材の薄い部分によって、中心シール部材110の残りの部分が容易に伸張するため、移動する器具にかかる抵抗を最小限に維持することができる。器具が存在する時に中心シール部材110の開口に沿って最も大きい応力が発生するため、好適な実施形態に従えば、補強シールセグメント96は、器具に接触していない部分は全て薄くするべきである。こすることで抵抗を小さくできる。

【0047】

本補強パッド112による効果的な保護を、以下に示す基端側シール組立体30で明らかにする。器具の先端部との最初の接触によって基端側シール組立体30が変位する場合、基端側シール組立体30の補強パッド112によって画定された領域は、補強パッド112と中心シール部材110の厚みの違いにより、補強パッド112を取り囲む中心シール部材110の薄い部分よりも比較的歪みが小さい。この歪みの差は、全体の歪みが最も大きい基端側シール組立体30が開口した時に最大である。器具との接触により補強パッド112に力が加わった場合、補強パッド112は厚みによりテンティングが起こらないが、補強パッド112によって覆われていない中心シール部材110の残りの薄い部分により、補強パッド112が先端側に容易に変位し、これにより器具の先端部が基端側シール組立体30の中心に進入できる。補強シールセグメント96は、従来のシールセグメントに比べて格段に断裂しにくくなっている。

【0048】

補強パッド112により、他の外周保護装置とは別に、鋭利な器具に対して補強シールセグメント96自体が保護される。この保護は、補強シールセグメント96に不可欠である。また、目的の位置(鋭利な器具が接触する歪みが大きい領域から離れた位置)に補強パッド112を設けることより、シールの性能に殆ど影響を与えることなく、補強パッド112が刺入から保護される。これにより、最大の器具挿入の力または器具の抵抗が増大することはない。補強パッド112を使用することで、中心位置を越えた拡張により最大の器具挿入の力及び器具の抵抗にある程度の影響を与えると考えられる。しかしながら、シールセグメント96の性質と標準的なリップシールに比べて歪みが大幅に低減されていることから、この影響は、標準的なシール組立体の性能を容易に上回るデザインが可能である。

【0049】

上記したようにシール本体98に補強パッド112を設けるが、更に、図13に最もよく示されているように基端側シール組立体30にプロテクタ92を設けるのが望ましい。本発明の好適な実施形態に従ったプロテクタ92は、シール本体92の真上に位置する。図6及び図11-図13に示されているように、プロテクタ92は、複数の重なり合ったプロテクタセグメント114からなり、編み合わせ構造に配置され完全なプロテクタ92を形成する。プロテクタ92を編み合わせ構造にすることで、追加のプロテクタ材料を追加して、器具がシール内に挿入されてプロテクタセグメント114が分離した時にシール本体98の更なる表面積を保護できるようにする。

【0050】

本発明の基端側シール組立体30が確実かつ便利に拡張する小さな中心開口を有するた

10

20

30

40

50

め、プロテクタ92は、プロテクタ92及びシール本体98を器具が通過する時のプロテクタセグメント114間の隙間を閉じるように構成しなければならない。これには、プロテクタ92の開口に沿って追加の材料が必要である。

【0051】

本発明に従えば、複数のプロテクタセグメント114を編み合わせて追加の材料をプロテクタ92に追加する。プロテクタセグメント114を編み合わせることで、追加の材料をプロテクタ92に追加して、プロテクタが円錐シール形状内に受容可能でなお各プロテクタ構成要素の幅が広くなるようにする。追加の材料は、各プロテクタセグメント114の一側について、プロテクタセグメント114の裏側で覆われる。この追加の材料は、器具が挿入されていない状態では、プロテクタセグメント114を上方から見ても確認できない。

【0052】

本発明の好適な実施形態に従ったプロテクタセグメント114は、例えば、ペレエタン(pelletthane)などの成形エラストマーから製造される。しかしながら、プロテクタセグメント114が単にエラストマーに限定されるものではなく、ここに記載する機能に必要な特性及び特徴を備えたあらゆるタイプの材料から形成できることを理解されたい。

【0053】

具体的には、4つのプロテクタセグメント114が配置されてプロテクタ92が形成される。本発明の好適な実施形態に従って4つのプロテクタセグメント114が用いられているが、本発明の概念から逸脱することなくプロテクタ92は4つ以外のプロテクタセグメント114からも形成できる。

【0054】

それぞれのプロテクタセグメント114は、上方から見ると半円形であって概ね部分円錐の形態である。これらのプロテクタセグメント114はそれぞれ、実質的に丸い外周縁116、その外周縁116から伸びた支持壁118、及び円錐形プロテクタ部材120を含む。支持壁118及び外周縁116の反対側の円錐形プロテクタ部材120が線形の縁121を画定している。

【0055】

本発明の好適な実施形態に従えば、円錐形プロテクタ部材120は、約180度の弧に亘り、支持壁118及び外周縁116は、円錐形プロテクタ部材120の中心に沿って約120度の弧に亘る。詳細は後述するが、外周縁116及び支持壁118の弧が限定されていることにより、器具が基端側シール組立体30を通過する時の不所望の力が低減される。

【0056】

外周縁116は、第1のハウジング部材36内に配置できるように適合されている。外周縁116は更に、プロテクタセグメント114の取り付け手段として機能する一連の孔122を含む。後述する開示から明らかになるが、約180度の弧を画定する複数のプロテクタセグメント114を用いて、器具が通過する時に径方向内向き及び外向きに容易に曲がる一連のプロテクタセグメント114からなるプロテクタ92を形成し、フープ応力を低減できる。

【0057】

各プロテクタセグメント114は、その両側を画定する第1の部分124及び第2の部分126を含む。4つのプロテクタセグメント114を編み合わせ構造に組み合わせて、下側のシール本体98を完全に保護する完全なプロテクタ92を形成する。すなわち、プロテクタ92は、第1のプロテクタセグメント114の第1の部分124が第2のプロテクタセグメント114の第2の部分126の上に配置され組み立てられる。続いて、第2のプロテクタセグメント114の第1の部分124が、第3のプロテクタセグメント114の第2の部分126の上に配置され、第3のプロテクタセグメントの第1の部分124が第4のプロテクタセグメント114の第2の部分126の上に配置され、第4のプロテクタセグメント114の第1の部分124が、箱の蓋の最後のフラップを折るように第1

のプロテクタセグメント 114 の第 2 の部分 126 の上に配置される。

【0058】

プロテクタセグメント 114 は、最終的にクラウン 88 と雌型保持リング 94 との間に保持される。保持部材は当業者によく知られており、本発明の概念から逸脱することなく様々な保持部材を用いることができる。

【0059】

当業者であれば、外周縁 116 及び支持壁 118 に対する円錐形プロテクタ部材 120 の動きは、結合された構成要素の様々な向きに基づく抵抗によるものであることを理解できよう。従って、円錐形プロテクタ部材 120 は、器具が基礎側シール組立体 30 を通る時に座屈する恐れがある。

10

【0060】

この動きに対する抵抗は、上記した外周縁 116 及び支持壁 118 の弧の限定によって緩和されている。加えて、この抵抗は更に、外周縁 116 及び / または支持壁 118 に形成された中心スロット 128 によって緩和されている。このスロット 128 は、プロテクタ部材 120 が小さい抵抗で同じ距離移動するため座屈を緩和する。

【0061】

プロテクタ 92 を編み合わせることで、追加の材料をそれぞれのプロテクタセグメント 114 に追加することができると共に、プロテクタ 92 の先端部を円錐形シール本体 98 の頂部内に収めることができる。これは、プロテクタセグメント 114 に追加する追加材料を、近接するプロテクタセグメント 114 の裏側に覆われるようにして達成できる。この追加材料により、特に器具が基礎側シール組立体 30 に介して所定の角度で挿入される時に、シール本体 98 をより良好に覆うことができる。最後に、器具が基礎側シール組立体 30 を通過する時に器具の抵抗に影響を与えるのであれば、プロテクタ 92 の編み合わせは最小にする。これは、プロテクタセグメント 114 が互いにに対して容易に移動するという事実の結果である。

20

【0062】

実際、それぞれのプロテクタセグメント 114 に追加された追加材料により、器具がプロテクタ 92 内に挿入されてプロテクタセグメント 114 が広がると、近接したプロテクタセグメント 114 の後側に位置する追加のプロテクタ材料が露出する。この追加の材料が、プロテクタセグメント 114 が互いにに対して曲がってもシール本体 98 を覆い続ける。挿入された器具に露出するシール本体 98 の材料が少なければ少ないほど、現在のプロテクタ 92 はより良い保護を提供する。このプロテクタ 92 は良好なシールを提供するが、追加のプロテクタセグメント 114 を追加することができる。但し、器具の抵抗が増大する可能性がある。しかしながら、これは、プロテクタセグメント 114 を薄くしてより柔軟にする或いはプロテクタセグメント 114 及び / またはシール本体 98 に潤滑材を加えてバランスをとることができる。

30

【0063】

ダックビルシール組立体

上記したように、ダックビルシール組立体 32 は、第 2 のハウジング部材 38 内に受容されている。図 14 - 図 16 に、本発明の好適な実施形態に従ったダックビルシール組立体 32 が開示されている。ダックビルシール組立体 32 は、第 2 のハウジング部材 38 内に取り付けできる形状及び大きさを有する外周フランジ部材 134 から延びた第 1 のシール本体 130 及び第 2 のシール本体 132 を含む。

40

【0064】

第 1 及び第 2 のシール本体 130、132 はそれぞれ、上面 136、138 及び下面 140、142 を含む。上面 136、138 及び下面 140、142 は概ね鏡像であり、上面 136、138 に沿った補強リブを除き、第 1 及び第 2 のシール本体 130、132 は全長に亘って実質的に同じ厚みを有する。

【0065】

第 1 及び第 2 のシール本体 130、132 は、その内部を器具が通過する時に動けるよ

50

うにトロカールハウジング16内に取り付けられている。更に、第1及び第2のシール本体130、132のそれぞれの基端部は、外周フランジ134を介してトロカールハウジング16に結合され、一方、第1及び第2のシール本体130、132の先端部は互いに当接して当接面144を画定している。当接面144は、そこを器具が通過できるようにトロカールハウジング16の概ね中心に配置されている。器具が挿入されていない場合、当接面144は、トロカール組立体10が挿入されている体内の内腔の圧力で付勢され、第1及び第2の本体130、132の弾性によって閉じている。例えば、腹腔内注入圧力による圧力で付勢されている。この圧力により、ダックビルシール組立体32が閉位置に移動して、第1及び第2のシール本体130、132の先端部が接触する。

【0066】

10

当業者であれば理解できるように、シール本体130、132は、器具に接触した時にシール本体130、132の安定性が増すように、上面136、138にリブ(不図示)を形成することができる。また、リブは、器具がダックビルシール組立体32を通過する時に接触する通路を提供する。また、リブにより、器具が接触し得る面積が小さくなっている器具がダックビルシール組立体32を通過する時の抵抗が小さくなるため、シールと器具との接触圧力を大きくすることができるようになる。

【0067】

第1及び第2のシール本体130、132は、第1のシール本体130を用いて以下に説明する。当業者であれば、第1及び第2のシール本体130、132は同一であって、以下の説明が第2のシール本体132にも同様に当てはまるこことを理解できよう。シール本体130には、互いに対し所定の角度なす第1の部分148及び第2の部分150と、外周フランジ134を通る横断面146が設けられている。具体的には、横断面146は、ダックビルシール組立体32を通る長軸に対して実質的に直交している。第1及び第2の部分148、150は、シール本体130の基端部からシール本体130の先端部に向かって延びている。従って、第1の部分148は、外周フランジ134及びトロカールハウジング16の壁部に近接したシール本体130の基端部に近接して配置されている。第1の部分148は、器具が挿入される時にわずかに動くだけである。第2の部分150は、シール本体130の先端部及び当接面144に近接して配置されている。第2の部分150は、器具が挿入される時に自由に動けるようになっている。

20

【0068】

30

一般に、第1及び第2の部分は横断面に対して0度～90度の範囲の角度をなしている。横断面146が水平面にあると仮定すると、本発明の好適な実施形態に従えば、シール本体130の基端部から始まる第1の部分148は、横断面146が延在する水平面に対して約30度の角度をなしている。シール本体130の先端部まで延在する第2の部分150は、水平面に対して約45度の角度をなしている。当業者であれば、本発明の好適な実施形態に従って開示した上記角度を、本発明の概念から逸脱することなく様々なに変更できることを理解できよう。選択した角度は、シール本体の耐久性(角度が大きいと器具がシールに刺さるように係合する可能性が低くなり、テンティングの可能性が低くなる)とシールの高さ(角度が大きくなると高くなる)のトレードオフに基づいている。例えば、本発明のダックビルシール組立体32によって得られる多くの利点を残したまま、第2の部分150を約40度～50度の範囲の角度に形成することができる。ダックビルシール組立体32の高さすなわちプロフィールを小さくすることが重要である。なぜなら、トロカールハウジング16が結果的に小さくなっている器具がアクセスし易くなるためである。小さいハウジングは、外科医が体内の内腔内に容易にアクセスすることができるため理想的である。

40

【0069】

上記した好適な実施形態は本発明を具現するために第1及び第2の部分148、150を用いているが、本発明の概念から逸脱することなく追加の部分を用いることもできる。同様に、本発明のダックビルシール本体130、132は、様々な角度に形成することができ、本発明の概念から逸脱することなく連続した曲面にすることもできる。

50

【0070】

用いる実際の壁部の構造に関係なく、壁部の角度は、通常は器具がダックビルシール組立体32のシール本体130、132と接触しない分部では小さい角度（例えば、30度）に維持し、通常は器具がシール本体130、132の壁面に接触する部分では大きい角度（例えば、45度）にすべきである。

【0071】

このように第1及び第2の部分148、150に角度を設ける、すなわちシール本体130、132に沿って壁部の角度を変えることにより、ダックビルシール本体32の全体の高さを調整しないで断裂しにくくすることができる。通常は器具がシール本体130、132に接触しない位置の壁部の角度を小さくすることにより、ダックビルシール本体32の全高さ、従ってトロカール本体10の全高さを維持したまま、適正なシール機能を得ることができる。通常は器具がシール本体130、132に接触する位置の壁部の角度を大きくすることにより、ダックビルシール組立体32に接触する垂直方向の力が小さくなり、ダックビルシール組立体32が断裂する可能性が小さくなる。

【0072】

上記したように、トロカールスリーブ44の高さは、アーゴノミックスに与える影響から極めて重要な問題である。同時に、トロカールスリーブ44の高さを低くするという要求に対して、ダックビルの抵抗、耐久性、及びシール機能のバランスを取らなければならぬ。

【0073】

本発明のダックビルシール組立体32に従って最適なデザインを提供するために、ダックビルシール組立体32の高さを2つの壁部の角度を用いて最小にする。第1の部分148に沿った壁部の角度は、高さを最小にするために小さい。所定の臨界直径では、壁部の角度は第2の部分150で急になる。この急な壁部により、挿入される器具に対するアタック角度が小さくなり、耐久性が向上している。同時に、第1の部分148の角度よりも急な壁部によりアタック角度が小さく第2の部分に作用する腹部注入流体圧力による閉止する力が大きいため、シール機能が改善されている。

【0074】

複数の角度のデザインによって得られる利点にもかかわらず、ダックビルシール組立体32と器具との間の力を更に小さくしなければならない。これは、壁部の厚み、リブの形状、及び表面コーティングの調節によって対応できる。外科医がトロカールスリーブ44に対して器具を挿入したり引き抜いたりする際に必要な操作が容易になるように抵抗を小さくするのが望ましい。操作を容易にするには、片手で器具の挿入または抜き取りができるのが好ましい。また、これによりトロカール組立体10が挿入されている患者からトロカールスリーブ44が抜けにくくなる。

【0075】

上記したように、好適な実施形態に従って30度と45度の角度を用いるが、直径の大きな器具が必要な場合は、直径の大きなダックビルシール組立体32が必要になる。弁、具体的にはトロカール組立体と用いるダックビルシール組立体32を設ける場合、通常はスペースが貴重であるため、高さを最小限にすることが重要である。シールの耐久性が最優先されるため、45度の角度を用いて器具を挿入または引き抜く際のシール本体130、132の断裂を最小限にする。

【0076】

好適な実施形態に従えば、ダックビルシール組立体32は、限定するものではないが、ポリイソブレンまたはシリコーンなどの架橋ポリマーまたはエラストマーである。

【0077】

内視鏡固定用組立体

本発明の背景の部分で記載したように、具体的にはオブチュレータ14であるトロカール組立体10に対して内視鏡を所定の位置に固定するのが望ましい。このような内視鏡固定用組立体152が、図3、図4、及び図25に示されているように本発明に従って設け

10

20

30

40

50

られている。内視鏡固定用組立体 152 は通常、トロカール組立体 10 の挿入中に内視鏡をトロカールスリープ 44 及び / またはオブチュレータ 14 内に保持するカム機構を含む。カム機構は、カムを用いて弾性ロック 154 を内視鏡に対して圧迫する。弾性ロック 154 は内視鏡をしっかりと把持して、トロカール組立体の挿入中、外科医が組織層を視覚化している時に内視鏡が不所望に移動しないようにする。カム機構は、トルクと軸方向の荷重の両方に耐えて内視鏡を保持し、カムレバー 156 を繰り返し作動させた後も適当に内視鏡を保持し、小さな人間工学的な力でカムレバー 156 を作動させ、様々な大きさの内視鏡に対応し、直感的な使用を容易にし、長期保管しても安定している。

【 0 0 7 8 】

トロカール組立体 10 内に内視鏡を保持するカム機構は、カム面 158 を用いて弾性ロック 154 を内視鏡に対して圧迫する。弾性ロック 154 が内視鏡をしっかりと把持して、トロカール組立体の挿入中、外科医が組織層を視覚化している時に内視鏡の不所望の動きを防止する。

【 0 0 7 9 】

固定用組立体 152 は、チューブ 162 が延びたハウジング 160 を含む。チューブ 162 は、内部を貫通する開口に整合している。チューブは、尖った先端部を備え、本発明に従ったオブチュレータとして用いることができる。チューブ 162 及び開口は、内部を内視鏡が通ることができる形状及び大きさを有する。加えて、チューブ 162 は、内視鏡を使用するためにチューブ 162 を含む固定用組立体 152 をトロカールスリープ 44 に選択的に固定できるように、トロカールカニューレ 12 が内部を通れる形状及び大きさを有する。

【 0 0 8 0 】

トロカールの第 1 のハウジング部材 36 に対する固定用組立体 152 の取り付けは、第 1 のハウジング部材 36 の上面 168 及び固定用組立体ハウジング 160 の下側の両方に形成された噛合いラッチ 164、166 によって達成できる。ラッチ 164、166 により、トロカールハウジング 16 に対する固定用組立体 152 の選択的な取り付け及び取り外しが可能となる。本発明の好適な実施形態に従った特定のラッチ構造を開示するが、本発明の概念から逸脱することなく他のラッチ構造も用いることができる。

【 0 0 8 1 】

固定用組立体ハウジング 160 は、カム動作に基づいた固定機構を含む。この固定機構は、カムレバー 156 と弾性ロック 154 とからなる。カムレバー 156 は、ハウジング 160 に回動可能に取り付けられた第 1 の端部 170 及び使用者が作動させることができるように適合された自由な第 2 の端部 172 を含む。実際には、カムレバー 156 は、内側に回動した固定位置と外側に回動した解放位置との間で自由に移動することができる。

【 0 0 8 2 】

本発明に従ったカム動作は、カムレバー 156 の第 1 の端部 170 に近接したカム面 158 によって得られる。カム面 158 は、固定用組立体 152 内の内視鏡を選択的に固定するべく弾性ロック 154 に係合できる形状及び大きさを有する。弾性ロック 154 について述べると、弾性ロック 154 は、固定用組立体ハウジング 160 の本体内に受容され、ハウジング開口内を通る内視鏡に係合できる形状及び大きさを有する前方に凹状の壁部 174 を含む。弾性ロック 154 は更に、第 1 の側壁 176 及び第 2 の側壁 178 を含み、側壁 176、178 のそれぞれは、ハウジング 160 の本体内に形成された溝 182 に係合するノッチ 180 を含む。溝 182 とノッチ 180 は相互作用して、詳細を後述する要領で弾性ロック 154 を横方向に移動させることができる。ハウジング 160 は更に、ハウジング 160 内の弾性ロック 154 の上下方向の移動を確実に防止するための上部保持部材 184 及び下部保持部材 186 を含む。最後に、弾性ロック 154 は、前方に凹状の壁部 174 の反対側に後部壁 188 を含む。後部壁 188 は、カムレバー 156 のカム面 158 に係合できる形状及び大きさを有する。

【 0 0 8 3 】

10

20

30

40

50

弾性ブロック 154 及びカム面 158 は、強い接触を排除する、具体的には、内視鏡が固定用組立体ハウジング 160 の開口内に配置されるまで弾性ブロック 154 とカム面 158 との如何なる接触も排除する形状を有する。詳細は後述するが、内視鏡が固定用組立体ハウジング 160 の内腔内に配置されている場合、カムレバーが作動すると、弾性ブロック 154 がカムレバー 156 に対して移動し、弾性ブロック 154 がカム面 158 に近接して内視鏡が開口内に固定される。

【0084】

実際には、固定用組立体 152 を以下のように用いる。弾性ブロック 154 は、長期保存の際に開または閉にしておくことができるカムレバー 156 の下側の固定用組立体ハウジング 160 内に受容されている。この時、長期保存によって固定用組立体 152 の性能を損ねるような弾性ブロック 154 に対するあらゆる荷重を排除するために、弾性ブロックが意図的にカムレバー 156 から離されている。外科医が、カムレバー 156 が始めに閉じている場合は、そのカムレバー 156 を開にする。次いで、内視鏡を固定用組立体 152 内に挿入する。内視鏡が、弾性ブロック 154 の凹状壁部 174 の面取り面 190 に接触する。これにより、弾性ブロック 154 がカムレバー 156 の近傍に向かって移動する。次いで、弾性ブロック 154 が、内視鏡の残りの部分を使用するためにその上部に配置される。次いで、カムレバー 156 を作動させ、圧縮可能な内視鏡ロックを内視鏡に対して圧迫する。弾性ブロック 154 のコンプライアンス及び高い摩擦係数により、必要な人間工学的な力を最小になると共に、固定用組立体 152 を様々な大きさの内視鏡に用いることができる。弾性ブロック 154 は、内視鏡に対して軸方向の荷重及び捩じり荷重がかかった場合、弾性ブロック 154 の移動を制限する周囲の構成要素 182、184、186 によって過度な横方向及び軸方向への移動が制限される。この制限とオーバーセンターのカムデザインにより、カムレバーが誤って解除されるのが防止されている。トロカール組立体 10 を患者の体内に挿入したら、カムレバー 156 を開にして内視鏡を取り出す。次いで、外科医が再び内視鏡を後に挿入したい場合は、弾性ブロック 154 を固定用組立体 152 の元に位置に戻すことができる。コンプライアントな弾性ブロック 154 は、カムレバー 156 による荷重が取り除かれると元の形状に戻るのに十分な剛性を有しているため、レバーを何回操作しても内視鏡を適切に保持することができる。

【0085】

トロカールスリーブ及びストップコック弁の構造

上記したように、トロカールスリーブ 44 は、トロカールハウジング 16 とそこから伸びたトロカールカニューレ 12 とからなる。トロカール組立体 10 は、ストップコック弁 192 を含む。このストップコック弁 192 により、二酸化炭素などの注入流体を可撓性チューブを介してトロカールカニューレ 12 及びトロカールハウジング 16 の一部の中へ送る通路を確立または遮断する。

【0086】

図面を参照すると、トロカールカニューレ 12 及びトロカールハウジング 16 が互いに機械的に結合され、トロカールスリーブ 44 が形成されている。トロカールカニューレ 12 の少なくとも一部が第 2 のハウジング部材 38 の第 2 のハウジング部材ベース 38b 内に受容されており、第 2 のハウジング部材カバー 38a が、トロカールカニューレ 12 の少なくとも一部を第 2 のハウジング部材ベース 38b 内に固定するためにトロカールカニューレ 12 の上に配置されている。

【0087】

トロカールカニューレ 12 は、トロカールオブチュレータ 14 がトロカールカニューレ 12 を完全に貫通して延出した時に、ストップコック弁 192 及びトロカールハウジング 16 を通る注入流体がトロカールカニューレ 12 とトロカールオブチュレータ 14 との間に形成された環状の開口を通過できるような大きさを有する。この環状の開口は、トロカールカニューレ 12 の内径がトロカールオブチュレータ 14 の中空シャフトの外径よりもわずかに大きいことで形成される。

【0088】

10

20

30

40

50

本発明は、接着剤及び／または硬化技術を用いないでトロカールカニユーレ12、トロカールハウジング16、及びストップコック弁192を機械的に組み立てる機構を提供する。具体的には、トロカールハウジング16の第2のハウジング部材38、トロカールカニユーレ12、及びストップコック弁192が便利で確実に組み立てできる別々の部品として形成される。

【0089】

より具体的には、図17-図20に、機械的に組み立てられたトロカールスリーブ44の好適な実施形態が開示されている。完全に組み立てられると、トロカールスリーブ44は、ストップコック弁192と、第2のハウジング部材カバー38a及び第2のハウジング部材ベース38bからなる第2のハウジング部材38と、トロカールカニユーレ12とを含む。詳細は後述するが、トロカールスリーブ44の様々な構成要素を互いに結合させて機械的に組み立てる。簡単に述べると、トロカールカニユーレ12が第2のハウジング部材ベース38b内に嵌合し、それらの間にストップコック弁192が配置される。第2のハウジング部材カバー38aが、様々な構成要素が互いに保持するようにストップコック弁192、第2のハウジング部材ベース38b、及びトロカールカニユーレ12に適合し、第1のハウジング部材36が選択的に取り付けられる表面を提供する。

【0090】

トロカールスリーブ44を構成する特定の構成要素について述べると、本発明の好適な実施形態に従えば、ストップコック弁192は、整合ウイング194、開口196、及び弁レバー198を含む。弁レバー198はストッパー ラッチ200を含む。第2のハウジング部材カバー38aは、六角孔202、カバーリム204、及び第2のハウジング部材カバーシール206を含む。第2のハウジング部材ベース38bは、係合ポスト208、ベーン210、ハウジングリム212、ストップコック弁192のためのスペース214、及び整合ウイング194を含む。第2のハウジング部材ベース38bは更に、整合リブ216及びラッチ面218を含む。トロカールカニユーレ12は、入口ニップル220、整合タブ222、及びハウジングシール224を含む。

【0091】

実際には、ストップコック弁192を第2のハウジング部材ベース38bのスペース214内に挿入する。トロカールカニユーレ12を第2のハウジング部材ベース38bの開口内に挿入する。トロカールカニユーレ12が第2のハウジング部材ベース38b内に挿入されたら、整合タブ222を、トロカールカニユーレ12を第2のハウジング部材ベース38bに対して所望の向きに固定するベーン210に当接させる。

【0092】

カバーリム204をハウジングリム212に一致させる。カバーリム204は、ストップコック弁192の上の弁レバー198を保持し、弁レバー198が所定の位置でストップコック弁192を保持する。

【0093】

流量が最大の位置すなわち完全な開位置にある弁レバー198では、ストッパー ラッチ200が第2のハウジング部材ベース38bのラッチ面218に当接している。つまり、弁レバー198の操作者は、ラッチ面218と弁レバー198が完全な開位置で当接して止まるため弁レバー198が完全な開位置であることを感じ取ることができる。操作者は、弁レバー198が完全な開位置にあるか否かを推測する必要がなく、弁レバー198が完全な開位置で停止する。

【0094】

トロカール組立体44の構造により、ストップコック弁192と第2のハウジング部材カバー38aの結合、及び第2のハウジング部材ベース38bとトロカールカニユーレ12の結合に接着剤が必要ではない。これは従来技術よりも有利である。

【0095】

図21及び図22を参照すると、代替のトロカールスリーブ44'が開示されている。この代替の実施形態に従えば、トロカールスリーブ44'は、ストップコック弁192'、

10

20

30

40

50

、第2のハウジング部材カバー38a'、及び第2のハウジング部材ベース38b'を含む。トロカール44'は、前述の実施形態に従って開示されたトロカールカニューレ12に実質的に類似したトロカールカニューレ12'を含む。

【0096】

ストップコック弁192'は、弁チューブテープ状固定延長部226'、係合ポスト228'、及び弁レバー198'を含む。第2のハウジング部材ベース38b'は、延長部用スペース230'、及び係合ポスト用の六角孔232'を含む。

【0097】

ストップコック弁192'の弁チューブテープ状固定延長部226'は、第2のハウジング部材ベース38b'の延長部用スペース230'内に固定される。ストップコック弁192'の係合ポスト228'は、第2のハウジング部材ベース38b'の係合ポスト用六角孔232'内に嵌合し、ストップコック弁192'が第2のハウジング部材ベース38b'に対して垂直方向に整合して固定される。

【0098】

図23及び図24を参照すると、更なる実施形態が開示されている。この更なる実施形態に従えば、トロカールスリープ44'は、第2のハウジング部材カバー38a'、第2のハウジング部材ベース38b'、及びストップコック弁192'を含む。トロカールスリープ44'はまた、前述の実施形態に従って開示されたトロカールカニューレ12に実質的に類似したトロカールカニューレ12'も含む。

【0099】

ストップコック弁192'は、固定グループボス234'、弁チューブ延長部226'、及び固定グループ238'を含む。加えて、第2のハウジング部材カバー38a'は固定タング240'を含む。第2のハウジング部材ベース38b'は、弁チューブ延長部開口242'及びボススペース244'も含む。ストップコック弁192'の弁チューブ延長部226'は、第2のハウジング部材ベース38b'の弁チューブ延長部開口242'内に挿入され、摩擦嵌合またはテープ嵌合によって固定される。ストップコック弁192'の固定グループボス234'は、ボススペース244'内に固定される。これにより、ストップコック弁192'が第2のハウジング部材ベース38b'に固定される。

【0100】

上記したように、ストップコック弁192は、嵌合する大きさ及び形状を有するテープ状の表面によってトロカールスリープ44に機械的に結合する。従って、ストップコック弁192の外側チューブ250に、先端部の外面に沿ってテープ状の固定用表面が設かれている。同様に、トロカールカニューレ12には、ストップコック弁192の外側チューブ250のテープ状固定用表面に確実に結合するように適合された入口ニップル220が設かれている。テープ状固定機構の構造は、トロカールハウジングの入口ニップル220内に確実に固定される角度が2.0度+/-1.0度の自己保持構造を含む。このような機械的な結合により、回す力または直線的に引張る力に対する相当な摩擦抵抗が得られる。

【0101】

上記した機械的な固定は、二重構造にして強化することができる。例えば、ポストと六角ソケットのインターロック、タングとグループのインターロック、及び/またはスナップ嵌めのインターロックを設けることができる。

【0102】

加えて、図18を参照して説明した実施形態に従えば、ストップコック弁192の回動を最小にするために、弁レバー198の上部に形成された開口256内に挿入される保持ピン204を第2のハウジング部材カバー38aに設けることができる。保持ピン204は、ストップコック弁192を安定させ、弁レバー198が作動する時のストップコック弁192の回動を防止する。

【0103】

10

20

30

40

50

上記したように、トロカールスリープはストップコック弁192を含む。ストップコック弁192は、トロカールスリープ44に形成された凹部内に取り付けられている。従つて、ストップコック弁192は、第2のハウジング部材ベース38bの外面の内側に受容され、トロカールハウジング16内に受容される。更に、弁レバー198がストップコック弁192の本体の上に位置している。すなわち、ストップコック弁192の動作に用いられる弁レバー198が、下側に位置する現在市販されているトロカール組立体とは異なり、ストップコック弁192の上面に配置されている。嵌め込まれたストップコック弁192の上に弁レバー198が配置されているため、本発明のトロカール組立体10では、弁レバー198が非常に操作し易い位置に配置されていると同時に、ストップコック弁192が視界を遮っていない。

10

20

【0104】
ストップコック弁192をトロカールスリープ44の本体内に嵌め込むことにより幾つかの利点が得られる。第1に、この配置により、使用者が挿入するためにトロカール組立体10のストップコック弁192を保持する際に邪魔にならない。また、ストップコック弁192がトロカールハウジング12の外面から突き出でていないため、より快適に保持することができる。更に、本発明の目立たないストップコック弁192の構造により、手を所望の位置に置くことができる。本発明のストップコック弁192の配置により、使用中に誤った操作が起こらない。誤った操作すなわちトロカールスリープ44と患者の接触がよく起こり、体の腔内に注入された流体が流出し、外科医の視野が狭くなつて危険な状態になることもある。

20

30

【0105】
トロカールハウジング16の外面に実質的に一致する曲線状の表面を備えた弁レバー198を形成して更なる利点を得ることができる。加えて、弁レバー198のハンドル部分に沿った長軸は、ストップコック弁192を嵌め込み易いように、弁レバー198の回動点からずれている。ストップコック弁192の弁レバー198の回動の制御は、具体的にはトロカールハウジング16であるトロカールスリープ44に形成された凹部内にストップコック弁192を配置して達成できる。特に図17-図20に示されているように、ストップコック弁192の弁レバー198には、弁レバー198が開位置にあるか否かすなわち弁レバー198に設けられた貫通孔が弁本体199に整合しているか否かを触覚で確認できるストッパーラッチ200が設けられている。このデザイン構造は、使用者の反対側の弁レバー198の端部に位置するカンチレバーに類似している。

30

40

【0106】
弁レバー198がトロカール組立体10内で閉位置から開位置に回動すると、カンチレバー回動ストッパーラッチ200がトロカールハウジング16に接触するため、弁レバー198が完全な開位置にあることを触覚で確認できる。完全な開位置では、弁レバー198及び弁本体199の貫通孔は整合して最適なCO₂の流れが得られる。

40

【0107】
カンチレバー回動ストッパーラッチ200の構造により、ストップコック弁192が開位置にあることを外科医が触覚で確認できる。これにより外科処置の間、最適なCO₂の流れを得ることができる。

40

【0108】
当業者であれば分かるように、カンチレバー回動ストッパーラッチ200による弁レバー198の制御によってストップコック弁192の貫通孔196の整合が容易である。貫通孔196の不整合は、弁レバー198が完全な開位置にあることを外科医が触覚で確認できないことによる場合が多い。

50

【0109】
加えて、図17及び図18に示されているように、強化ガセット264がカンチレバー回動ストッパーラッチ200の裏側に配置されており、弁レバー198を曲げた時に過度に回動しないようになっている。過度な回動は、貫通孔の不整合を引き起こす。

50

【0110】

当業者であれば分かるように、上記したデザインは従来技術の組立体に比べ多くの利点を提供する。上記した分離できるトロカールカニューレ12のデザインにより、外側ハウジングを交換することができる。従って、外側形状の工業的デザインは、トロカールスリーブの内部構造を変えなくても簡単に変更して最新のものにすることができる。加えて、トロカールカニューレ12とトロカールハウジング16との組み立てには超音波溶接が必要ではない。本発明の組立方法は、トロカールカニューレ12を1つの部品として成形することで装置を強化している。当業者には明らかなように、従来のデザインは超音波溶接を利用してトロカールカニューレ12をトロカールハウジング16に結合する。本発明の組立体の構造では、このような接合が必要なく、超音波溶接による接合不良が起こらない。

10

【0111】

加えて、トロカールハウジング16には、内面に沿ってクラッシュリブ266が設けられている。これらのクラッシュリブ266により、トロカールカニューレ12がトロカールハウジング16の中心に配置される。また、クラッシュリブ266の許容誤差のばらつきを小さくし、製造中のトロカールカニューレ12の大きさの重要性を低くし、成形工程による固有のばらつきを可能にしている。

【0112】

更にクラッシュリブ266が、トロカールハウジング16内のトロカールカニューレ12の回動を防止している。これは、トロカールカニューレ12の両側に延在するクラッシュリブ266によりトロカールカニューレ12とトロカールハウジング16との相対的回動が防止されて達成される。

20

【0113】

トロカールハウジング16及びトロカールカニューレ12は構造が比較的単純であるため、射出成形器具の過度に細かな部分を排除して成形工程を単純にできる。加えて、システムの組み立ては、スリーブ組立体の全ての構成要素をトップダウン式に組み立てできるため従来のデザインよりも容易である。

20

【0114】

トップコック弁において、二重固定構造を備えたテープ固定は、トップコック弁192がトロカールスリーブ144から脱落するのを防止する。加えて、テープ固定により、接着剤や溶接を用いなくても気密組み立てが可能となる。加えて、トップコック弁192は、例えば、ポストヒソケット、タンゲとグループ、及びウイングヒリブなどのトップコック弁192の回動を防止する様々な固定表面を備えることができる。テープ固定構造に加えて、ウイングをトロカールハウジング16の後側でテープ状にして、トップコック弁192がトロカールスリーブ44から抜けないようにできる。加えて、クラッシュリブ226を用いて、ウイングをトロカールカニューレ12にしっかりと保持することができる。最後に、弁レバー198が上に配置された目立たないトップコック弁192の構造により、最適な気流が得られる、使用者が触覚で整合を確認できるトップコック弁192の整合が可能になる。

30

【0115】

好適な実施形態を用いて説明してきたが、このような開示により本発明を限定する意図はなく、むしろ、添付の特許請求の範囲で規定された本発明の概念及び範囲内にあらゆる変形態及び代替形態の構造が含まれることを意図するものである。

40

【0116】

本発明の実施態様は以下の通りである。

(1) 前記弾性プロックが前記開口に近接した前方に凹状の壁部を含み、前記弾性プロックが、前記固定用組立体ハウジングの前記開口を通る器具に係合できる形状及び大きさを有することを特徴とする請求項1に記載の固定用組立体。

(2) 前記弾性プロックが、前記固定用組立体ハウジングを通る器具に係合できる形状及び大きさを有する面取りされた上面を含み、これにより前記弾性プロックと前記器具との接触によって前記弾性プロックが前記カム面に接触し、前記カムレバーを操作して前記

50

器具を前記固定用組立体内に固定できることを特徴とする請求項1に記載の固定用組立体。

(3) 前記固定用組立体ハウジングが、その中の前記弾性ブロックの動きを制御するために保持部材を含むことを特徴とする請求項1に記載の固定用組立体。

(4) 前記弾性ブロックが、前記固定用組立体ハウジングに対して前記弾性ブロックの動きを制御するために前記固定用組立体ハウジングに形成された溝の中に配置できる形状及び大きさを有するノッチを含むことを特徴とする実施態様(3)に記載の固定用組立体。

(5) 前記固定用組立体ハウジングが、そこから延びて前記トロカールスリーブ内に延在するチューブを含むことを特徴とする請求項1に記載の固定用組立体。 10

【0117】

(6) 前記チューブが丸い先端部を備え、オブチュレータとして用いることができるこことを特徴とする実施態様(5)に記載の固定用組立体。

(7) 前記チューブ及び前記開口が、内部に内視鏡を通すことができる形状及び大きさを有することを特徴とする実施態様(5)に記載の固定用組立体。

(8) 前記チューブが前記トロカールスリーブ内に延在できる形状及び大きさを有するため、前記固定用組立体をトロカールスリーブに選択的に固定して内視鏡を使用できることを特徴とする実施態様(5)に記載の固定用組立体。

(9) 前記固定用組立体ハウジングがトロカールスリーブに選択的に固定するためのラッチ構造を含むことを特徴とする請求項1に記載の固定用組立体。 20

(10) トロカールスリーブに用いるオブチュレータであって、先端部、基端部、及び内部に延在する通路を有するシャフトと、前記シャフトの前記基端部の器具固定装置とを含み、前記器具固定装置が、器具が前記通路内に挿入され固定された時に前記器具に当接させる圧縮可能な材料を含むことを特徴とするオブチュレータ。 20

【0118】

(11) 前記器具固定装置が、内部を貫通する開口を備えた固定用組立体ハウジングを含むことを特徴とする実施態様(10)に記載のオブチュレータ。

(12) 前記器具固定装置が更にカムレバーを含み、弾性ブロックである前記圧縮可能な材料が、前記固定用組立体ハウジング内に配置されており、前記カムレバーが、前記固定用組立体ハウジングに回動可能に取り付けられた第1の端部と、使用者が操作できるように適合された自由な第2の端部とを含み、前記カムレバーを回動させて、前記弾性ブロックを前記固定用組立体ハウジング内を通る器具に係合させて前記器具を前記固定用組立体ハウジングに固定できることを特徴とする実施態様(11)に記載のオブチュレータ。 30

(13) 前記カムレバーが、その前記第1の端部に近接したカム面を含み、前記カム面が、前記固定用組立体ハウジングを通る器具と係合できるように前記弾性ブロックに選択に係合する形状及び大きさを有することを特徴とする実施態様(12)に記載のオブチュレータ。

(14) 前記カム面が、器具が前記固定用組立体ハウジング内にある時にのみ、付勢により前記弾性ブロックに接触するようにし、前記固定用組立体が使用されていない時は前記弾性ブロックに対して加えられる力を最小限にすることを特徴とする実施態様(12)に記載のオブチュレータ。 40

(15) 前記弾性ブロックが前記開口に近接した前方に凹状の壁部を含み、前記弾性ブロックが、前記固定用組立体ハウジングの前記開口を通る器具に係合できる形状及び大きさを有することを特徴とする実施態様(12)に記載のオブチュレータ。

【0119】

(16) 前記弾性ブロックが、前記固定用組立体ハウジングを通る器具に係合できる形状及び大きさを有する面取りされた上面を含み、これにより前記弾性ブロックと前記器具との接触によって前記弾性ブロックが前記カム面に接触し、前記カムレバーを操作して前記器具を前記固定用組立体内に固定できることを特徴とする実施態様(12)に記載のオブチュレータ。 50

(17) 前記固定用組立体ハウジングが、その中の前記弾性ブロックの動きを制御するために保持部材を含むことを特徴とする実施態様(12)に記載のオプチュレータ。

(18) 前記弾性ブロックが、前記固定用組立体ハウジングに対して前記弾性ブロックの動きを制御するために前記固定用組立体ハウジングに形成された溝の中に配置できる形状及び大きさを有するノッチを含むことを特徴とする実施態様(17)に記載のオプチュレータ。

(19) 前記固定用組立体ハウジングがトロカールスリーブに選択的に取り付けるためのラッチ構造を含むことを特徴とする実施態様(12)に記載のオプチュレータ。

(20) トロカールに用いる器具固定装置であって、内部を貫通する通路を有するハウジングと、器具が前記通路内に挿入され固定された時に前記器具に選択的に当接させるために前記ハウジング内に配置された圧縮可能な材料とを含むことを特徴とする器具固定装置。

【0120】

(21) 前記器具固定装置が更にカムレバーを含み、前記圧縮可能な材料が前記ハウジング内に配置された弾性ブロックであり、前記カムレバーが、前記ハウジングに回動可能に取り付けられた第1の端部と、使用者が操作できるように適合された自由な第2の端部とを含み、前記カムレバーを回動させて、前記弾性ブロックを前記ハウジング内を通る器具に係合させて前記器具を前記ハウジングに固定できることを特徴とする実施態様(20)に記載の器具固定装置。

(22) 前記カムレバーが、その前記第1の端部に近接したカム面を含み、前記カム面が、前記ハウジングを通る器具と係合できるように前記弾性ブロックに選択に係合する形状及び大きさを有することを特徴とする実施態様(21)に記載の器具固定装置。

(23) 前記カム面が、器具が前記ハウジング内にある時にのみ、付勢により前記弾性ブロックに接触するようにし、前記固定用組立体が使用されていない時は前記弾性ブロックに対して加えられる力を最小限にすることを特徴とする実施態様(21)に記載の器具固定装置。

(24) 前記弾性ブロックが前記開口に近接した前方に凹状の壁部を含み、前記弾性ブロックが、前記ハウジングの前記開口を通る器具に係合できる形状及び大きさを有することを特徴とする実施態様(21)に記載の器具固定装置。

(25) 前記弾性ブロックが、前記ハウジングを通る器具に係合できる形状及び大きさを有する面取りされた上面を含み、これにより前記弾性ブロックと前記器具との接触によって前記弾性ブロックが前記カム面に接触し、前記カムレバーを操作して前記器具を前記固定用組立体内に固定できることを特徴とする実施態様(21)に記載の器具固定装置。

【0121】

(26) 前記ハウジングが、その中の前記弾性ブロックの動きを制御するために保持部材を含むことを特徴とする実施態様(21)に記載の器具固定装置。

(27) 前記弾性ブロックが、前記ハウジングに対して前記弾性ブロックの動きを制御するために前記ハウジングに形成された溝の中に配置できる形状及び大きさを有するノッチを含むことを特徴とする実施態様(26)に記載の器具固定装置。

(28) 前記ハウジングが、そこから延びて前記トロカールスリーブ内に延在するチューブを含むことを特徴とする実施態様(21)に記載の器具固定装置。

(29) 前記チューブが丸い先端部を備え、オプチュレータとして用いることができる特徴とする実施態様(28)に記載の器具固定装置。

(30) 前記チューブ及び前記開口が、内部に内視鏡を通すことができる形状及び大きさを有することを特徴とする実施態様(28)に記載の器具固定装置。

【0122】

(31) 前記ハウジングがトロカールスリーブに選択的に固定するためのラッチ構造を含むことを特徴とする実施態様(21)に記載の器具固定装置。

【図面の簡単な説明】

【0123】

10

20

30

40

50

【図1】本発明に従ったトロカール組立体の斜視図である。

【図2】図1に示されているトロカール組立体の組立分解図である。

【図3】図1に示されているようにトロカール組立体の断面図である。

【図4】図1に示されているようにトロカール組立体の組立分解断面図である。

【図5】本発明のトロカール組立体に従って用いられるロータリーラッチ機構の詳細図である。

【図6】本発明のトロカール組立体に従った基端側シール組立体の組立分解図である。

【図7】シールセグメントの底部からの斜視図である。

【図8】シールセグメントの平面図である。

【図9】図8の線IX-IXに沿って見た断面図である。

10

【図10】図7-図9に示されている4つのシールセグメントからなるシール本体の斜視図である。

【図11】プロテクタセグメントの上方からの斜視図である。

【図12】プロテクタセグメントの底面図である。

【図13】図11及び図12に示されているプロテクタセグメント4つからなるプロテクタを示す平面図である。

【図14】本発明に従ったダックビルシール組立体の上方からの斜視図である。

【図15】図14の線XV-XVに沿って見た断面図である。

【図16】図14の線XV-XVに沿って見た部分断面図である。

【図17】本発明に従ったトロカールスリーブの組立分解図である。

20

【図18】本発明に従ったトロカールスリーブの更なる組立分解図である。

【図19】図17及び図18に示されているトロカールスリーブの組み立てられた後の斜視図である。

【図20】図17及び図18に示されているトロカールスリーブの後部からの斜視図である。

【図21】トロカールスリーブの代替の実施形態に従った組立分解図である。

【図22】図19に示されているトロカールスリーブの代替の実施形態に従った部分組立分解図である。

【図23】トロカールスリーブの更なる実施形態の組立分解図である。

【図24】トロカールスリーブの更なる実施形態の上方からの斜視図である。

30

【図25】内視鏡固定機構の詳細図である。

【符号の説明】

【0124】

10 トロカール組立体

12、12'、12'' トロカールカニューレ

14 トロカールオブチュレータ

16 トロカールハウジング

20 カニューレの開口した先端部分

22 カニューレ基端部分

24 ハウジング先端部分

40

26 ハウジング基端部分

28 開口

30 基端側シール組立体

32 ダックビルシール組立体

34 オブチュレータハンドル

36 第1のハウジング部材

38 第2のハウジング部材

38a、38a'、38a'' ハウジング部材カバー

38b、38b'、38b'' ハウジング部材ベース


40、42 開口

50


4 4 、 4 4 ' 、 4 4 ''	トロカールスリーブ	
5 0	第 2 のハウジング部材上面	
5 2	外周リム	
5 4	第 1 のハウジング部材下面	
5 8	第 1 及び第 2 のアーム	
6 0	下側を向いたカム面	
6 2	ラッチ面	
6 4	ラッチリング	
6 6	第 1 及び第 2 のラッチ部材	
6 8	環状溝	10
7 0	ばね	
7 2	上側を向いたカム面	
7 6	孔	
7 8	レバー	
8 0	フランジ	
8 2	整合ピン	
8 4	孔	
8 6	キャップ	
8 8	クラウン	
9 0	ベロー	20
9 2	プロテクタ	
9 4	雌型保持リング	
9 6	補強シールセグメント	
9 8	シール本体	
1 0 0	雄型保持リング	
1 0 8	外周縁	
1 1 0	中心シール部材	
1 1 2	補強パッド	
1 1 4	プロテクタセグメント	
1 1 6	外周縁	30
1 1 8	支持壁	
1 2 0	円錐形プロテクタ部材	
1 2 2	孔	
1 2 4	プロテクタセグメントの第 1 の部分	
1 2 6	プロテクタセグメントの第 2 の部分	
1 2 8	スロット	
1 3 0	第 1 のシール本体	
1 3 2	第 2 のシール本体	
1 3 4	外周フランジ部材	
1 3 6 、 1 3 8	シール上面	40
1 4 0 、 1 4 2	シール下面	
1 4 4	当接面	
1 4 6	横断面	
1 4 8	シール本体の第 1 の部分	
1 5 0	シール本体の第 2 の部分	
1 5 2	内視鏡固定用組立体	
1 5 4	弾性ブロック	
1 5 6	カムレバー	
1 5 8	カム面	
1 6 0	固定用組立体ハウジング	50

1 6 2	チューブ	
1 6 4、1 6 6	噛合いラッチ	
1 6 8	第1のハウジング部材上面	
1 7 4	凹状壁部	
1 7 6	第1の側壁	
1 7 8	第2の側壁	
1 8 0	ノッチ	
1 8 2	溝	
1 8 4	上部保持部材	
1 8 6	下部保持部材	10
1 8 8	後部壁	
1 9 0	面取り面	
1 9 2、1 9 2'、1 9 2''	ストップコック弁	
1 9 4	整合ウイング	
1 9 8、1 9 8'	弁レバー	
2 0 0	ストッパー ラッチ	
2 0 2	六角孔	
2 0 4	カバーリム	
2 0 6	カバーシール	
2 0 8	係合ポスト	20
2 1 0	ペーン	
2 1 2	ハウジングリム	
2 1 4	スペース	
2 1 6	整合リブ	
2 1 8	ラッチ面	
2 2 0	入口ニップル	
2 2 2	整合タブ	
2 2 4	ハウジングシール	
2 2 6'、2 2 6''	弁チューブテープ状固定延長部	
2 3 0'	延長部用スペース	30
2 3 2'	六角孔	
2 3 4'	固定グループボス	
2 4 0'	固定タング	
2 4 4'	ボススペース	
2 5 0	外側チューブ	
2 5 6	開口	
2 6 4	強化ガセット	
2 6 6	クラッシュリブ	


【図1】

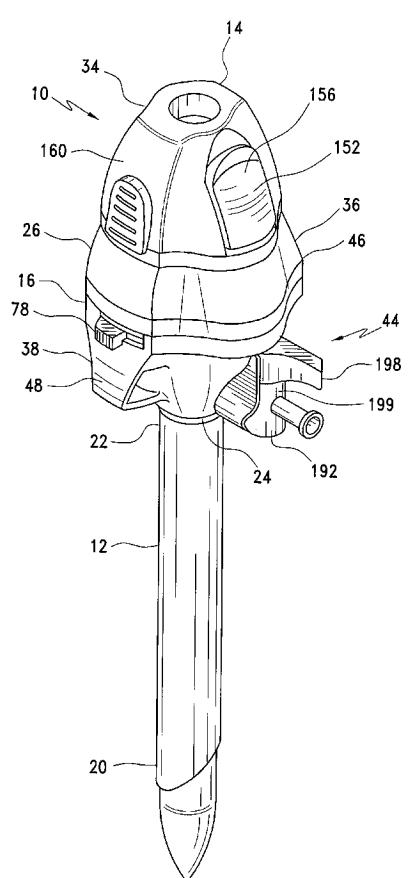


【 图 2 】

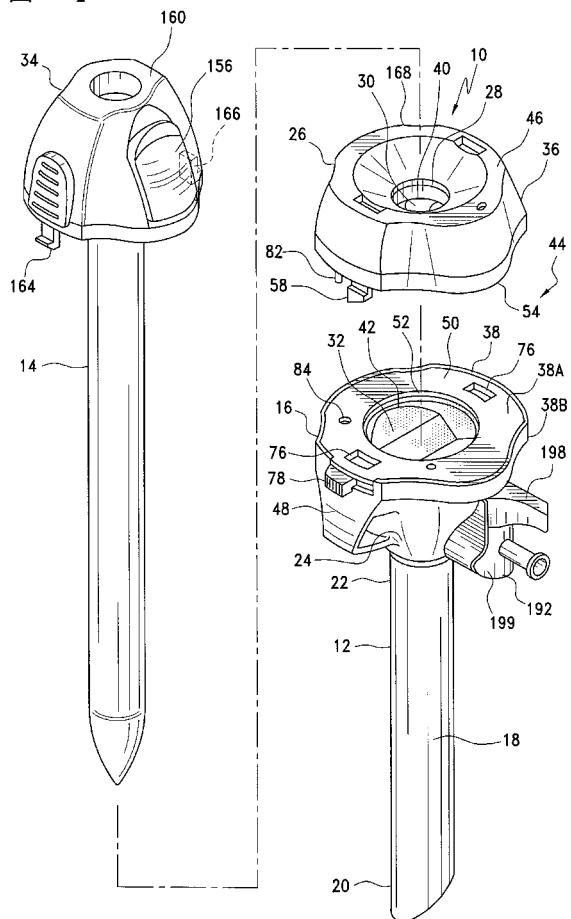


【 図 3 】

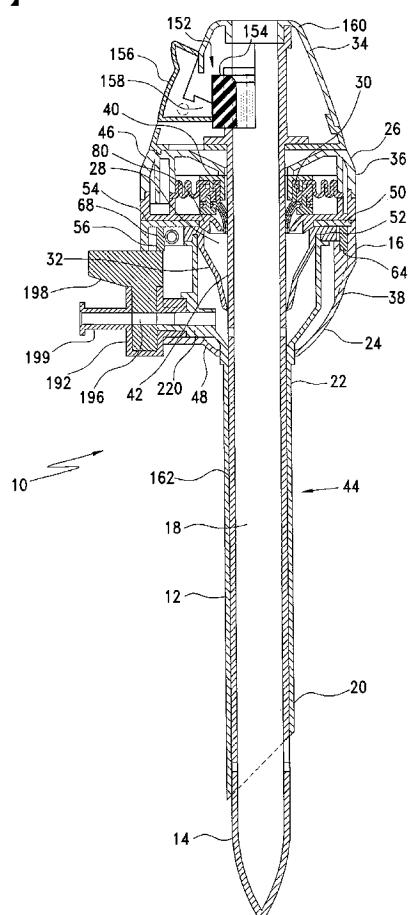


【 四 4 】

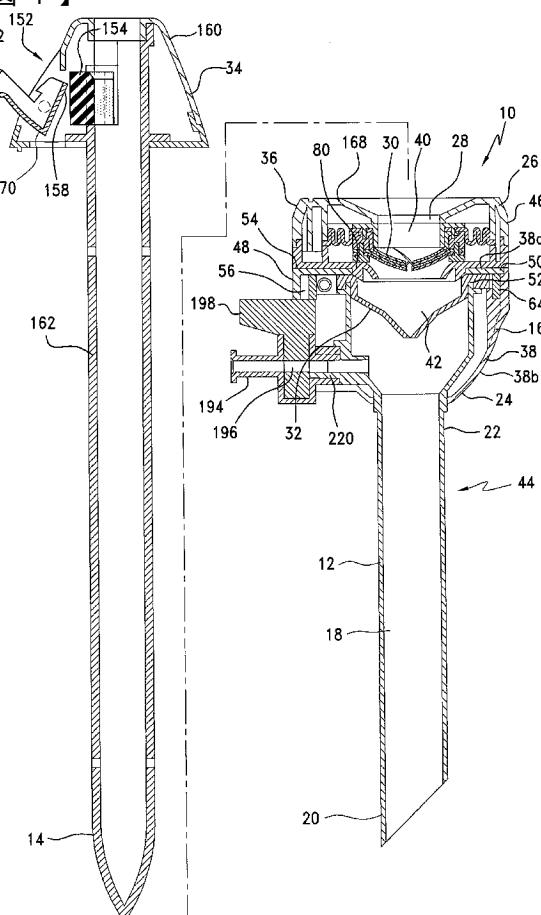


【図5】

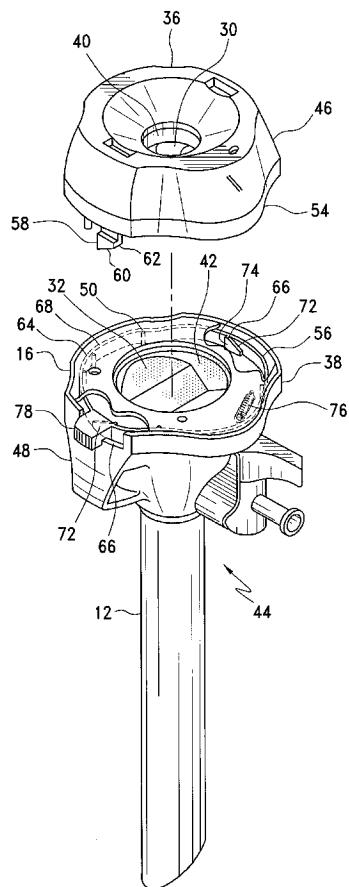


【図6】

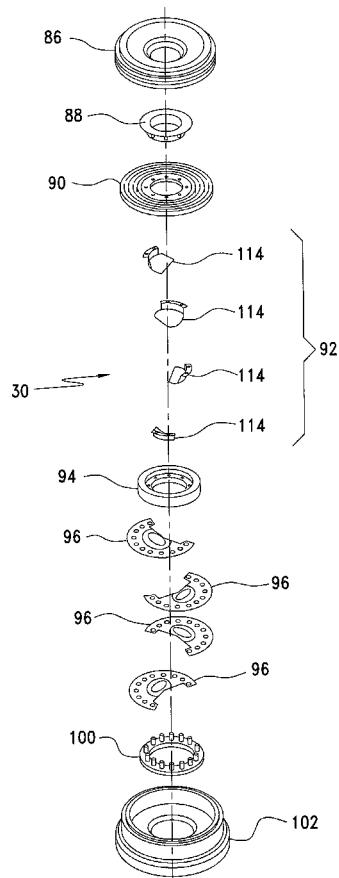


【図7】

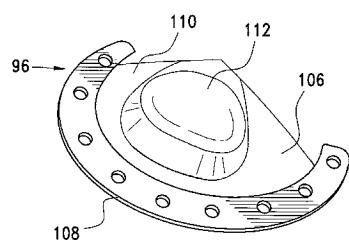


【図9】




【図8】

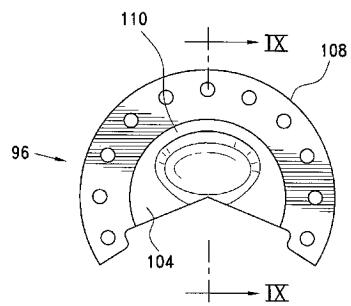


【図 1 0】

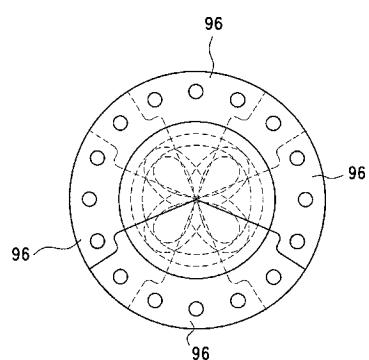


【図 1 1】

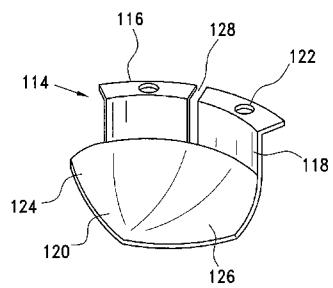


【図 1 2】




【図 1 3】

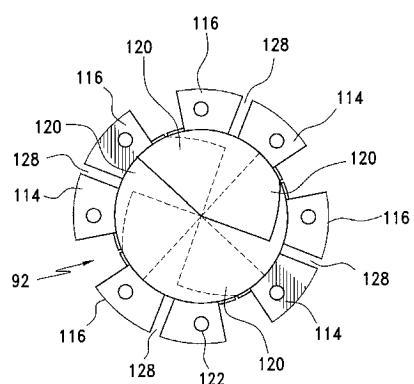


【図 1 4】

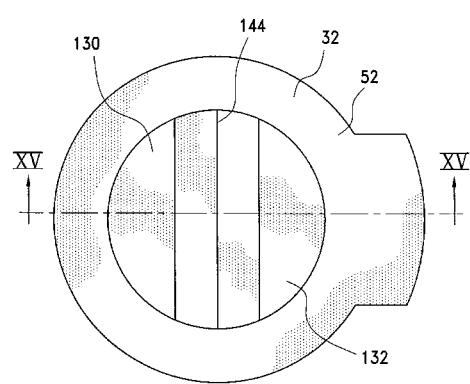


【図15】

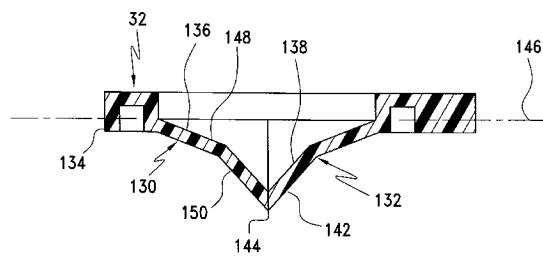


【図16】

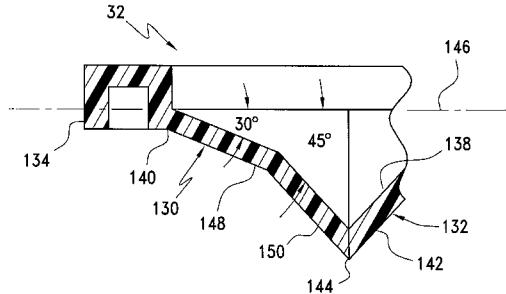


【図17】

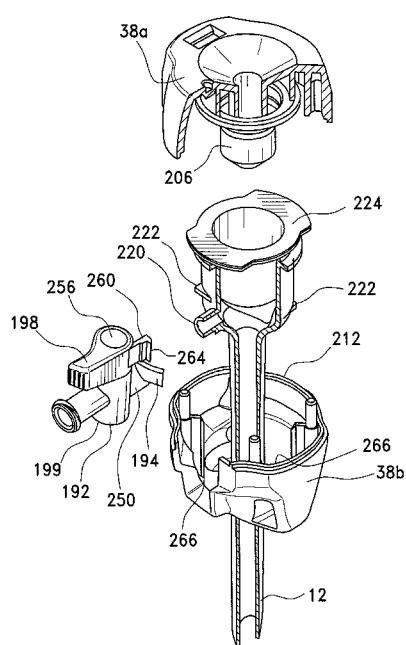


【図18】

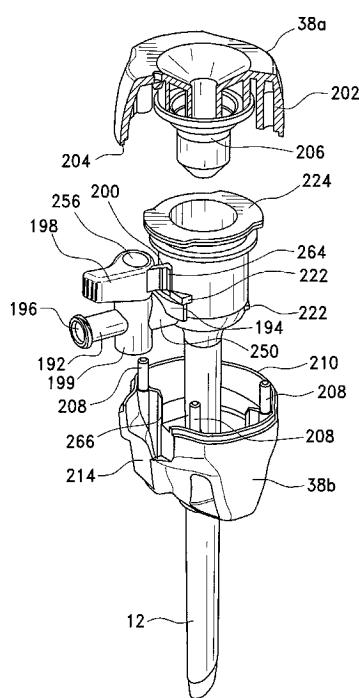


【図19】

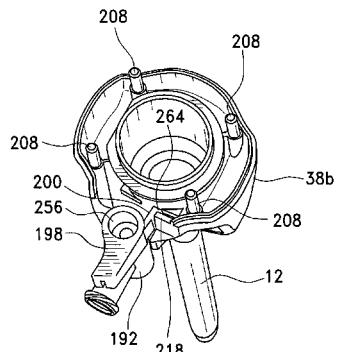


【図20】

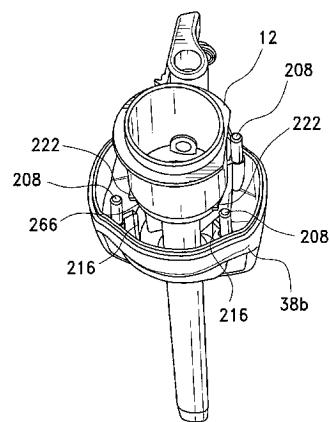


【図21】

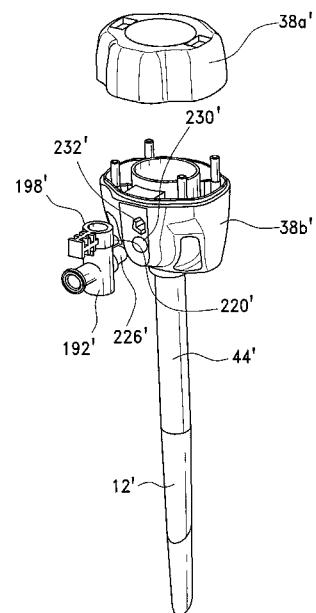


【図22】

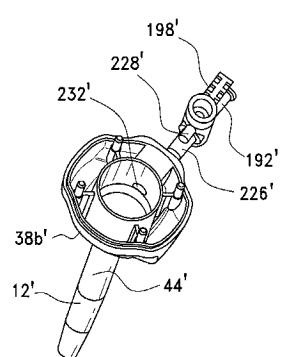


【図23】

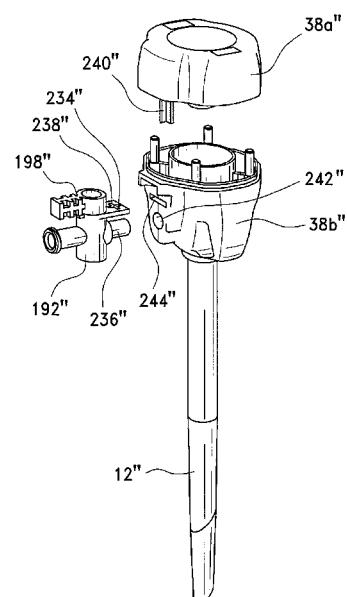

【図24】



【図25】

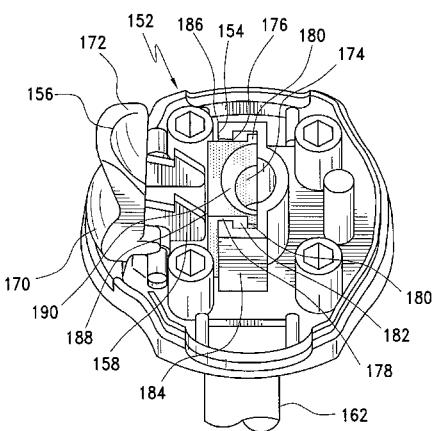

フロントページの続き

(74)代理人 100101133

弁理士 濱田 初音

(72)発明者 ジェフリー・シー・ヒュイル

アメリカ合衆国、45040 オハイオ州、メイソン、インディアン・サマー・ウェイ 8212

(72)発明者 トマス・エイ・ギルカー

アメリカ合衆国、45211 オハイオ州、シンシナティ、ダーウィン・プレース 3434

F ターム(参考) 4C060 FF26 GG24 GG28 GG30

4C061 GG27

【外國語明細書】

2005103292000001.pdf

专利名称(译)	用于套管针密封的仪器固定组件		
公开(公告)号	JP2005103292A	公开(公告)日	2005-04-21
申请号	JP2004285248	申请日	2004-09-29
[标]申请(专利权)人(译)	伊西康内外科公司		
申请(专利权)人(译)	爱惜康完 - Sajeryi公司		
[标]发明人	ジェフリー・シーハュイル トマス・エイギルカー		
发明人	ジェフリー・シーハュイル トマス・エイギルカー		
IPC分类号	A61B17/34 A61B1/00		
CPC分类号	A61B17/34 A61B17/3462 A61B2017/3464 A61B2017/347		
FI分类号	A61B17/34 A61B1/00.320.E A61B1/00.T		
F-TERM分类号	4C060/FF26 4C060/GG24 4C060/GG28 4C060/GG30 4C061/GG27 4C160/FF42 4C160/FF43 4C160/FF45 4C160/FF46 4C160/FF56 4C160/MM32 4C161/GG27		
优先权	10/506737 2003-09-30 US		
其他公开文献	JP4727196B2 JP2005103292A5		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种方便的固定机构，以方便内窥镜或其他设备相对于套管针组件的放置。用于套管针套筒的锁定组件，包括具有穿过其中的开口的锁定组件壳体。锁定组件包括凸轮杆和位于锁定组件壳体内的弹性块。凸轮杆包括可旋转地安装在锁定组件壳体上的第一端和适于用户操作以允许凸轮杆枢转的自由第二端。弹性块可以与穿过锁定组件壳体的器械接合，以将器械固定到锁定组件壳体。[选择图]图25

