

(19) 日本国特許庁 (JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02018/142664

発行日 平成31年2月7日 (2019.2.7)

(43) 国際公開日 平成30年8月9日 (2018.8.9)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 1/045 (2006.01)	A 6 1 B 1/045 6 1 O	4 C 1 6 1
A 6 1 B 1/00 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 C	

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 19 頁)


出願番号	特願2018-503613 (P2018-503613)	(71) 出願人	000000376
(21) 国際出願番号	PCT/JP2017/034533		オリンパス株式会社
(22) 国際出願日	平成29年9月25日 (2017.9.25)		東京都八王子市石川町2951番地
(11) 特許番号	特許第6335412号 (P6335412)	(74) 代理人	100105924
(45) 特許公報発行日	平成30年5月30日 (2018.5.30)		弁理士 森下 賢樹
(31) 優先権主張番号	特願2017-17914 (P2017-17914)	(74) 代理人	100109047
(32) 優先日	平成29年2月2日 (2017.2.2)		弁理士 村田 雄祐
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(74) 代理人	100109081
			弁理士 三木 友由
		(72) 発明者	細谷 良一
			東京都八王子市石川町2951番地 オリ
			ンパス株式会社内
		(72) 発明者	永田 卓志
			東京都八王子市石川町2951番地 オリ
			ンパス株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 内視鏡画像観察支援システム

(57) 【要約】

所見画像記録部 (60) は、所見ごとに、過去に撮影された内視鏡画像を所見画像として記録する。圧縮処理部 (40) は、カプセル内視鏡で撮影された内視鏡画像に圧縮処理を施して、圧縮画像を生成する。類似判定部 (38) は、圧縮処理部 (40) が内視鏡画像を圧縮処理する際に、当該内視鏡画像が、所見画像記録部 (60) に記録された所見画像に類似しているか否かを判定する。類似判定部 (38) により当該内視鏡画像が所見画像に類似していることが判定されると、圧縮処理部 (40) は、圧縮画像に所定の情報を付加する。

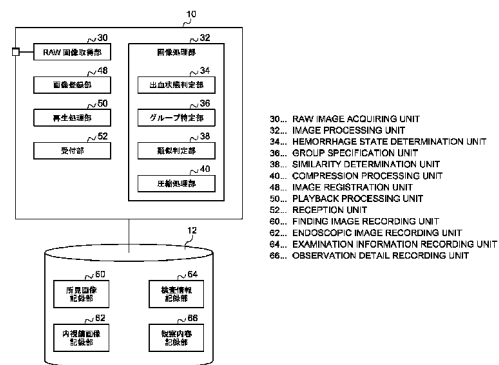

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

カプセル内視鏡により撮影された内視鏡画像の観察を支援する観察支援システムであって、

所見ごとに、過去に撮影された内視鏡画像を所見画像として記録する所見画像記録部と

、

カプセル内視鏡で撮影された内視鏡画像に圧縮処理を施して、圧縮画像を生成する圧縮処理部と、

前記圧縮処理部が内視鏡画像を圧縮処理する際に、当該内視鏡画像が、前記所見画像記録部に記録された所見画像に類似しているか否かを判定する類似判定部と、

10

前記圧縮処理部が生成した複数の圧縮画像を記録する内視鏡画像記録部と、を備え、

前記類似判定部により当該内視鏡画像が所見画像に類似していることが判定されると、前記圧縮処理部は、圧縮画像に所定の情報を付加する、

ことを特徴とする内視鏡画像観察支援システム。

【請求項 2】

前記圧縮処理部は、圧縮画像に、類似判定された所見画像に対応付けられている所見に関する情報を付加する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項 3】

前記圧縮処理部は、RAW 画像である内視鏡画像を圧縮処理する、

20

ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項 4】

前記所見画像記録部は、過去に撮影された内視鏡画像の一部の注目領域を所見画像として記録し、

前記類似判定部は、内視鏡画像に、所見画像と類似している領域が含まれているか否かを判定する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項 5】

前記内視鏡画像記録部に記録された圧縮画像を表示装置に表示させる再生処理部を、さらに備え、

30

前記再生処理部は、圧縮画像に付加された情報にもとづく通知情報を表示する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項 6】

前記再生処理部は、通知情報として、所見に関する情報を表示する、

ことを特徴とする請求項 5 に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項 7】

前記再生処理部は、類似判定された所見画像を表示する機能を有する、

ことを特徴とする請求項 5 に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項 8】

前記所見画像記録部に、所見情報に対応付けて、内視鏡画像を所見画像として登録する画像登録部をさらに備える、

40

ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項 9】

前記画像登録部は、ユーザ操作にもとづいて、前記所見画像記録部から所見画像を削除する、

ことを特徴とする請求項 8 に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、カプセル内視鏡により撮影された内視鏡画像の観察を支援するシステムに関

50

する。

【背景技術】

【0002】

特許文献1は、画像データベースに保存されている多数の被写体画像データの中から、検索対象となる被写体画像の検索画像データと画像の特性が類似している部分を有する類似画像データを検索し、検索結果情報を出力する類似画像検索システムを開示する。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2004-5364号公報

10

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

カプセル内視鏡検査では数万枚の画像が撮影される。読影者は、連続再生される内視鏡画像を観察して異常所見を含む画像を抽出するが、画像数が膨大であるために読影にかかる負担は大きい。そのため読影者による画像観察を効率よく実施させるための技術の開発が望まれている。

【0005】

本発明はこうした状況に鑑みなされたものであり、その目的は、読影者による画像観察を効率的に実施させるための技術を提供することにある。

20

【課題を解決するための手段】

【0006】

上記課題を解決するために、本発明のある態様の内視鏡画像観察支援システムは、カプセル内視鏡により撮影された内視鏡画像の観察を支援するシステムであって、所見ごとに、過去に撮影された内視鏡画像を所見画像として記録する所見画像記録部と、カプセル内視鏡で撮影された内視鏡画像に圧縮処理を施して、圧縮画像を生成する圧縮処理部と、圧縮処理部が内視鏡画像を圧縮処理する際に、当該内視鏡画像が、所見画像記録部に記録された所見画像に類似しているか否かを判定する類似判定部と、圧縮処理部が生成した複数の圧縮画像を記録する内視鏡画像記録部と、を備える。類似判定部により当該内視鏡画像が所見画像に類似していることが判定されると、圧縮処理部は、圧縮画像に所定の情報を付加する。

30

【0007】

なお、以上の構成要素の任意の組み合わせ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図1】実施例にかかるカプセル内視鏡の画像観察支援システムの概要を説明するための図である。

【図2】管理サーバおよび記録装置の構成を示す図である。

40

【図3】内視鏡画像の選択画面の例を示す図である。

【図4】内視鏡画像の連続表示中の選択画面の例を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0009】

図1は、実施例にかかるカプセル内視鏡の画像観察支援システムの概要を説明するための図である。内視鏡画像観察支援システム1は、読影者によるカプセル内視鏡画像の観察を支援する。通常の内視鏡を使用した検査では、医師が患者体内に挿入した内視鏡により撮影される画像をディスプレイでリアルタイムに観察して診断を行うが、カプセル内視鏡検査は、読影者がカプセル内視鏡により過去に撮影された大量の画像をまとめて観察する点で、通常の内視鏡検査と異なる。

50

【 0 0 1 0 】

カプセル内視鏡検査において、患者は腹部にアンテナ（図示せず）を貼り付けられ、受信装置 4 をベルトで腰に付けた状態で、超小型カメラを内蔵したカプセル内視鏡 3 を口から飲み込む。カプセル内視鏡 3 は消化管を通過しながら静止画像を周期的に撮影して、撮影画像をアンテナから受信装置 4 に送信する。受信装置 4 には、着脱可能な記録媒体 5 が装着されており、受信装置 4 は、受信した撮影画像を記録媒体 5 に記録する。カプセル内視鏡 3 がたとえば 0.5 秒ごとに体内を撮影する場合、約 8 時間で体内の撮影を終了すると、約 6 万枚の内視鏡画像が記録媒体 5 に記録される。

【 0 0 1 1 】

患者からアンテナと受信装置 4 が回収されると、記録媒体 5 が受信装置 4 から取り外されて、管理サーバ 10 に接続したデータ読出装置に装着される。データ読出装置は、記録媒体 5 に記録された約 6 万枚の内視鏡画像を読み出し、管理サーバ 10 に送信する。データ読出装置は、管理サーバ 10 に USB ケーブルなどで接続される外部装置であってよい。記録媒体 5 は、管理サーバ 10 に設けられたデータ読出用スロットに装着されて内視鏡画像を読み出されてもよい。なお記録媒体 5 は受信装置 4 に内蔵されたメモリであってもよく、この場合は、データ読出装置が受信装置 4 のデータ端子から記録媒体 5 に記録された内視鏡画像を読み出してよい。

【 0 0 1 2 】

管理サーバ 10 は、記録媒体 5 から読み出された内視鏡画像に所定の画像処理を施して、記録装置 12 に記録する。記録装置 12 は、HDD（ハードディスクドライブ）で構成されてもよく、またフラッシュメモリで構成されてもよい。なお記録媒体 5 に記録された内視鏡画像は、無圧縮の RAW（生の）画像であるか、または可逆圧縮のみを施した RAW 画像であるため、データサイズは非常に大きい。そこで管理サーバ 10 は、RAW 画像である内視鏡画像（以下、「内視鏡 RAW 画像」と呼ぶこともある）に所定の非可逆圧縮処理を施し、データサイズを低減して記録装置 12 に記録する。

【 0 0 1 3 】

管理サーバ 10 は、内視鏡 RAW 画像に所定の画像処理を施す機能に加えて、内視鏡検査のオーダ情報や、読影レポート情報などを管理する機能を有してもよい。なお実施例では、管理サーバ 10 が内視鏡 RAW 画像の画像処理を担当するが、他の機器、たとえば端末装置 20 が内視鏡 RAW 画像に画像処理を施して、記録装置 12 に記録してもよい。

【 0 0 1 4 】

後述するが、実施例の管理サーバ 10 は、内視鏡 RAW 画像を圧縮処理する際に、過去に異常所見が確認された内視鏡画像に類似しているか否かを判定し、類似していることを判定した場合には、圧縮画像に所定の情報を付加する機能をもつ。

【 0 0 1 5 】

複数の端末装置 20 は LAN（ローカルエリアネットワーク）などのネットワーク 2 によって管理サーバ 10 に接続される。端末装置 20 はたとえば医師や技師に割り当てられたパーソナルコンピュータなどであって、画面出力可能に表示装置 22 に接続されるが、端末装置 20 は表示装置と一体となったラップトップコンピュータであってもよく、また携帯型タブレットであってもよい。

【 0 0 1 6 】

端末装置 20 は管理サーバ 10 にアクセスして、記録装置 12 に記録された内視鏡画像を表示装置 22 に表示できる。管理サーバ 10 は、内視鏡画像の再生アプリケーションを実行し、数万枚におよぶ内視鏡画像を効率よく連続再生して端末装置 20 に提供することが好ましい。再生アプリケーションは、端末装置 20 により選択される再生モードおよび再生速度に応じて、内視鏡画像の再生処理を実施する。

【 0 0 1 7 】

カプセル内視鏡検査の目的の一つは、消化管における出血点を探すことにある。管理サーバ 10 は、記録媒体 5 から内視鏡 RAW 画像を取得すると、解析アプリケーションを実行して画像処理することで、出血状態を撮影したと判定される内視鏡 RAW 画像を特定す

10

20

30

40

50

る。管理サーバ１０は、特定した内視鏡ＲＡＷ画像を圧縮する際に、出血状態にあることを示すフラグ情報を付加する。たとえば管理サーバ１０は、内視鏡画像の赤みが所定の閾値を超える場合に、出血状態を撮影した画像であることを判定する。再生アプリケーションは、フラグ情報を付加された画像の再生時に、画像に出血状態が撮影されている可能性が高い旨を通知することで、読影者が、赤みの強い画像と判定された再生画像であることを容易に認識できるようにしてよい。

【００１８】

また消化管内におけるカプセル内視鏡３の移動速度には差があり、移動速度の遅い箇所では、撮影される内視鏡画像の変化も小さい。そこで解析アプリケーションは、時間的に連続して撮影された内視鏡ＲＡＷ画像を比較して、変化が小さい一群の内視鏡画像のグループ化を行う。再生アプリケーションは、グループ化された内視鏡画像群の再生時間を短縮する再生モードを有しており、読影者が、この再生モードを選択することで、観察時間の短縮化を実現できる。再生アプリケーションは、この時短用の再生モードを複数種類用意してよい。実施例の再生アプリケーションは、等速で内視鏡画像を連続再生する再生モードを第１モードと呼ぶと、時短用の再生モードとして、グループ化された内視鏡画像群を通常より高速で切替再生する第２モードと、内視鏡画像群の中から１枚以上を抽出して再生する第３モードとを有する。第３モードで抽出する画像は、前後で類似度が高い画像や、被写体の全体が撮影されている画像であってよい。第２モードおよび第３モードのいずれも、第１モードと比較して全体の観察時間の短縮に寄与する。

【００１９】

さらに実施例の解析アプリケーションは、内視鏡ＲＡＷ画像を、記録装置１２に記録された所見画像と比較して、内視鏡ＲＡＷ画像が所見画像に類似しているか否かを判定する類似判定処理を実施する。所見画像は、過去に医師による画像診断により異常所見を含むことが診断された画像であり、類似判定処理において、新たに撮影された内視鏡ＲＡＷ画像と比較されるための画像である。つまり、新たに撮影された内視鏡ＲＡＷ画像と所見画像との類似度が高ければ、その内視鏡画像は、過去の所見画像に対応付けられた異常所見を含んでいる可能性が高いことが判定される。

【００２０】

そこで実施例の記録装置１２は、所見ごとに、過去に撮影された内視鏡画像を所見画像として記録している。医師は読影レポートを作成する際、異常所見を含む内視鏡画像に、その所見に関する情報を対応付ける。医師は、所見情報を対応付けた内視鏡画像のうち、その異常所見の特徴がクリアに撮影された内視鏡画像など、解析アプリケーションによる類似判定処理により異常所見を自動検出するための比較用画像として適切であると判断した画像を、記録装置１２に所見画像として所見情報に対応付けて記録させる。

【００２１】

カプセル内視鏡検査における代表的な所見として「潰瘍」、「びらん」、「血管性病変」などが存在するが、記録装置１２には、各所見に対して、医師が比較用画像に適切であると判断した内視鏡画像が複数枚記録される。なお医師は自由に所見画像を記録装置１２に追加、削除できることが好ましい。これにより医師は、記録装置１２に記録されている所見画像が比較用画像としては適切でなければ削除し、比較用画像として適切と思われる内視鏡画像を見つけた場合には、記録装置１２に追加する。このように所見画像の入れ替えを行わせることで、類似判定精度を向上させることが可能となる。

【００２２】

以上の解析アプリケーションによる画像処理は、内視鏡ＲＡＷ画像を圧縮処理する際に、一つのカプセル内視鏡検査において撮影された全ての内視鏡ＲＡＷ画像に対して実施される。画像処理の結果は、圧縮した内視鏡画像に付加情報として付加される。これにより再生アプリケーションが圧縮画像を再生処理する際には、既に画像処理の結果が圧縮画像に付加されているために、付加情報を再生内容に反映することが可能となる。

【００２３】

端末装置２０は、管理サーバ１０と協働して、読影者による読影作業を支援する機能を

10

20

30

40

50

もつ。端末装置 20 には、キーボードやマウスなどのユーザインタフェースが接続されている。端末装置 20 は、表示装置 22 に内視鏡画像の選択画面を表示させ、読影者は表示画面を見ながら、ユーザインタフェースを操作して内視鏡画像を選択する。

【0024】

図 2 は、管理サーバ 10 および記録装置 12 の構成を示す。管理サーバ 10 は、RAW 画像取得部 30、画像処理部 32、画像登録部 48、再生処理部 50 および受付部 52 を備える。画像処理部 32 は、出血状態判定部 34、グループ特定部 36、類似判定部 38 および圧縮処理部 40 を有する。管理サーバ 10 の各機能は、解析アプリケーション、再生アプリケーションなど、各種アプリケーションを実行することによって実現されてよい。出血状態判定部 34、グループ特定部 36 および類似判定部 38 の機能は解析アプリケーションにより実現され、再生処理部 50 の機能は再生アプリケーションにより実現される。

10

【0025】

記録装置 12 は、所見画像記録部 60、内視鏡画像記録部 62、検査情報記録部 64 および観察内容記録部 66 を有する。所見画像記録部 60 は、所見ごとに、過去に撮影された内視鏡画像を所見画像として記録する。上記したように所見画像は、過去に医師による画像診断によって異常所見が含まれていることを特定された内視鏡画像である。画像登録部 48 は、医師からの画像登録操作にもとづいて、異常所見を含む内視鏡画像を所見情報に対応付けて所見画像として所見画像記録部 60 に登録し、医師からの登録解除操作にもとづいて、所見画像を所見画像記録部 60 から削除する。内視鏡画像記録部 62 は、画像処理部 32 により画像処理を施された内視鏡画像を、検査ごとに記録する。検査情報記録部 64 は、内視鏡検査に関する情報を記録し、観察内容記録部 66 は、内視鏡画像の観察内容を記録する。

20

【0026】

管理サーバ 10 の構成はハードウェア的には、任意のプロセッサ、メモリ、その他の LSI で実現でき、ソフトウェア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したがって、これらの機能ブロックがハードウェアのみ、ソフトウェアのみ、またはそれらの組合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。なお上記したように、内視鏡 RAW 画像の画像処理は、管理サーバ 10 以外の他の機器において実施されてもよく、その場合は、他の機器が RAW 画像取得部 30 および画像処理部 32 の機能を備えることになる。

30

【0027】

内視鏡 RAW 画像を記録した記録媒体 5 がデータ読出装置に装着されると、データ読出装置は、内視鏡 RAW 画像を記録媒体 5 から読み出し、管理サーバ 10 に送信する。管理サーバ 10 において RAW 画像取得部 30 が、送信された複数の内視鏡 RAW 画像を取得する。RAW 画像取得部 30 は、取得した複数の内視鏡 RAW 画像を記録装置 12 に一時記憶し、画像処理部 32 は、すべての内視鏡 RAW 画像に、以下に示す画像処理を実施する。

【0028】

< 出血画像の特定 >

出血状態判定部 34 は、出血状態を撮影したと考えられる赤みを帯びた内視鏡 RAW 画像を画像解析により探索し、赤みが所定の閾値より強い画像を出血画像として特定する。出血状態判定部 34 は、特定した出血画像を識別する情報（画像 ID）を、圧縮処理部 40 に提供する。

40

【0029】

< 変化の小さい連続画像のグループ化 >

グループ特定部 36 は、連続して撮影された変化の小さい複数の内視鏡 RAW 画像を抽出する。カプセル内視鏡 3 は所定の周期で撮影を行うため、移動速度が遅いと、近似した（ほぼ変化のない）画像を連続して撮影することになる。そこでグループ特定部 36 は、

50

変化の小さい内視鏡画像群を抽出してグループ化する。グループ特定部 36 は、グループとして抽出された内視鏡画像群を特定する情報（グループ ID）と、内視鏡画像群の最初に位置する画像の画像 ID（最初画像 ID）、内視鏡画像群の最後に位置する画像の画像 ID（最後画像 ID）を、圧縮処理部 40 に提供する。

【0030】

< 過去の所見画像とのマッチング処理 >

類似判定部 38 は、所見画像記録部 60 に記録されている複数の所見画像の中から、内視鏡 RAW 画像に類似する所見画像を検索する。つまり類似判定部 38 は、内視鏡 RAW 画像が所見画像記録部 60 に記録された所見画像に類似しているか否かを判定する。この類似判定処理において、内視鏡 RAW 画像が所見画像に類似していることが判定されると、この内視鏡 RAW 画像は、類似判定された所見画像に対応付けられている異常所見を示す可能性が高い。

10

【0031】

なお所見画像記録部 60 は、過去に撮影された内視鏡画像の一部の注目領域を所見画像として記録しておき、類似判定部 38 は、内視鏡 RAW 画像に、所見画像と類似している領域が含まれているか否かを判定してもよい。この場合、医師は所見画像記録部 60 に所見画像を登録する際に、内視鏡画像内の異常所見を示す箇所を注目領域としてマーキングしておき、類似判定部 38 は、マーキングされた注目領域に類似する領域が内視鏡 RAW 画像に含まれるか否かを判定する。内視鏡画像の全体ではなく、異常所見を撮影した注目領域を類似判定の比較対象とすることで、類似判定部 38 による判定時間の短縮化と判定精度の向上を実現できる。類似判定部 38 は、内視鏡 RAW 画像が所見画像に類似していることを判定すると、類似判定した所見画像に対応付けられた所見情報を、画像 ID とともに圧縮処理部 40 に提供する。なお類似判定部 38 は、類似判定した所見画像の画像 ID を圧縮処理部 40 に提供してもよい。

20

【0032】

< 内視鏡 RAW 画像の圧縮処理 >

出血状態判定部 34、グループ特定部 36 および類似判定部 38 による画像処理は、圧縮処理部 40 による内視鏡 RAW 画像の圧縮処理の際に実施される。圧縮処理部 40 は、内視鏡 RAW 画像に非可逆の圧縮処理を施して、圧縮画像を生成する。圧縮処理部 40 は、撮影開始からの経過時間情報および画像 ID を圧縮画像に付加する。たとえば圧縮処理部 40 は、J P E G などの画像フォーマットで内視鏡 RAW 画像を圧縮してよい。

30

【0033】

このとき圧縮処理部 40 は、圧縮画像に、出血状態判定部 34、グループ特定部 36 および類似判定部 38 から提供された解析結果を示す情報を付加する。具体的に圧縮処理部 40 は、出血状態判定部 34 から提供される画像 ID をもつ圧縮画像に、出血画像であることを示す情報を付加する。この情報は、フラグ情報として付加されてよい。また圧縮処理部 40 は、グループ特定部 36 から提供される最初画像 ID と最後画像 ID をもつ圧縮画像に、グループ ID で特定されるグループの開始位置および最後位置であることを示す情報を付加する。

40

【0034】

また圧縮処理部 40 は、類似判定部 38 から提供される画像 ID をもつ圧縮画像に、所定の情報を付加する。具体的に圧縮処理部 40 は、この圧縮画像に、類似判定された所見画像に対応付けられている所見に関する情報を付加する。また圧縮処理部 40 は、類似判定された所見画像の画像 ID を、圧縮画像に付加してもよい。以上のように画像処理部 32 が動作することで、読影者による読影前に、画像処理の結果が付加された圧縮画像が生成されることになる。圧縮処理部 40 は、生成した圧縮画像を、内視鏡画像記録部 62 に記録する。

【0035】

なお上記の例では、出血状態判定部 34、グループ特定部 36 および類似判定部 38 が、圧縮処理部 40 による内視鏡 RAW 画像の圧縮処理の前に、内視鏡 RAW 画像に対して

50

それぞれ画像処理を実施している。変形例では、出血状態判定部 34、グループ特定部 36 および類似判定部 38 が、圧縮処理された圧縮画像に対して、それぞれ画像処理を実施してもよい。この場合であっても、画像処理した結果は、圧縮処理部 40 により圧縮画像に付加される。

【0036】

以下、医師 B による読影時に表示装置 22 に表示される画面について説明する。

医師 B は、端末装置 20 にユーザ ID を入力してログインする。医師 B がログインすると、管理サーバ 10 が検査情報記録部 64 に記憶された検査情報を端末装置 20 に提供し、表示装置 22 には、カプセル内視鏡検査の一覧が表示される。この検査一覧には、患者 ID、患者名、検査 ID、検査日時などの検査情報がリスト表示され、医師 B は、読影レポート作成の対象となる検査を選択する。検査一覧から患者 ID が「A」、検査 ID が「0001」の検査が選択されると、再生処理部 50 が、内視鏡画像を選択するための選択画面を生成して、表示装置 22 に表示させる。なお再生処理部 50 の機能は、端末装置 20 が有してもよい。

10

【0037】

図 3 は、内視鏡画像の選択画面の例を示す。再生処理部 50 は、内視鏡画像を切替表示するための再生領域 100 を含む選択画面を生成する。再生処理部 50 は、内視鏡画像記録部 62 に記録された圧縮画像を表示装置 22 に表示させる。再生操作領域 108 には、再生操作を制御するためのボタンが表示され、再生速度の調整を可能とする。再生ボタン 108a が操作されると、再生領域 100 における内視鏡画像の切替表示が開始され、再生操作領域 108 には、再生ボタン 108a の代わりに、一時停止ボタンが表示される。

20

【0038】

再生領域 100 における内視鏡画像の切替表示中に、医師 B が一時停止ボタンを操作すると、内視鏡画像の切替が一時停止される。この状態で医師 B がマウスホイールを操作すると、一時停止した内視鏡画像の前または後の画像が再生領域 100 に表示される。再生領域 100 に内視鏡画像を一時停止表示した状態で医師 B が選択ボタン 104 を操作すると、その画像がキャプチャされて選択画像表示領域 102 に表示される。選択画像表示領域 102 に表示される選択画像は、後に読影レポートに添付する画像の選択肢となる。医師 B が、選択画像表示領域 102 の選択画像を選択してキャンセルボタン 106 を操作すると、選択を解除できる。たとえば同一所見に関して複数の画像を選択した場合には、良好に撮影されている画像のみを残すようにキャンセルボタン 106 を利用してよい。

30

【0039】

第 1 モード選択ボタン 116a、第 2 モード選択ボタン 116b、第 3 モード選択ボタン 116c は、それぞれ再生モードを設定するためのボタンである。第 1 モード選択ボタン 116a が選択されると、再生モードとして、内視鏡画像を等速で再生する第 1 モードが設定される。選択画面の初期状態では、第 1 モード選択ボタン 116a が選択された状態にあってよい。

【0040】

第 2 モード選択ボタン 116b が選択されると、再生モードとして、グループ化された内視鏡画像群を、他の内視鏡画像よりも高速で切替再生する第 2 モードが設定される。第 3 モード選択ボタン 116c が選択されると、再生モードとして、グループ化された内視鏡画像群の中から 1 枚以上を抽出して再生する第 3 モードが設定される。第 2 モードおよび第 3 モードともに、読影者による読影を効率化するために用意されている。

40

【0041】

時間軸 110 は、再生領域 100 で再生されている内視鏡画像の時間位置を示すためのユーザインタフェースであり、また内視鏡画像を再生領域 100 に一時停止表示するためのユーザインタフェースでもある。時間軸 110 は、横長の矩形領域として表示され、横軸に撮影開始から終了までの時間を表現する。

【0042】

医師 B が、時間軸 110 の任意の箇所にマウスポインタをあてると、その時間に撮影さ

50

れた内視鏡画像が再生領域 1 0 0 に表示される。なお医師 B は、時間軸 1 1 0 に、部位の開始位置を示すためのマークを付加できる。医師 B は、再生領域 1 0 0 で連続再生される内視鏡画像をみながら、新たな部位画像が再生されるとマーキングボタン 1 1 2 を操作して、各部位の開始位置を時間軸上にマーキングする。このマーキング処理を行うことで、内視鏡画像を見直す際に、部位の開始位置を容易に知ることができる。

【 0 0 4 3 】

再生処理部 5 0 は、時間軸 1 1 0 に、内視鏡画像記録部 6 2 に記録された圧縮画像に付加された情報にもとづく通知情報を表示する。図 3 では、再生処理部 5 0 が、時間軸 1 1 0 の時間範囲を示す表示形式で 1 つの通知情報 1 2 0 と 2 つの通知情報 1 2 2 とを表示している。ここで通知情報 1 2 0 および通知情報 1 2 2 は、当該時間範囲に含まれる画像の所見に関する情報である。再生処理部 5 0 は、所見ごとに通知情報の表示態様を異ならせ、表示態様の違いによって所見に関する情報を通知する。

10

【 0 0 4 4 】

たとえば通知情報 1 2 0 は、病変 A の所見に関する情報であり、具体的には病変 A の画像が含まれる可能性が高いことを示す情報である。一方で通知情報 1 2 2 は、病変 B の所見に関する情報であり、具体的には病変 B の画像が含まれる可能性が高いことを示す情報である。再生処理部 5 0 は、一つのカプセル内視鏡検査で撮影された全ての画像の付加情報を参照し、所見に関する情報が付加されている圧縮画像の経過時間情報から時間軸 1 1 0 上の位置を求めて、通知情報 1 2 0 および通知情報 1 2 2 を表示する。

【 0 0 4 5 】

20

再生処理部 5 0 は、通知情報 1 2 0 と通知情報 1 2 2 を、たとえば異なる色で表示する。たとえば再生処理部 5 0 は通知情報 1 2 0 を赤色表示し、通知情報 1 2 2 を青色表示する。これにより読影者は、赤色で表示されている通知情報 1 2 0 が病変 A に関するものであること、青色で表示されている通知情報 1 2 2 が病変 B に関するものであることを一目で理解する。なお通知情報 1 2 0 に対してテキスト「病変 A」を、通知情報 1 2 2 に対してテキスト「病変 B」を、それぞれ関連づけて表示してもよい。いずれにしても再生処理部 5 0 は、どの病変疑いがあるかを読影者が容易に認識できるように通知情報 1 2 0 および通知情報 1 2 2 を表示する。

【 0 0 4 6 】

時間軸 1 1 0 に通知情報 1 2 0 および通知情報 1 2 2 を表示することで、医師 B は、時間軸 1 1 0 の通知情報 1 2 0 および通知情報 1 2 2 の表示箇所にマウスポインタをあてることで、病変が含まれる可能性の高い内視鏡画像をただちに確認できるようになる。また時間軸 1 1 0 に通知情報 1 2 0 および通知情報 1 2 2 を表示することで、医師 B は、病変疑いのある画像がどの部位で撮影されたかを予測することもできる。なお図示していないが、再生処理部 5 0 は、出血画像として判定された画像の時間範囲を時間軸 1 1 0 に表示してもよい。

30

【 0 0 4 7 】

実施例の内視鏡画像観察支援システム 1 によれば、内視鏡 R A W 画像を圧縮処理する際に、内視鏡画像の画像解析が実施されて、解析結果が付加された状態で圧縮画像が生成されている。医師 B が内視鏡画像の読影を行う際には、既に内視鏡画像の解析が終了しているため、画像処理部 3 2 が内視鏡画像の再生中に、画像処理を行うことはない。そのため再生処理部 5 0 は、内視鏡画像の選択画面において、通知情報 1 2 0 および通知情報 1 2 2 をすみやかに表示でき、医師 B による読影作業を効率化できる。

40

【 0 0 4 8 】

図 4 は、内視鏡画像の連続表示中の選択画面の例を示す。再生処理部 5 0 は、再生領域 1 0 0 に、内視鏡画像記録部 6 2 に記録された内視鏡画像を表示させる。以下では第 1 モード選択ボタン 1 1 6 a が選択されており、再生処理部 5 0 が、内視鏡画像を、読影者により設定された再生速度で等速再生する場合について説明する。画像観察中、医師 B は、マーキングボタン 1 1 2 を操作して、各部位の開始位置を示すマーキングを時間軸 1 1 0 上に行ってよい。医師 B は、各部位の開始位置をマーキングしながら、病変所見が撮影さ

50

れた内視鏡画像を選択して、画像観察を実施する。マーキングをしておくことで、後に内視鏡画像を見直す際に、どこから見ればよいか容易に把握できるようになる。

【0049】

医師Bは、病変所見を含む画像が再生領域100に表示されると、一時停止ボタン108bを操作して画像の切替表示を停止させる。なお一時停止ボタン108bが操作されると、再生操作領域108には、一時停止ボタン108bの代わりに、再生ボタン108aが表示される。医師Bはマウスのホイールを操作して、停止させた画像の前後の画像を再生領域100に表示させ、病変所見を鮮明に撮影した画像を探す。管理サーバ10において、受付部52が、医師Bによる操作入力を受け付けると、再生処理部50は、受け付けた操作入力に応じて、内視鏡画像を表示装置22に表示させる。

10

【0050】

病変所見を鮮明に撮影した画像が再生領域100に表示されると、医師Bは、選択ボタン104を操作する。管理サーバ10において受付部52が選択操作を受け付けると、再生処理部50が再生領域100に表示されている選択画像をキャプチャし、選択画像表示領域102に表示させる。選択画像表示領域102に表示される画像は、後に読影レポートに添付する画像の選択肢となる。図4では、選択画像表示領域102において、選択画像102a~102iが選択されている様子が示される。

【0051】

内視鏡画像の連続再生中、医師Bは、時間軸110に表示されている通知情報120および通知情報122の表示範囲に含まれる画像を特に慎重に観察する。時間軸110上に通知情報120および通知情報122を表示することで、読影者の見落としリスクを低減できる。

20

【0052】

なお再生処理部50は、再生領域100に、所見に関する情報を付加された内視鏡画像を表示する際、所見に関する情報を、通知情報124として表示してよい。ここでは「病変Bの可能性あり」とする通知情報124が表示されている。再生処理部50は、通知情報124を、医師Bの注目を引く態様で表示してもよい。たとえば再生処理部50は通知情報124を点滅させて強調表示してもよく、またアラート音を出力してもよい。このように再生処理部50が通知情報124を出力することで、医師Bは、より注意をもって再生領域100に表示される内視鏡画像を観察できる。

30

【0053】

再生処理部50は、内視鏡画像に類似すると判定された所見画像を表示する機能を有してよい。再生処理部50は、再生領域100に、所見に関する情報を付加された内視鏡画像を表示する際、当該内視鏡画像に類似判定された所見画像を表示するための所見画像確認ボタン126を、操作可能に表示する。医師Bが所見画像確認ボタン126を操作すると、再生領域100に表示されている内視鏡画像に類似判定された所見画像が表示される。

【0054】

再生領域100に表示されている内視鏡画像に対して、「病変Bの可能性あり」とする通知情報124が表示されている場合に、医師Bが画像診断した結果、表示されている内視鏡画像には病変Bが認められないことがある。その場合、類似判定された所見画像が適切でないことも考えられ、医師Bは今後の類似判定精度を高めるために、所見画像を確認したいこともある。そこで医師Bが、所見画像確認ボタン126を操作すると、管理サーバ10において受付部52がボタン操作を受け付け、再生処理部50が、表示画像に付加された所見画像IDを参照して、類似判定された所見画像を選択画面に重畳表示する。このとき、所見画像として適切でないと医師Bが判断すれば、医師Bは、登録解除操作を行うことができる。受付部52が登録解除操作を受け付けると、画像登録部48は、所見画像記録部60から、当該所見画像を削除する。このように医師Bが画像診断の結果をフィードバックすることで、類似判定精度を向上できるようになる。

40

【0055】

50

次に、第2モード選択ボタン116bが選択されて、再生処理部50が、グループ化された内視鏡画像群を、他の内視鏡画像よりも高速で切替再生する場合について説明する。再生処理部50は、グループの開始位置であることを示す情報が付加された最初画像から、グループの最後位置であることを示す情報が付加された最後画像までの連続切替再生を、設定されている再生速度よりも速い速度で高速再生する。第2モードでは、変化の少ない画像群に含まれる画像を高速再生することで、全体の再生時間の短縮化を実現する。

【0056】

このとき再生処理部50は、内視鏡画像群の中に、所見に関する情報を付加された内視鏡画像が存在すれば、その内視鏡画像の再生速度を通常に戻してよい。これにより医師Bは、所見に関する情報を付加された内視鏡画像を慎重に観察できるようになる。再生処理部50は、所見に関する情報を付加された内視鏡画像の再生速度を、通常よりも遅くしてもよい。

【0057】

次に、第3モード選択ボタン116cが選択されて、再生処理部50が、グループ化された内視鏡画像群の中から1枚以上を抽出して再生する場合について説明する。再生処理部50は、グループの開始位置であることを示す情報が付加された画像から、グループの最後位置であることを示す情報が付加された画像までの間に含まれる1枚以上の画像を再生する。なお画像の再生枚数は、たとえば数枚であってよい。第3モードでは、変化の少ない画像群に含まれる画像を数枚のみ再生することで、全体の再生時間の短縮化を実現する。

【0058】

このとき再生処理部50は、内視鏡画像群の中に、所見に関する情報を付加された内視鏡画像が存在すれば、その内視鏡画像を必ず表示するようにする。そのため、たとえば内視鏡画像群が30枚の画像により構成され、所見に関する情報を付加された内視鏡画像が5枚存在すれば、少なくともその5枚が表示されるようにする。これにより医師Bは、所見に関する情報を付加された内視鏡画像を確実に観察できるようになる。

【0059】

医師Bは、画像観察を終了すると、登録ボタン114を操作する。登録ボタン114が操作されると、選択画像表示領域102に選択された選択画像と、マーキングボタン112の操作によりマーキングされた各部位の開始位置を示す時間情報が、管理サーバ10により観察内容記録部66に記録される。以上により、医師Bによる画像観察が終了する。

【0060】

以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。

【0061】

実施例においては、圧縮処理を含む画像処理を管理サーバ10で実施したが、これらの画像処理は、カプセル内視鏡3で実施されてもよく、また受信装置4で実施されてもよい。

【符号の説明】

【0062】

1・・・内視鏡画像観察支援システム、3・・・カプセル内視鏡、4・・・受信装置、5・・・記録媒体、10・・・管理サーバ、12・・・記録装置、20・・・端末装置、22・・・表示装置、30・・・RAW画像取得部、32・・・画像処理部、34・・・出血状態判定部、36・・・グループ特定部、38・・・類似判定部、40・・・圧縮処理部、48・・・画像登録部、50・・・再生処理部、52・・・受付部、60・・・所見画像記録部、62・・・内視鏡画像記録部、64・・・検査情報記録部、66・・・観察内容記録部。

【産業上の利用可能性】

【0063】

10

20


30

40


50

本発明は、カプセル内視鏡により撮影された内視鏡画像の観察支援に利用できる。


【図 1】

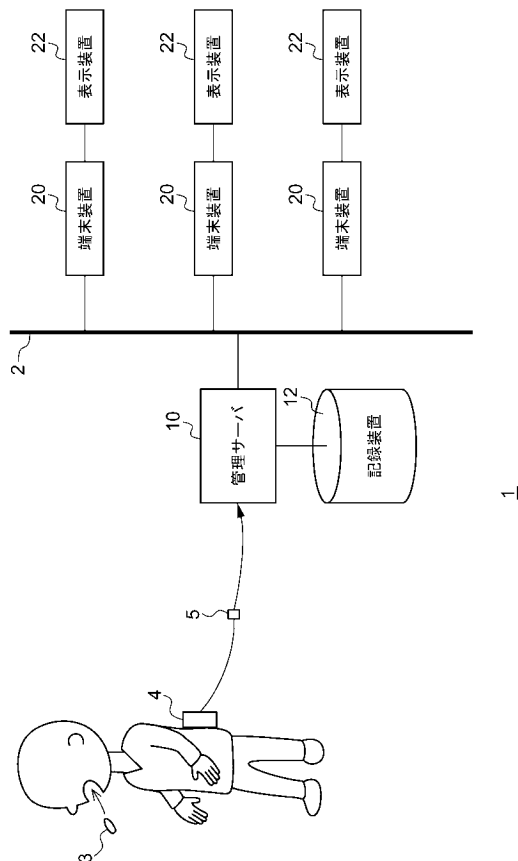


【図 2】

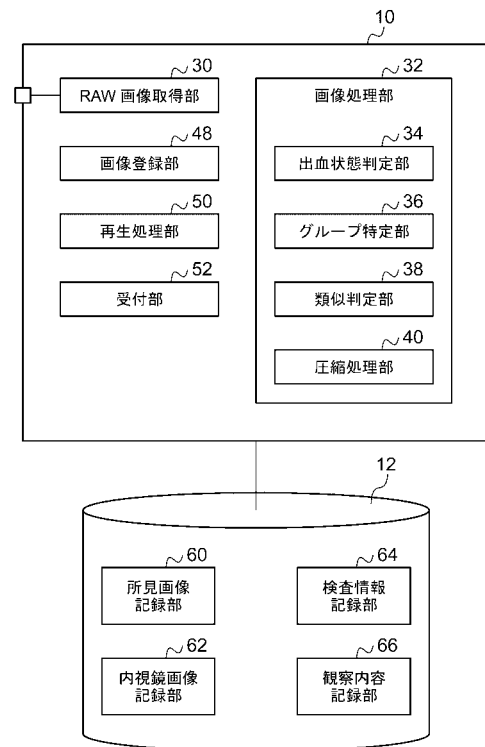

【図 3】

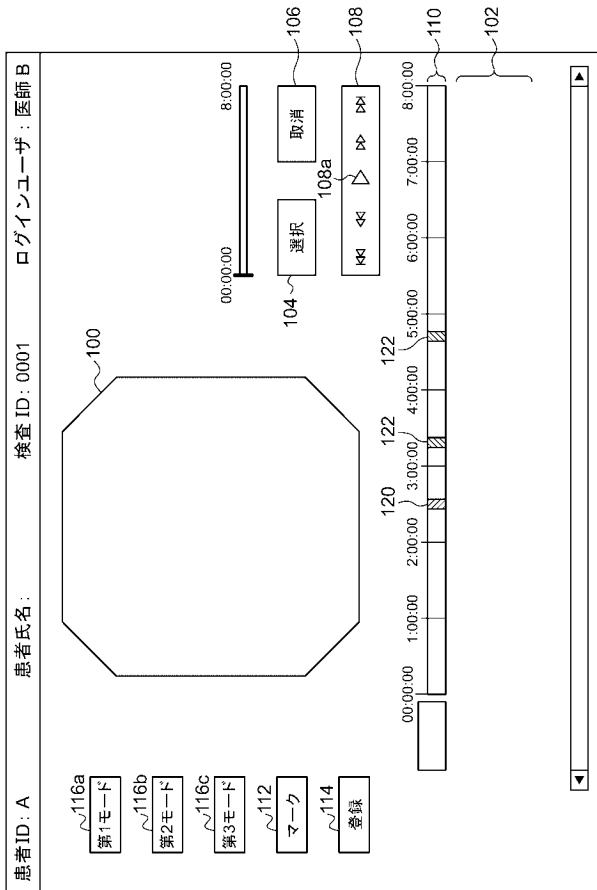

【図 4】

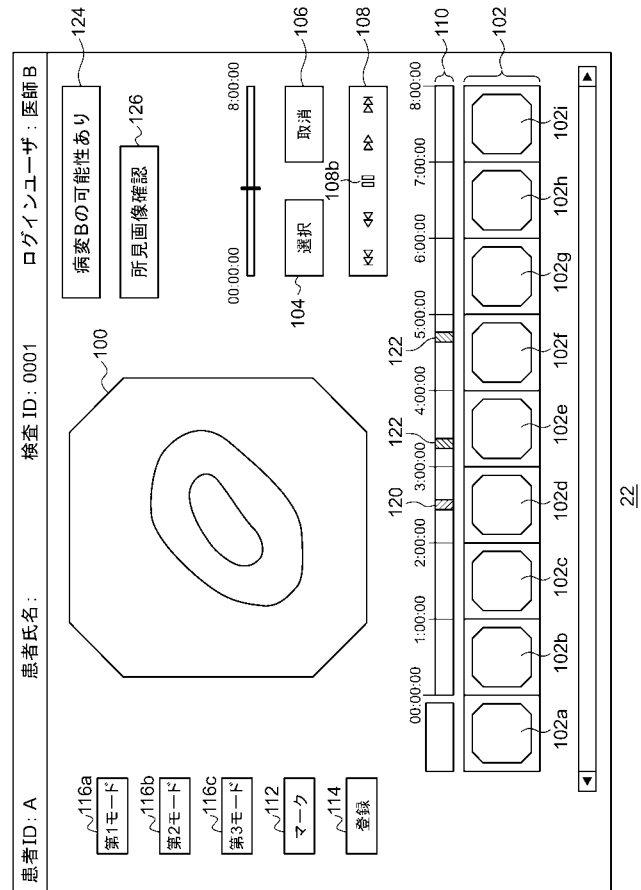

【手続補正書】

【提出日】平成30年1月23日(2018.1.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

カプセル内視鏡により撮影された内視鏡画像の観察を支援する観察支援システムであって、

過去に撮影された内視鏡画像を所見画像として記録する所見画像記録部と、

カプセル内視鏡で撮影された内視鏡画像に圧縮処理を施して、圧縮画像を生成する圧縮処理部と、

前記圧縮処理部が内視鏡画像を圧縮処理する際に、当該内視鏡画像が、前記所見画像記録部に記録された所見画像に類似しているか否かを判定する類似判定部と、

前記圧縮処理部が生成した複数の圧縮画像を記録する内視鏡画像記録部と、を備え、

前記類似判定部により当該内視鏡画像が所見画像に類似していることが判定されると、前記圧縮処理部は、圧縮画像に所定の情報を付加する、

ことを特徴とする内視鏡画像観察支援システム。

【請求項 2】

前記所見画像記録部は、過去に異常所見を含むことが診断された画像を所見画像として所見ごとに記録する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項 3】

前記圧縮処理部は、圧縮画像に、類似判定された所見画像に対応付けられている所見に関する情報を付加する、

ことを特徴とする請求項2に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項4】

前記圧縮処理部は、RAW画像である内視鏡画像を圧縮処理する、
ことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項5】

前記所見画像記録部は、過去に撮影された内視鏡画像の一部の注目領域を所見画像として記録し、

前記類似判定部は、内視鏡画像に、所見画像と類似している領域が含まれているか否かを判定する、

ことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項6】

前記内視鏡画像記録部に記録された前記複数の圧縮画像を表示装置に表示させる再生処理部を、さらに備え、

前記再生処理部は、圧縮画像に付加された情報にもとづく通知情報を表示する、
ことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項7】

前記再生処理部は、通知情報として、所見に関する情報を表示する、
ことを特徴とする請求項6に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項8】

前記再生処理部は、類似判定された所見画像を表示する機能を有する、
ことを特徴とする請求項6に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項9】

前記所見画像記録部に、所見情報に対応付けて、内視鏡画像を所見画像として登録する画像登録部をさらに備える、

ことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【請求項10】

前記画像登録部は、ユーザ操作にもとづいて、前記所見画像記録部から所見画像を削除する、

ことを特徴とする請求項9に記載の内視鏡画像観察支援システム。

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/034533

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl. A61B1/045 (2006.01) i, A61B1/00 (2006.01) i, G06Q50/22 (2012.01) i, G06Q50/24 (2012.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl. A61B1/045, A61B1/00, G06Q50/22, G06Q50/24

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Published examined utility model applications of Japan	1922-1996
Published unexamined utility model applications of Japan	1971-2017
Registered utility model specifications of Japan	1996-2017
Published registered utility model applications of Japan	1994-2017

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2003-38425 A (OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.) 12 February 2003, paragraphs [0031]-[0035], fig. 1-5 & US 2003/0023150 A1, paragraphs [0201]-[0225], fig. 14-17D	1-9
A	JP 2007-228337 A (OLYMPUS OPTICAL CO.) 06 September 2007, paragraphs [0077]-[0094], fig. 7-11 & US 2007/0216781 A1, paragraphs [0106]-[0121], fig. 7-11	1-9



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
04.12.2017Date of mailing of the international search report
12.12.2017Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2017/034533

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2017/006618 A1 (OLYMPUS OPTICAL CO.) 12 January 2017, paragraphs [0056], [0066]-[0069], fig. 1-6 (Family: none)	1-9
A	JP 2007-75163 A (OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORPORATION) 29 March 2007, paragraphs [0027]-[0035], fig. 1-4 & US 2008/0232702 A1, paragraphs [0032]-[0046], fig. 1-4 & WO 2007/029816 A1 & EP 1922984 A1 & CN 101257836 A	1-9
A	JP 2009-189475 A (FUJIFILM CORPORATION) 27 August 2009, paragraphs [0075]-[0080], fig. 7 & US 2009/0203964 A1, paragraphs [0115]-[0120], fig. 7	1-9
A	JP 2007-105458 A (GIVEN IMAGING LTD.) 26 April 2007, paragraphs [0019]-[0028], fig. 1-4 & US 2007/0066875 A1, paragraphs [0023]-[0032], fig. 1-4 & EP 1770570 A2	1-9

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 7 / 0 3 4 5 3 3									
A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C）） Int.Cl. A61B1/045(2006.01)i, A61B1/00(2006.01)i, G06Q50/22(2012.01)i, G06Q50/24(2012.01)i											
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C）） Int.Cl. A61B1/045, A61B1/00, G06Q50/22, G06Q50/24											
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの <table border="0"> <tr> <td>日本国実用新案公報</td> <td>1922-1996年</td> </tr> <tr> <td>日本国公開実用新案公報</td> <td>1971-2017年</td> </tr> <tr> <td>日本国実用新案登録公報</td> <td>1996-2017年</td> </tr> <tr> <td>日本国登録実用新案公報</td> <td>1994-2017年</td> </tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2017年	日本国実用新案登録公報	1996-2017年	日本国登録実用新案公報	1994-2017年
日本国実用新案公報	1922-1996年										
日本国公開実用新案公報	1971-2017年										
日本国実用新案登録公報	1996-2017年										
日本国登録実用新案公報	1994-2017年										
国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）											
C. 関連すると認められる文献											
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号									
A	JP 2003-38425 A（オリンパス光学工業株式会社） 2003.02.12, 段落[0031]-[0035], 図1-5 & US 2003/0023150 A1, 段落[0201]-[0225], 図14-17D	1-9									
A	JP 2007-228337 A（オリンパス株式会社） 2007.09.06, 段落[0077]-[0094], 図7-11 & US 2007/0216781 A1, 段落[0106]-[0121], 図7-11	1-9									
☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。 ☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。											
<table border="0"> <tr> <td> * 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 </td> <td> の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献 </td> </tr> </table>				* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献						
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す） 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献										
国際調査を完了した日 04.12.2017		国際調査報告の発送日 12.12.2017									
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁（I S A / J P） 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官（権限のある職員） 山口 裕之 電話番号 03-3581-1101 内線 3292	2Q 7859								

国際調査報告		国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 7 / 0 3 4 5 3 3
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	WO 2017/006618 A1 (オリンパス株式会社) 2017.01.12, 段落[0056],[0066]-[0069], 図 1-6 (ファミリーなし)	1-9
A	JP 2007-75163 A (オリンパスメディカルシステムズ株式会社) 2007.03.29, 段落[0027]-[0035], 図 1-4 & US 2008/0232702 A1, 段落[0032]-[0046], 図 1-4 & WO 2007/029816 A1 & EP 1922984 A1 & CN 101257836 A	1-9
A	JP 2009-189475 A (富士フイルム株式会社) 2009.08.27, 段落[0075]-[0080], 図 7 & US 2009/0203964 A1, 段落[0115]-[0120], 図 7	1-9
A	JP 2007-105458 A (ギブン イメージング リミテッド) 2007.04.26, 段落[0019]-[0028], 図 1-4 & US 2007/0066875 A1, 段落[0023]-[0032], 図 1-4 & EP 1770570 A2	1-9

フロンツページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT

(72)発明者 館下 功

東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地 オリンパス株式会社内

(72)発明者 猪股 亮

東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地 オリンパス株式会社内

(72)発明者 小熊 諒

東京都八王子市石川町 2 9 5 1 番地 オリンパス株式会社内

Fターム(参考) 4C161 DD07 GG28 TT15 WW02 WW10 WW18 WW19

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	内窥镜图像观察支持系统		
公开(公告)号	JPWO2018142664A1	公开(公告)日	2019-02-07
申请号	JP2018503613	申请日	2017-09-25
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	細谷良一 永田卓志 館下功 猪股亮 小熊諒		
发明人	細谷 良一 永田 卓志 館下 功 猪股 亮 小熊 諒		
IPC分类号	A61B1/045 A61B1/00		
FI分类号	A61B1/045.610 A61B1/00.C		
F-TERM分类号	4C161/DD07 4C161/GG28 4C161/TT15 4C161/WW02 4C161/WW10 4C161/WW18 4C161/WW19		
代理人(译)	森下Kenju 三木 友由		
优先权	2017017914 2017-02-02 JP		
其他公开文献	JP6335412B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

发现图像记录单元 (60) 记录过去捕获的内窥镜图像作为每个发现的发现图像。压缩处理单元 (40) 对由胶囊内窥镜捕获的内窥镜图像进行压缩处理以生成压缩图像。当压缩处理单元 (40) 压缩内窥镜图像时，相似性确定单元 (38) 将内窥镜图像与记录在发现图像记录单元 (60) 中的发现图像进行比较或者不是。当相似性确定单元 (38) 确定内窥镜图像类似于发现图像时，压缩处理单元 (40) 将预定信息添加到压缩图像。

