

(19) 日本国特許庁(JP)

## 再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02013/031512

発行日 平成27年3月23日(2015.3.23)

(43) 国際公開日 平成25年3月7日(2013.3.7)

(51) Int.Cl. F 1 テーマコード (参考)  
A 6 1 B 1/04 (2006.01) A 6 1 B 1/04 3 7 0 4 C 1 6 1


審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 29 頁)

|              |                              |          |                                                      |
|--------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 出願番号         | 特願2013-519894 (P2013-519894) | (71) 出願人 | 304050923<br>オリンパスメディカルシステムズ株式会社<br>東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番2号 |
| (21) 国際出願番号  | PCT/JP2012/070317            | (74) 代理人 | 100076233<br>弁理士 伊藤 進                                |
| (22) 国際出願日   | 平成24年8月9日(2012.8.9)          | (74) 代理人 | 100101661<br>弁理士 長谷川 靖                               |
| (11) 特許番号    | 特許第5331948号 (P5331948)       | (74) 代理人 | 100135932<br>弁理士 篠浦 治                                |
| (45) 特許公報発行日 | 平成25年10月30日(2013.10.30)      | (72) 発明者 | 浦崎 剛<br>東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番2号 オ<br>リンパスメディカルシステムズ株式会社内    |
| (31) 優先権主張番号 | 特願2011-185130 (P2011-185130) | (72) 発明者 | 大島 龍<br>東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番2号 オ<br>リンパスメディカルシステムズ株式会社内    |
| (32) 優先日     | 平成23年8月26日(2011.8.26)        |          | 最終頁に続く                                               |
| (33) 優先権主張国  | 日本国(JP)                      |          |                                                      |

(54) 【発明の名称】 内視鏡システム

## (57) 【要約】

内視鏡システムは、少なくとも一部の設定が共通なプロセッサ12Aと12Bを含み、所定の操作に基づき(S1)、上位の優先順に決定されたプロセッサ12Aの設定内容を、下位の優先順位に決定されたプロセッサ12Bへ送信し(S3)、プロセッサ12Bにおいて、受信したプロセッサ12Aの設定内容のうち、プロセッサ12Bの設定内容と共通する設定を、受信したプロセッサ12Aの設定内容に変更する(S5)。

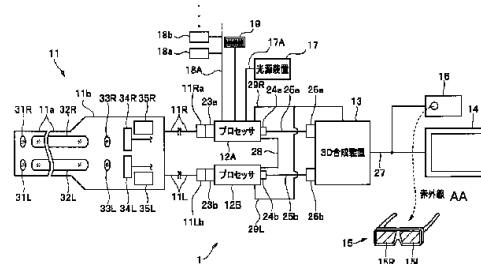

17 Light source apparatus  
12A, 12B Processors  
13 3D combination apparatus  
AA Infrared radiation

**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

少なくとも一部の設定が共通な第 1 の医療機器と第 2 の医療機器を含む医療機器システムにおいて、

所定の操作に基づき、上位の優先順位に決定された前記第 1 の医療機器の設定内容を、下位の優先順位に決定された前記第 2 の医療機器へ送信する送信部と、

前記第 2 の医療機器において、受信した前記第 1 の医療機器の設定内容のうち、前記第 2 の医療機器の設定内容と共通する設定を、受信した前記第 1 の医療機器の設定内容に変更する設定内容変更部と、

を備えることを特徴とする医療機器システム。

10

**【請求項 2】**

体腔内を撮像する第 1 の撮像装置を有し、第 1 の撮像信号を出力する第 1 の内視鏡と、前記第 1 の内視鏡と接続され、前記第 1 の撮像信号を処理して第 1 の画像信号を出力する、前記第 1 の医療機器としての第 1 のプロセッサと、

前記体腔内を撮像する第 2 の撮像装置と有し、第 2 の撮像信号を出力する第 2 の内視鏡と、

前記第 1 のプロセッサよりも優先順位が低く決定され、前記第 2 の内視鏡と接続され、前記第 2 の撮像信号を処理して第 2 の画像信号を出力する、前記第 2 の医療機器としての第 2 のプロセッサと、

前記第 1 の画像信号と前記第 2 の画像信号により三次元画像を生成する三次元画像生成装置と、を有して構成され、

20

前記送信部は、前記第 1 のプロセッサの設定内容を、第 2 のプロセッサへ送信し、

前記設定内容変更部は、受信した前記第 1 のプロセッサの設定内容に基づき、共通する前記第 2 のプロセッサの設定内容を変更する、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の医療機器システム。

**【請求項 3】**

前記上位の優先順位の医療機器に接続された入力機器が有効とされ、前記入力機器に入力された情報は、前記下位の優先順位の医療機器に送信されることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の医療機器システム。

**【請求項 4】**

30

前記設定内容は、画質設定と映像出力設定に関する情報を含むことを特徴とする請求項 2 に記載の医療機器システム。

**【請求項 5】**

前記設定内容変更部は、前記第 2 の医療機器が、受信した前記第 1 の医療機器の設定内容の中から更新に必要な情報のみを抽出して更新を行うことにより、前記第 2 の医療機器の設定内容と共通する設定を、受信した前記第 1 の医療機器の設定内容に変更することを特徴とする請求項 2 又は 4 に記載の医療機器システム。

**【請求項 6】**

前記第 2 の医療機器は、前記設定内容変更部による前記設定内容の変更の後、自己の操作パネルのランプを消灯することを特徴とする請求項 2 又は 4 に記載の医療機器システム。

40

**【請求項 7】**

体腔内を撮像する第 1 の撮像装置を有し、第 1 の撮像信号を出力する第 1 の内視鏡と、前記第 1 の内視鏡と接続され、前記第 1 の撮像信号を処理して第 1 の画像信号を出力する、前記第 1 の医療機器としての第 1 のプロセッサと、

前記体腔内を撮像する第 2 の撮像装置と有し、第 2 の撮像信号を出力する第 2 の内視鏡と、

前記第 1 のプロセッサよりも優先順位が低く決定され、前記第 2 の内視鏡と接続され、前記第 2 の撮像信号を処理して第 2 の画像信号を出力する、前記第 2 の医療機器としての第 2 のプロセッサと、

50

前記第 1 のプロセッサに接続された光源装置と、

前記第 1 のプロセッサと前記第 2 のプロセッサからの前記光源装置への光源制御信号を入力して、前記第 1 のプロセッサと前記第 2 のプロセッサのいずれか一方の前記光源制御信号を前記光源装置へ出力するように、切り替える切替スイッチと、  
を有して構成され、

前記送信部は、前記第 1 のプロセッサの設定内容を、第 2 のプロセッサへ送信し、

前記設定内容変更部は、受信した前記第 1 のプロセッサの設定内容に基づき、共通する前記第 2 のプロセッサの設定内容を変更する、  
ことを特徴とする請求項 1 に記載の医療機器システム。

【請求項 8】

10

前記設定内容は、画質設定と映像出力設定に関する情報を含むことを特徴とする請求項 7 に記載の医療機器システム。

【請求項 9】

前記設定内容変更部は、前記第 2 の医療機器が、受信した前記第 1 の医療機器の設定内容の中から更新に必要な情報のみを抽出して更新を行うことにより、前記第 2 の医療機器の設定内容と共通する設定を、受信した前記第 1 の医療機器の設定内容に変更することを特徴とする請求項 7 又は 8 に記載の医療機器システム。

【請求項 10】

前記第 1 の医療機器が使用される場合は、前記第 2 の医療機器は、自己の操作パネルのランプを消灯することを特徴とする請求項 7 又は 8 に記載の医療機器システム。

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、医療機器システムに関し、特に、少なくとも一部の設定を共通にする 2 台の医療機器を含む医療機器システムに関する。

【背景技術】

【0002】

従来より、内視鏡システム等の医療機器システムが広く利用されている。例えば、内視鏡システムには、被写体を立体的に観察可能な立体視内視鏡システムや、面順次式の内視鏡システム、同時式の内視鏡システム、等、種々の種類がある。

30

例えば、日本特開 2004 - 222937 号公報に開示のように、立体視内視鏡システムは、2 つの内視鏡画像を合成して観察像を生成するため、2 つの内視鏡画像を処理する 2 台のプロセッサを組み合わせる構築される。

【0003】

また、病院等の施設においては、複数の内視鏡用プロセッサが共存しているため、様々な組み合わせられて使用される場合がある。例えば、同時式の内視鏡システムを構築する場合は、モニタ、光源装置などの周辺機器を同時式のプロセッサと接続して、そのシステムは構築される。また、面順次式の内視鏡システムを構築する場合は、モニタ、光源装置などの周辺機器を面順次式のプロセッサと接続して、そのシステムは構築される。

【0004】

40

しかし、例えば、立体内視鏡システムの場合、2 つの内視鏡画像を処理する 2 台のプロセッサ間では、各種設定を同期させる、すなわち合わせる、調整を手動でしなければならない。よって、ユーザが立体内視鏡システムを構築する場合、2 つの内視鏡画像の色合いなどの画質の設定、各種データの表示内容の設定、ハイビジョンのアスペクト比の設定等を一致させる調整を、2 台のプロセッサに対して行う必要がある。

【0005】

また、面順次式の内視鏡システムと同時式の内視鏡システムが共存し、2 つのシステムに共用できるモニタ、光源装置等の周辺機器がある場合に、周辺機器を共用するときは、各システムを構築するときに、共用する周辺機器への接続切換を手動で行うと共に、プロセッサにおける周辺機器に対する制御に関する設定等も変更しなければならなかった。

50

## 【 0 0 0 6 】

すなわち、複数のプロセッサが共存する場合に、使用目的に合わせてプロセッサと周辺機器が組み合わされる場合に、組合せの変更の度に、設定を行うことは、ユーザにとって繁雑な作業であった。

## 【 0 0 0 7 】

そこで、本発明は、２台の医療機器を用いてシステムを構築するときに、共通する設定が不要な医療機器システムを提供することを目的とする。

## 【 発明の開示 】

## 【 課題を解決するための手段 】

## 【 0 0 0 8 】

本発明の一態様の医療機器システムは、少なくとも一部の設定が共通な第１の医療機器と第２の医療機器を含む医療機器システムにおいて、所定の操作に基づき、上位の優先順位に決定された前記第１の医療機器の設定内容を、下位の優先順位に決定された前記第２の医療機器へ送信する送信手段と、前記第２の医療機器において、受信した前記第１の医療機器の設定内容のうち、前記第２の医療機器の設定内容と共通する設定を、受信した前記第１の医療機器の設定内容に変更する設定内容変更手段と、を備える。

## 【 図面の簡単な説明 】

## 【 0 0 0 9 】

【 図 １ 】 本発明の第１の実施の形態に係わる、立体内視鏡の内部構成と、液晶シャッタ眼鏡の接続も含めた、立体内視鏡システムの構成を示す図である。

【 図 ２ 】 本発明の第１の実施の形態に係わる、立体内視鏡 １ １ と液晶シャッタ眼鏡 １ ５ を除いた、プロセッサ １ ２ Ａ ， １ ２ Ｂ と他の装置との接続関係を示す、内視鏡システム １ のブロック構成図である。

【 図 ３ 】 本発明の第１の実施の形態に係わる、内視鏡システム １ の設定処理の例を示すフローチャートである。

【 図 ４ 】 本発明の第１の実施の形態に係わる、各プロセッサにおける親子設定画面の例を示す図である。

【 図 ５ 】 本発明の第２の実施の形態に係わる内視鏡システムの構成を示す図である。

【 図 ６ 】 本発明の第２の実施の形態に係わる、内視鏡 ５ １ Ａ 、 ５ １ Ｂ を除いた、プロセッサ ５ ２ Ａ ， ５ ２ Ｂ と他の装置との接続関係を示す、内視鏡システム １ Ａ のブロック構成図である。

【 図 ７ 】 本発明の第２の実施の形態に係わる光源制御信号用の切替スイッチを説明するための図である。

【 図 ８ 】 モニタ １ ４ の画面の表示を説明するための図である。

【 図 ９ 】 各プロセッサに含まれる画像処理プロセッサの構成を示すブロック図である。

## 【 発明を実施するための最良の形態 】

## 【 0 0 1 0 】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。

（ 第 １ の実施の形態 ）

（ 構成 ）

図 １ は、本実施の形態に係わる、立体内視鏡の内部構成と、液晶シャッタ眼鏡の接続も含めた、立体内視鏡システムの構成を示す図である。図 １ に示すように、本実施の形態の立体内視鏡システム １ は、立体内視鏡 １ １ と、２台のプロセッサ １ ２ Ａ 、 １ ２ Ｂ と、３ Ｄ 合成装置 １ ３ と、モニタ １ ４ とから、主として構成されている医療機器システムである。本実施の形態では、医療機器である２台のプロセッサ １ ２ Ａ 、 １ ２ Ｂ は、立体内視鏡システムに使用される。

## 【 0 0 1 1 】

立体内視鏡 １ １ は、細長な挿入部 １ １ ａ と、操作部 １ １ ｂ とを有し、挿入部 １ １ ａ の先端側に視差の異なる２つの光学系を有し、体腔内を撮像する２つの Ｃ Ｃ Ｄ などの撮像装置まで光学像を伝送し、各撮像装置の撮像信号を出力する。２台のプロセッサ １ ２ Ａ ， １ ２

10

20

30

40

50

Bは、それぞれ、立体視内視鏡11の2つの撮像装置から出力される撮像信号を信号処理して映像信号を出力する。3D合成装置13は、プロセッサ12Aと12Bからの映像信号の走査を変換すると共に、映像信号を切り換えて出力するスキャンコンバータである。モニタ14は、3D合成装置13から出力される映像信号を入力して左右の画像を交互に表示する画像表示装置である。

【0012】

また、立体視内視鏡システム1は、モニタ14の表示画面を見るための液晶シャッタ眼鏡15と、この液晶シャッタ眼鏡15のシャッタ開閉を制御するための開閉制御装置16とを、さらに有して構成されている。

後述するように、親プロセッサとしてのプロセッサ12Aには、光源装置17がケーブル17Aを介して接続されている。また、親プロセッサ（以下、親機ともいう）としてのプロセッサ12Aには、他の複数の周辺機器18a、18b、等が接続ケーブル18Aを介して接続されている。周辺機器は、例えば、送ガス装置、デジタル画像記録装置（DVR）、プリンタ、ファイリング装置などである。

【0013】

プロセッサ12Aには、キーボード19が接続されている。また、図示しないが、プロセッサ12Aには、フットスイッチも接続されている。システムが立体内視鏡システムとして動作するときは、親機であるプロセッサ12Aに接続されている、キーボード19、フットスイッチなどの操作機器が使用される。

【0014】

さらに、プロセッサ12Aは、サーバ装置41と接続されている（図2）。サーバ装置41は、例えば、病院内のサーバ装置であり、各種データを保存可能な記憶容量を有する記憶装置を有する。

【0015】

立体視内視鏡11は、操作部11bからそれぞれ延出するカメラケーブル11R、11Lのカメラコネクタ11Ra、11Lbが、それぞれプロセッサ12A、12Bのレセクタブル23a、23bに接続されるようになっている。

【0016】

また、プロセッサ12Aは、コネクタ24aから延出する信号ケーブル25aが、3D合成装置13の信号コネクタ26a又は26bに接続可能になっている。一方、プロセッサ12Bもまた、コネクタ24bから延出する信号ケーブル25bが、3D合成装置13の信号コネクタ26a又は26bに接続可能になっている。ここでは、信号ケーブル25aが信号コネクタ26aに接続され、信号ケーブル25bが信号コネクタ26bに接続されている。

【0017】

尚、本実施の形態では、カメラケーブル11R、11Lのカメラコネクタ11Ra、11Lbは、プロセッサ12A、12Bのレセクタブル23a、23bに対してどちらに接続して良く、また、プロセッサ12A及び12Bもまた3D合成装置13の信号コネクタ26a、26bに対してどちらに接続しても良いように構成されている。

【0018】

また、3D合成装置13は、モニタケーブル27によりモニタ14に接続されている。更に、3D合成装置13は、モニタケーブル27の分岐ケーブルが開閉制御装置16に接続されている。

【0019】

開閉制御装置16は、液晶シャッタ眼鏡15のシャッタ開閉を行うことによって、モニタ14に交互に表示される2つの画像を、ユーザが立体感のある被写体画像として観察することができるようになっている。

また、プロセッサ12Aと12Bとは、信号ケーブル28で接続され、制御における同期が取れるようになっている。

【0020】

さらに、プロセッサ 1 2 A と 1 2 B は、それぞれ画像の同期信号を受信するために、同期ケーブル 2 9 R , 2 9 L により、3 D 合成装置 1 3 と接続されている。

各プロセッサは、ゲンロック、すなわち映像信号の水平同期信号及び垂直同期信号を外部信号に合わせることで、の有効あるいは無効の設定が可能となっている。よって、ユーザは、2 台のプロセッサ 1 2 A、1 2 B を連携させて立体内視鏡システムとして使用するときには、ゲンロックを有効とし、各プロセッサをスタンドアローンで使用するときは、ゲンロックを無効とする。

#### 【 0 0 2 1 】

次に、立体視内視鏡システム 1 の詳細構成を説明する。

立体視内視鏡 1 1 は、挿入部 1 1 a の先端側に被写体の右の光学像を取り込む右光学系 3 1 R 及び、被写体の左の光学像を取り込む左光学系 3 1 L を有して構成されている。

#### 【 0 0 2 2 】

右光学系 3 1 R の結像位置には、リレーレンズ等の右像伝達光学系 3 2 R の光入射端面が配置されており、被写体の右の光学像が入射されて挿入部 1 1 a の後端側に伝達される。そして、右像伝達光学系 3 2 R の光出射端面には、右結像光学系 3 3 R 及び、右撮像装置である C C D ( 電荷結像素子 ) 3 4 R が配置され、この C C D 3 4 R の撮像面に被写体の右の光学像が結像されるようになっている。

#### 【 0 0 2 3 】

一方、左も同様であり、左光学系 3 1 L の結像位置には、左像伝達光学系 3 2 L の光入射端面が配置されており、被写体の左の光学像が入射されて挿入部 1 1 a の後端側に伝達される。そして、左像伝達光学系 3 2 L の光出射端面には、左結像光学系 3 3 L 及び、左撮像装置である C C D 3 4 L が配置され、この C C D 3 4 L の撮像面に被写体の左の光学像が結像されるようになっている。

よって、右光学系 3 1 R、右像伝達光学系 3 2 R、右結像光学系 3 3 R 及び C C D 3 4 R は、体腔内を撮像する撮像装置を有し、撮像信号を出力する 1 つの内視鏡を構成し、左光学系 3 1 L、左像伝達光学系 3 2 L、左結像光学系 3 3 L 及び C C D 3 4 L も、体腔内を撮像する撮像装置を有し、撮像信号を出力する他の 1 つの内視鏡を構成する。

#### 【 0 0 2 4 】

尚、図示しないが、立体視内視鏡 1 1 は、照明光学系が配設されており、光源装置 1 7 からの照明光を先端部まで伝達し、被写体を照明するようになっている。

#### 【 0 0 2 5 】

また、立体視内視鏡 1 1 は、この内部に識別信号発生部として “ 右撮像装置である C C D 3 4 R で撮像された ” ことを示すための右識別信号を出力する I D メモリ 3 5 R と、“ 左撮像装置である C C D 3 4 L で撮像された ” ことを示すための左識別信号を出力する I D メモリ 3 5 L とを有して構成される。

#### 【 0 0 2 6 】

本実施の形態では、これら I D メモリ 3 5 R 及び I D メモリ 3 5 L は、後述するように右 / 左の識別信号として L o w / H i g h の信号を出力するように構成されている。さらに、I D メモリ 3 5 R 及び I D メモリ 3 5 L には、内視鏡の識別情報、すなわち I D 情報も記憶されている。

尚、I D メモリ 3 5 R , 3 5 L は、カメラコネクタ 1 1 R a , 1 1 L b に内蔵されても良い。また、I D メモリの代わりにプルアップ抵抗を用いて、左 / 右の識別、内視鏡の識別を検知するように構成しても良い。

#### 【 0 0 2 7 】

立体視内視鏡 1 1 は、カメラコネクタ 1 1 R a , 1 1 L b を、プロセッサ 1 2 A 又はプロセッサ 1 2 B のレセクタブル 2 3 a , 2 3 b に接続することで、カメラケーブル 1 1 R , 1 1 L に挿通配設されている信号線を介して C C D 3 4 R , 3 4 L は、プロセッサ 1 2 A、1 2 B 内の図示しない駆動回路で制御駆動される。そして、制御駆動された C C D 3 4 R , 3 4 L は、結像された被写体の光学像を光電変換して、電荷を蓄積する。

#### 【 0 0 2 8 】

10

20

30

40

50

そして、CCD34R, 34Lで蓄積された電荷は、駆動回路にて撮像信号として読み出され、カメラケーブル11R, 11Lに挿通配設されている信号線を介してプロセッサ12A、12B内の映像信号変換回路に出力され、この映像信号変換回路で標準的な映像信号に変換されて3D合成装置13に伝達される。

【0029】

プロセッサ12Aは、CCD34R等を含む第1の内視鏡と接続され、その内視鏡からの撮像信号を処理して画像信号を出力する、医療機器としてのプロセッサを構成し、プロセッサ12Bは、CCD34L等を含む第2の内視鏡と接続され、その内視鏡からの撮像信号を処理して画像信号を出力する、医療機器としてのプロセッサを構成する。

【0030】

また、IDメモリ35Rの右識別信号は、カメラケーブル11Rに挿通配設されている信号線により伝送され、プロセッサ12A又は12Bを介して3D合成装置13に伝達される。一方、IDメモリ35Lの左識別信号もまた、カメラケーブル11Lに挿通配設されている信号線により伝送され、プロセッサ12A又は12Bを介して3D合成装置13に伝達される。

【0031】

3D合成装置13は、2つの画像信号により三次元画像を生成する三次元画像生成装置を構成する。

3D合成装置13は、プロセッサ12A及び12Bからの映像信号を切り換えながら、モニタ14に出力する。そして、モニタ14は、入力された映像信号に基き、表示画面上に左右の映像を交互に表示する。

【0032】

ここで、開閉制御装置16は、図示しない赤外線送信機を有して構成されている。一方、液晶シャッタ眼鏡15は、図示しない赤外線受信機を有し、開閉制御装置16との赤外線通信にて液晶シャッタ15R, 15Lの開閉の切り換えを行うようになっている。

【0033】

液晶シャッタ眼鏡15は、開閉制御装置16の制御により、モニタ14に右目の映像が表示されている間、右の液晶シャッタ15Rが開き、左の液晶シャッタ15Lが閉じて右目のみでモニタ14の映像を観察することができる。

【0034】

一方、逆に液晶シャッタ眼鏡15は、モニタ14に左目の映像が表示されている間、左の液晶シャッタ15Lが開き、右目の液晶シャッタ15Rが閉じて、左目のみでモニタ14の映像を観察することができる。

【0035】

図2は、立体内視鏡11と液晶シャッタ眼鏡15を除いた、プロセッサ12A, 12Bと他の装置との接続関係を示す、内視鏡システム1のブロック構成図である。

プロセッサ12Aと12B間を接続する信号ケーブル28は、制御系の信号線CLを含む。プロセッサ12A, 12Bと3D合成装置13とを接続する信号ケーブル25a、25bが、映像信号系の信号線ILを含む。3D合成装置13とモニタ14とを接続するモニタケーブル27が、3D画像系の信号線OLを含む。3D合成装置13からプロセッサ12A、12Bへ同期信号を送信する同期ケーブル29R, 29Lは、同期のための信号線SLを含む。

後述するように、ここでは、プロセッサ12Aが親機として設定され、プロセッサ12Bは子機として設定され、子機の設定が自動で行われる。

【0036】

ところで、モニタ14には、被写体の映像を立体的に表示される場合だけでなく、メニュー画面が表示される場合もある。メニュー画面は、例えばユーザが各種設定を行うために利用される。メニュー画面も2台のプロセッサ12A、12Bからの映像信号を合成してモニタ14に表示することができるが、表示されるメニュー画面は、立体表示である必要はなく、いわゆる2Dでもよい。

10

20

30

40

50

そこで、メニュー画面を表示するときには、モニタ 1 4 への映像出力は、親機の映像信号のみを出力するように、親機（ここではプロセッサ 1 2 A）が、3 D 合成装置 1 3 へ設定あるいは指示できるようになっている。

すなわち、メニュー画面の表示時には、3 D 合成装置 1 3 が親機からの映像信号のみをモニタ 1 4 へ出力するように、ユーザは、設定することができる。よって、ユーザが親機にそのような設定あるいは指示をすると、3 D 合成装置 1 3 は、メニュー画面を表示するときには、親機からの映像信号のみをモニタ 1 4 へ出力する。

#### 【 0 0 3 7 】

また、モニタ 1 4 には静止画が表示される場合がある。例えば、ユーザは、立体内視鏡 1 1 のフリーズボタンを押すと、静止画を取得することができ、モニタ 1 4 に表示される。2 台のプロセッサ 1 2 A、1 2 B からの映像信号は、合成されてモニタ 1 4 に表示される。しかし、2 台のプロセッサ 1 2 A、1 2 B が取得したそれぞれの静止画の取得タイミングに差があると、合成されて表示される静止画は、ブレて（すなわち、ちらついて）表示される場合がある。

#### 【 0 0 3 8 】

そこで、静止画を表示するときには、モニタ 1 4 への映像出力は、親機の映像信号のみを出力するように、親機（ここではプロセッサ 1 2 A）が、3 D 合成装置 1 3 へ設定あるいは指示することができるようになっている。

すなわち、静止画の表示時には、3 D 合成装置 1 3 が親機からの映像信号のみをモニタ 1 4 へ出力するように、ユーザは、設定することができる。よって、ユーザが親機にそのような設定あるいは指示をすると、3 D 合成装置 1 3 は、静止画を表示するときには、親機からの映像信号のみをモニタ 1 4 へ出力する。

#### 【 0 0 3 9 】

また、2 台のプロセッサ 1 2 A、1 2 B を連携させて立体内視鏡システムとして使用するときには、2 台のプロセッサ 1 2 A、1 2 B の時計を合わせる、すなわち時刻を合わせる処理が行われるが、2 台のプロセッサ 1 2 A、1 2 B の時刻にずれが生じるときがあるため、モニタ 1 4 の画面上に表示される時計表示がブレて表示される場合がある。そこで、時計表示は、親機の時計表示のみを出力するように、親機（ここではプロセッサ 1 2 A）が、3 D 合成装置 1 3 へ設定あるいは指示することができるようになっている。

#### 【 0 0 4 0 】

さらにまた、システムが立体内視鏡システムとして使用される場合は、ユーザは、液晶シャッタ眼鏡 1 5 を使用してモニタ 1 4 を見るため、液晶シャッタ眼鏡 1 5 を使用しないで 2 D 表示のモニタ 1 4 をみるときに比べて、ユーザには画面が暗く見える。そこで、システムが立体内視鏡システムとして使用される場合は、親機（ここではプロセッサ 1 2 A）は、モニタ 1 4 の明るさを上げるように設定の変更をする調整信号をモニタ 1 4 に出力する。

#### 【 0 0 4 1 】

さらに、システムが立体内視鏡システムとして使用される場合は、ユーザの操作は、親機に対して行われるので、子機（ここではプロセッサ 1 2 B）は、自己の操作パネルのランプ、例えば L E D（発光ダイオード）ランプ、を消灯させる。よって、親機の操作パネルの L E D ランプのみが点灯し、子機の操作パネルの L E D ランプは消灯しているので、ユーザは子機に対して誤って操作をするということがない。

なお、子プロセッサに接続されている周辺機器があった場合には、親プロセッサは、子プロセッサに接続されている周辺機器に対する制御を行わない。

#### 【 0 0 4 2 】

（作用）

図 3 は、内視鏡システム 1 の設定処理の例を示すフローチャートである。

まず、図 1 及び図 2 に示すように、プロセッサ 1 2 A、1 2 B と他の装置が接続された後に、いずれのプロセッサを親機とし、いずれのプロセッサを子機とするかを設定する親子設定処理が行われる（S 1）。各プロセッサは、親子の設定機能を有している。ここで

10

20

30

40

50

は、プロセッサ 1 2 A を親機とし、プロセッサ 1 2 B を子機とするので、各プロセッサの設定画面において、各プロセッサについて親子の設定が行われる。

【 0 0 4 3 】

図 4 は、各プロセッサにおける親子設定画面の例を示す図である。図 4 は、プロセッサ 1 2 A に対して、例えば所定の操作を行うことによって、モニタ 1 4 の画面上に表示される設定ウインドウを示す。モニタ 1 4 の画面上に表示されるウインドウ 4 2 は、各種動作を設定するためのウインドウであり、図 4 では、各種動作の中のプロセッサ動作の設定の枠 4 3 内に、動作モードを設定する設定フィールド 4 4 が表示されている。

【 0 0 4 4 】

内視鏡システム 1 のユーザは、プロセッサ 1 2 A を親機として設定するために、図 4 の画面において、設定フィールド 4 4 に、「Link\_Master」を入力し、あるいは選択している状態が示されている。図 4 の設定を、プロセッサ 1 2 A のフラッシュメモリなどの内部メモリに登録することによって、プロセッサ 1 2 A は、「親」として設定され、その設定内容は、記憶される。

【 0 0 4 5 】

図示しないが、プロセッサ 1 2 B についても、図 4 のウインドウ 4 2 をモニタ 1 4 の画面上に表示させて、ユーザは、プロセッサ 1 2 B を「子」として設定する。例えば、設定フィールド 4 4 には、「Link\_Slave」が入力、あるいは選択されて、プロセッサ 1 2 B に登録される。

「親」として設定されたプロセッサ 1 2 A は、「子」として設定されたプロセッサ 1 2 B よりも上位の優先順位を有し、「子」として設定されたプロセッサ 1 2 B は、「親」として設定されたプロセッサ 1 2 A よりも上位の優先順位となる。すなわち、S 1 の処理により、プロセッサ 1 2 A は、上位の優先順位に決定され、プロセッサ 1 2 B は、下位の優先順位に決定される。

【 0 0 4 6 】

また、動作モードの設定では、プロセッサが単独で 사용되는場合は、設定フィールド 4 4 には、「Stand\_Alone」が入力、あるいは選択されて、プロセッサに登録される。

なお、親子の設定は、各プロセッサの操作パネル、あるいは専用の切替スイッチなどによって、設定できるようにしてもよい。

【 0 0 4 7 】

2 台のプロセッサ 1 2 A , 1 2 B について、親子の設定がされた後、親機として機能するプロセッサは、2 台のプロセッサ 1 2 A , 1 2 B がそれぞれ正しく「親」と「子」に設定されているか否かを判定する ( S 2 )。ここでは、「親」として設定されたプロセッサ 1 2 A が判定処理を行う。

【 0 0 4 8 】

この判定は、プロセッサ 1 2 A が、制御線 C L である信号ケーブル 2 8 を介してプロセッサ 1 2 B と通信して、プロセッサ 1 2 B の動作モードの情報を得て、自己の動作モードと比較することによって、行われる。

【 0 0 4 9 】

もしも、2 台のプロセッサがそれぞれ正しく「親」と「子」に設定されているとき、すなわちプロセッサ 1 2 B の動作モードが「子」で、自己の動作モードが「親」として設定されているときは ( S 2 : Y E S )、親プロセッサは、自己の設定情報を子プロセッサへ送信する ( S 3 )。ここでは、プロセッサ 1 2 A が、自己の設定情報を、プロセッサ 1 2 B へ送信する。

【 0 0 5 0 】

S 3 において送信される設定情報は、色調などの画質設定と、アスペクト比などの映像出力設定に関する設定情報である。立体内視鏡システム 1 が 2 台のプロセッサ 1 2 A、1 2 B で構築される場合に、プロセッサ 1 2 A と 1 2 B は、少なくとも、一部の設定が共通している必要がある。

すなわち、S 3 の処理は、S 1 における所定の操作に基づき、上位の優先順位に決定さ

10

20

30

40

50

れた医療機器であるプロセッサ１２Ａの設定内容を、下位の優先順位に決定された医療機器であるプロセッサ１２Ｂへ送信する送信部を構成する。

【００５１】

もしも、２台のプロセッサがそれぞれ正しく「親」と「子」に設定されていないとき、例えばプロセッサ１２Ｂの動作モードも自己の動作モードも共に「親」として設定されているときは（Ｓ２：ＮＯ）、親プロセッサは、自己の設定情報を子プロセッサへ送信しないで（Ｓ４）、処理は終了する。

【００５２】

親プロセッサの設定情報が子プロセッサへ送信されると（Ｓ３）、子プロセッサは、自己の設定情報を、受信した親プロセッサの設定情報に更新する（Ｓ５）。ここでは、プロセッサ１２Ｂは、プロセッサ１２Ａからの設定情報で、対応する自己の設定情報を更新する。

10

【００５３】

なお、ここでは、子プロセッサは、親プロセッサから受信した全ての設定情報について、自己の設定情報を更新しているが、親プロセッサが子プロセッサにおいて更新の必要な情報を含む設定情報を送信して、子プロセッサは、受信した設定情報の中から更新の必要な情報のみを抽出して、設定情報の更新を行うようにしてもよい。すなわち、子プロセッサは、受信した設定情報の中から、親プロセッサと共通する設定情報を選択あるいは抽出して、自己の設定内容と共通する設定のみを更新するようにしてもよい。

すなわち、Ｓ５の処理は、子プロセッサにおいて、受信した親プロセッサの設定内容のうち、子プロセッサの設定内容と共通する設定（例えば画質設定、映像出力設定等の設定）を、受信した親プロセッサの設定内容に変更する設定内容変更部を構成する。なお、Ｓ３とＳ５の処理が、親プロセッサの設定内容を、子プロセッサに送信して、子プロセッサの設定内容を、受信した親プロセッサの設定内容に基づき変更する設定内容変更部を構成するということもできる。

20

【００５４】

そして、子プロセッサは、Ｓ５の処理後、自己の操作パネルのＬＥＤランプを消灯する。

【００５５】

以上の優先順位の確認と設定の更新とが行われると、親プロセッサは、立体内視鏡システムとして正しく動作するためには、接続されている立体内視鏡１１と３Ｄ合成装置１３の確認が行われる。

30

具体的には、親プロセッサであるプロセッサ１２Ａは、接続されている内視鏡の左右が正しいか、接続されている内視鏡のＩＤが同じか、さらに３Ｄ合成装置は、接続されているか、を確認する。これらの確認がされると、接続されている立体内視鏡の左右が逆に接続されていたり、２台の立体内視鏡が接続されていたりしておらず、かつ３Ｄ合成装置も正しく接続されているので、ユーザは、立体視を正しく行うことができる。

【００５６】

すなわち、このような接続されている立体内視鏡と３Ｄ合成装置の確認が行われた後、プロセッサ１２Ａとプロセッサ１２Ｂは、連携して立体内視鏡システムとしての機能を実現可能となる。

40

そして、親プロセッサは、立体内視鏡システムとして子プロセッサと連携して動作するときは、モニタ、キーボード、各種周辺機器の制御を行う。

【００５７】

以上のようにして、上述した実施の形態によれば、２台のプロセッサを用いて立体内視鏡システムを構築するときに、共通する設定が不要となる。

【００５８】

（第２の実施の形態）

第１の実施の形態は、立体内視鏡システムにおいて２台のプロセッサが連携して使用される場合の例であるが、第２の実施の形態では、２台のプロセッサを用いて、同時式の内

50

視鏡システムと面順次式の内視鏡システムの両方が利用でき、かつ周辺機器が共用される場合の例である。

【 0 0 5 9 】

( 構成 )

図 5 は、本実施の形態に係わる内視鏡システムの構成を示す図である。図 5 に示すように、本実施の形態の内視鏡システム 1 A は、2つの内視鏡 5 1 A、5 1 B と、2台のプロセッサ 5 2 A、5 2 B と、モニタ 5 3 と、光源装置 5 4 と、キーボード 5 5 とから、主として構成されている医療機器システムである。モニタ 5 3 等の周辺機器は、後述するように親機として設定されたプロセッサ 5 2 A に接続されている。

【 0 0 6 0 】

内視鏡 5 1 A、5 1 B は、それぞれ細長な挿入部 5 1 A a、5 1 B a と、操作部 5 1 A b、5 1 B b とを有し、挿入部の先端側に光学系を有し、体腔内を撮像する C C D などの撮像装置まで光学像を伝送し、撮像装置の撮像信号を出力する。内視鏡 5 1 A は、プロセッサ 5 2 A に接続可能な内視鏡であり、内視鏡 5 1 B は、プロセッサ 5 2 B に接続可能な内視鏡である。プロセッサ 5 2 A は、接続された内視鏡 5 1 A の撮像装置から出力される撮像信号を信号処理して画像信号である映像信号を出力する。プロセッサ 5 2 B は、接続された内視鏡 5 1 B の撮像装置から出力される撮像信号を信号処理して画像信号である映像信号を出力する。モニタ 5 3 は、プロセッサ 5 2 A に接続され、映像信号を入力して画像を表示する画像表示装置である。

【 0 0 6 1 】

後述するように、プロセッサ 5 2 A は、プロセッサ 5 2 B と通信してプロセッサ 5 2 B における内視鏡接続状態を検出することができる。プロセッサ 5 2 A に内視鏡 5 1 A が接続され、プロセッサ 5 2 B に内視鏡 5 1 B が接続されていないときは、プロセッサ 5 2 A は、周辺機器との回路の接続をプロセッサ 5 2 A と接続とする。また、プロセッサ 5 2 A に内視鏡 5 1 A が接続されておらず、プロセッサ 5 2 B に内視鏡 5 1 B が接続されているときは、プロセッサ 5 2 A は、内部において、周辺機器との回路の接続をプロセッサ 5 2 B との接続に切り替える。

【 0 0 6 2 】

以下、プロセッサ 5 2 A が親プロセッサとして設定され、プロセッサ 5 2 B が子プロセッサとして設定されるものとして、以下、構成を説明する。キーボード 5 5 は、親プロセッサとしてのプロセッサ 5 2 A に接続されている。

光源装置 5 4 は、内視鏡 5 1 A、5 1 B へ照明光を供給する装置であり、同時式及び面順次式の両方に対応する所謂ユニバーサル光源装置であり、信号ケーブル 5 4 A を介してプロセッサ 5 2 A に接続されている。

また、親プロセッサとしてのプロセッサ 5 2 A には、他の複数の周辺機器 5 6 a、5 6 b、等が接続ケーブル 5 6 A を介して接続されている。周辺機器は、例えば、送ガス装置、デジタル画像記録装置 ( D V R )、プリンタ、ファイリング装置などである。

【 0 0 6 3 】

さらに、プロセッサ 5 2 A は、サーバ装置 8 1 と接続されている ( 図 6 )。サーバ装置 8 1 は、例えば、病院内のサーバ装置であり、各種データを保存可能な記憶容量を有する記憶装置を有する。

【 0 0 6 4 】

内視鏡 5 1 A、5 1 B の操作部 5 1 A b、5 1 B b から延出するカメラケーブル 6 1 A、6 1 B のカメラコネクタ 6 1 A a、6 1 B b が、それぞれプロセッサ 5 2 A、5 2 B のレセクタブル 6 2 a、6 2 b に接続されている。内視鏡 5 1 A は、同時式の内視鏡システムに用いられる内視鏡であり、内視鏡 5 1 B は、面順次式の内視鏡システムに用いられる内視鏡である。

【 0 0 6 5 】

プロセッサ 5 2 A は、同時式のプロセッサであり、プロセッサ 5 2 B は、面順次式のプロセッサである。

10

20

30

40

50

また、医療機器であるプロセッサ 5 2 A と 5 2 B とは、信号ケーブル 5 7 と 5 8 で互いに接続されている。モニタ 5 3 とプロセッサ 5 2 A とは、信号ケーブル 5 3 A で接続されている。

【 0 0 6 6 】

図 6 は、内視鏡 5 1 A、5 1 B を除いた、プロセッサ 5 2 A、5 2 B と他の装置との接続関係を示す、内視鏡システム 1 A のブロック構成図である。

プロセッサ 5 2 A と 5 2 B を接続する通信用の信号ケーブル 5 7 と、プロセッサ 5 2 A と光源装置 5 4 を接続する信号ケーブル 5 4 A は、制御系の信号線 C L 1 を含む。プロセッサ 5 2 A とモニタ 5 3 を接続する信号ケーブル 5 3 A と、プロセッサ 5 2 A とプロセッサ 5 2 B を接続する信号ケーブル 5 8 が、映像信号系の信号線 I L 1 を含む。プロセッサ 5 2 B の映像出力端子と、プロセッサ 5 2 A の外部入力端子とが、信号ケーブル 5 8 により接続されている。

10

【 0 0 6 7 】

本実施の形態では、プロセッサ 5 2 A が親機として設定され、プロセッサ 5 2 B は子機として設定され、子機の設定が自動で行われる。

図 5 及び図 6 に示す構成のシステムを、同時式の内視鏡システムとして使用する場合、ユーザは、プロセッサ 5 2 A の電源をオンにして、さらに光源装置 5 4 及びその他の周辺機器の電源もオンにして、内視鏡 5 1 A をプロセッサ 5 2 A に接続して、同時式の内視鏡システムとして使用することができる。プロセッサ 5 2 A は、電源がオンされると、内視鏡 5 1 A が接続されていることを検知できるので、プロセッサ 5 2 A を含むシステムは、

20

【 0 0 6 8 】

また、図 5 及び図 6 に示す構成のシステムを、面順次式の内視鏡システムとして使用する場合、ユーザは、プロセッサ 5 2 A と 5 2 B の電源をオンにして、さらに光源装置 5 4 及びその他の周辺機器の電源もオンにして、内視鏡 5 1 B をプロセッサ 5 2 B に接続して、面順次式の内視鏡システムとして使用することができる。プロセッサ 5 2 A は、電源がオンされると、内視鏡 5 1 A が接続されていないことを検知でき、かつプロセッサ 5 2 A は、プロセッサ 5 2 B と信号ケーブル 5 7 を介して通信して、プロセッサ 5 2 B に内視鏡 5 1 B が接続されているか否かの情報を得ることができるので、プロセッサ 5 2 A は、各種周辺機器をプロセッサ 5 2 B と接続するように切り替え、プロセッサ 5 2 B を含むシステムは、面順次式の内視鏡システムとして動作する。

30

【 0 0 6 9 】

なお、プロセッサ 5 2 A に内視鏡 5 1 A が接続され、プロセッサ 5 2 B にも内視鏡 5 1 B が接続されているときは、プロセッサ 5 2 A は、周辺機器との回路の接続をプロセッサ 5 2 A と接続とするように切り替える。

【 0 0 7 0 】

光源装置 5 4 は、同時式システムの場合は、プロセッサ 5 2 A からの光源制御信号により制御され、面順次式のシステムの場合は、プロセッサ 5 2 B からの光源制御信号により制御される。しかし、光源装置 5 4 は、親プロセッサであるプロセッサ 5 2 A にのみ接続されているので、プロセッサ 5 2 B からの制御信号を受けられるように、親プロセッサ 5 2 A 内には、光源制御信号用の切替スイッチが設けられている。

40

【 0 0 7 1 】

図 7 は、光源制御信号用の切替スイッチを説明するための図である。親プロセッサであるプロセッサ 5 2 A は、切替スイッチ 7 1 を有し、切替スイッチ 7 1 は、2 入力 1 出力のスイッチである。切替スイッチ 7 1 は、プロセッサ 5 2 A からの光源装置 5 4 への光源制御信号 L D 1 が切替スイッチ 7 1 の 2 つの入力端子の一方に入力され、プロセッサ 5 2 B からの光源装置 5 4 への制御信号 L D 2 が切替スイッチ 7 1 の 2 つの入力端子の他方に入力されるように、接続されている。切替スイッチ 7 1 の出力は、光源装置 5 4 に供給される。

【 0 0 7 2 】

50

親プロセッサであるプロセッサ 5 2 A は、内視鏡 5 1 A が接続されて同時式のシステムとして動作する場合は、プロセッサ 5 2 A からの光源装置 5 4 への光源制御信号を入力して、光源装置 5 4 へ出力するように、切替スイッチ 7 1 を切り替える。また、プロセッサ 5 2 A は、内視鏡 5 1 B がプロセッサ 5 2 B に接続されて面順次式のシステムとして動作する場合は、図 7 において点線で示すように、プロセッサ 5 2 B からの光源装置 4 への光源制御信号を入力して、光源装置 5 4 へ出力するように、切替スイッチ 7 1 を切り替える。切替スイッチ 7 1 の切替は、プロセッサ 5 2 A 内の制御部からの切替制御信号 L D S により行われる。

【 0 0 7 3 】

なお、ここでは、同時式のプロセッサ 5 2 A を親機としているため、面順次式のプロセッサ 5 2 B 内には、切替スイッチ 7 1 が設けられていないが、面順次式のプロセッサ 5 2 B も親機とすることができるように、プロセッサ 5 2 B にも切替スイッチ 7 1 を設けるようにしてもよい。

【 0 0 7 4 】

また、内視鏡システム 1 A が同時式システムとして使用される場合は、ユーザの操作は、親機に対して行われるので、子機は、自己の操作パネルのランプを消灯するようにしてもよい。よって、親機の操作パネルの操作スイッチなどのみが点灯し、子機の操作パネルは消灯しているので、ユーザは子機に対して誤って操作をするということがない。

【 0 0 7 5 】

さらにまた、以上のように「親」と「子」が設定されて構築された内視鏡システム 1 A では、キーボード 5 5、フットスイッチ（図示せず）等の操作関連装置は、親プロセッサに接続されているものが使用される。よって、子プロセッサが使用されるときにも、親プロセッサに接続されたキーボードによって、入力などを行うことができる。すなわち、上位の優先順位のプロセッサに接続された入力機器が有効とされ、その入力機器から入力された情報が、下位の優先順位のプロセッサに送信される。

【 0 0 7 6 】

（作用）

次に、本実施の形態のシステムの作用を説明するが、内視鏡システム 1 A における設定処理は、図 3 の処理と同じであるので、図 3 を用いて説明する。

図 5 から図 7 に示すように、プロセッサ 5 2 A、5 2 B と他の装置が接続されて内視鏡システム 1 A が構築された後、まず、親子設定処理が行われる（S 1）。S 1 の処理は、第 1 の実施の形態で説明した処理と同様である。

【 0 0 7 7 】

ここでは、プロセッサ 5 2 A を親機とし、プロセッサ 5 2 B を子機とする設定がされとする。親子の設定は、第 1 の実施の形態で説明したように、各プロセッサの設定画面、各プロセッサの操作パネル、あるいは専用の切替スイッチなどによって、設定される。

【 0 0 7 8 】

2 台のプロセッサ 5 2 A、5 2 B のそれぞれについて、親又は子の設定がされた後、親機として機能するプロセッサ、ここでは「親」として設定されたプロセッサ 5 2 A は、2 台のプロセッサ 5 2 A、5 2 B がそれぞれ正しく「親」と「子」に設定されているか否かを判定する（S 2）。

【 0 0 7 9 】

この判定は、プロセッサ 5 2 A が、制御線 C L 1 である信号ケーブル 5 7 を介してプロセッサ 5 2 B と通信して、プロセッサ 5 2 B の動作モードの情報を得て、自己の動作モードと比較することによって行われる。

【 0 0 8 0 】

2 台のプロセッサがそれぞれ正しく「親」と「子」に設定されているとき、すなわちプロセッサ 5 2 B の動作モードが「子」で、自己の動作モードが「親」として設定されているときは（S 2：YES）、親プロセッサは、自己の設定情報を子プロセッサへ送信する（S 3）。ここでは、プロセッサ 5 2 A が、自己の設定情報を、プロセッサ 5 2 B へ送信

10

20

30

40

50

する。

【 0 0 8 1 】

S 3 において送信される設定情報は、アスペクト比などの映像出力設定、及び親プロセッサに接続されている各種周辺機器との接続設定に関する設定情報である。モニタ 5 3 等の周辺機器は、親プロセッサに接続されているため、子プロセッサも、親プロセッサの周辺機器への設定と同じ設定内容に合わせられる。同時式と面順次式の両方が利用できる本システム 1 A が 2 台のプロセッサ 5 2 A、5 2 B で構築される場合に、プロセッサ 5 2 A と 5 2 B は、少なくとも、一部の設定が共通している必要がある。

【 0 0 8 2 】

もしも、2 台のプロセッサがそれぞれ正しく「親」と「子」に設定されていないとき、例えばプロセッサ 5 2 B の動作モードも自己の動作モードも共に「親」として設定されているときは ( S 2 : N O )、親プロセッサの設定情報を子プロセッサへ送信しないで ( S 4 )、処理は終了する。

10

【 0 0 8 3 】

親プロセッサの設定情報が子プロセッサへ送信されると ( S 3 )、子プロセッサは、自己の設定情報を、受信した親プロセッサの設定情報に更新する ( S 5 )。ここでは、プロセッサ 5 2 B は、プロセッサ 5 2 A からの設定情報で、対応する自己の設定情報を更新する。

【 0 0 8 4 】

なお、ここでは、子プロセッサは、親プロセッサから受信した全ての設定情報について、自己の設定情報を更新しているが、親プロセッサが子プロセッサにおいて更新の必要な設定情報を含む設定情報を送信して、子プロセッサは、受信した設定情報の中から更新の必要な設定情報のみを抽出して、設定情報の更新を行うようにしてもよい。すなわち、子プロセッサは、受信した設定情報の中から、親プロセッサと共通する設定情報を選択あるいは抽出して、自己の設定内容と共通する設定のみを更新するようにしてもよい。

20

【 0 0 8 5 】

すなわち、S 5 の処理は、子プロセッサにおいて、受信した親プロセッサの設定内容のうち、子プロセッサの設定内容と共通する設定 (例えば映像出力設定、周辺機器との接続設定等の設定) を、受信した親プロセッサの設定内容に変更する設定内容変更部を構成する。

30

【 0 0 8 6 】

以上のようにして「親」と「子」が設定されて構築された内視鏡システム 1 A を、同時式の内視鏡システムとして使用するとき、内視鏡 5 1 A をプロセッサ 5 2 A に接続することによって、内視鏡システム 1 A は同時式の内視鏡システムとして使用可能となる。

【 0 0 8 7 】

内視鏡 5 1 A がプロセッサ 5 2 A に接続されて内視鏡システム 1 A が同時式の内視鏡システムとして使用される場合、プロセッサ 5 2 A は、自己に接続されている周辺機器を直接制御する。

【 0 0 8 8 】

なお、内視鏡システム 1 A を同時式の内視鏡システムとして使用するとき、プロセッサ 5 2 B の電源がオンされている場合、プロセッサ 5 2 B は自己の操作パネルを消灯するようにしてもよい。

40

また、内視鏡システム 1 A を、面順次式の内視鏡システムとして使用するとき、内視鏡 1 B をプロセッサ 5 2 B に接続することによって、内視鏡システム 1 A は面順次式の内視鏡システムとして使用可能となる。

【 0 0 8 9 】

内視鏡 5 1 B がプロセッサ 5 2 B に接続されて内視鏡システム 1 A が面順次式の内視鏡システムとして使用される場合、プロセッサ 5 2 B からの操作信号及び制御信号は、プロセッサ 5 2 A を介して、モニタ 5 3、光源装置 5 4 も含めて各周辺機器へ供給されるが、プロセッサ 5 2 B においてプロセッサ 5 2 A と共通する設定は、S 4 において更新されて

50

いるので、親プロセッサに接続されている周辺機器を適切に制御して使用することができる。

なお、モニタ 5 3 の画質設定は、同時式と面順次式に応じて、切り替えられるようにしてもよい。

#### 【 0 0 9 0 】

以上のようにして構築された内視鏡システム 1 A によれば、同時式の内視鏡システムとして使用するときには、親プロセッサとして設定されたプロセッサ 5 2 A が周辺機器を制御し、面順次式の内視鏡システムとして使用するときには、親プロセッサは、キーボード、モニタ、他の周辺機器との接続を子プロセッサへ切り換え、親プロセッサを介して子プロセッサとして設定されたプロセッサ 5 2 B が親プロセッサと同様の設定に基づいて、周辺機器を制御する。

10

#### 【 0 0 9 1 】

以上のようにして、上述した実施の形態によれば、2 台のプロセッサを用いて同時式と面順次式の両方を利用できる内視鏡システムを構築したときに、共通する設定が不要となる。

#### 【 0 0 9 2 】

よって、従来のような、同時式と面順次式で共用できる周辺機器の設定し直しなどをしないで、ユーザは、1 つの内視鏡システム 1 A において、同時式と面順次式の内視鏡システムを利用することができる。

#### 【 0 0 9 3 】

以下、上述した 2 つの実施の形態において各プロセッサが有する各種機能について説明する。なお、以下、各種機能について、第 1 の実施の形態の場合を例として説明するが、第 2 の実施の形態にも適用可能である。

20

#### 【 0 0 9 4 】

##### ( 1 ) 表示系機能

図 8 は、モニタ 1 4 の画面の表示を説明するための図である。図 8 に示すように、モニタ 1 4 の画面 1 4 a 上には、内視鏡画像と共に各種情報が表示可能となっている。画面 1 4 a は、内視鏡画像を表示する、8 角形の内視鏡画像表示領域 1 0 1 と、画像に関する各種情報を表示する画像情報表示領域 1 0 2 と、周辺機器などの動作状態を表示する動作状態表示領域 1 0 3 と、ズーム状態を表示するズーム状態表示領域 1 0 4 とを含む。

30

#### 【 0 0 9 5 】

内視鏡画像表示領域 1 0 1 には、内視鏡の撮像装置によって撮像して得られた被写体の映像が表示される。

画像情報表示領域 1 0 2 には、被写体である患者の識別情報（すなわち I D）、氏名、性別、年齢、生年月日、撮影年月日及び時刻等の情報が、表示される。

ここでは、図 8 に示すように、患者名は、漢字と、半角英数カナ文字の、両方で表示されている。

#### 【 0 0 9 6 】

また、ユーザはコメントを自由に入力でき、入力されたコメントは画像情報表示領域 1 0 2 に表示されるが、頻繁に入力するコメントは、登録でき、かつ登録されたコメントが入力されるタイミングも設定することができるようになっている。コメントが入力されるタイミングは、特定のイベントに対応して設定することができる。例えば、画像の取られた病院名などの既定コメントを、検査終了イベントのタイミングで、コメントとして入力することができるようになっている。

40

#### 【 0 0 9 7 】

また、画像情報表示領域 1 0 2 には、各種情報が表示可能であるが、表示される情報を、ユーザがユーザ毎に選択して設定できるようになっている。さらに、設定した所定のイベントに応じて、その表示状態の変更がされるように設定することもできるようになっている。

例えば、検査の開始前の準備時には、全ての表示項目の情報を表示して、ユーザが全て

50

の項目を入力可能となっているが、検査が開始されて検査開始のイベントが検出されると、ユーザにより選択された情報のみが、画像情報表示領域 102 に表示されるようにすることができる。

よって、画像情報表示領域 102 には、各種情報が表示可能であるが、ユーザは、表示されるあるいは消去される情報を、所望のイベントに応じて変更することができる。

#### 【0098】

動作状態表示領域 103 には、プロセッサ、周辺機器等の動作状態が、アイコンで表示される。図 8 では、録画機器に記録された内視鏡画像を表示しているときにおける、録画機器のアイコン表示と、周辺機器のポンプのアイコン表示の例が示されている。図 8 では、録画機器の操作の再生、停止、一時停止、コマ送りの機能アイコンが表示されているが、操作中のアイコンの 1 つが表示され、ユーザは、操作中の操作状態を確認することができる。ポンプについても、光源装置 17 に設けられた送気用などのポンプが動作中であれば、それに対応するアイコン (Air) が表示され、送ガス装置のポンプが動作中であれば、それに対応するアイコン (Gas) が表示される。図 8 では、これらの全てのアイコンが表示されているが、動作中の機能又は機器のアイコンだけが表示される。

#### 【0099】

なお、動作状態表示領域 103 に表示されるこれらのアイコンの表示について、常時表示と、設定時間表示のいずれかを選択して設定できるようになっている。常時表示が選択されて設定されていると、動作状態表示領域 103 には、動作中の機能あるいはポンプに対応するアイコンが常に表示される。設定時間表示が選択されて設定されていると、動作状態表示領域 103 には、動作に変化のあった機能あるいはポンプに対応するアイコンが、予め設定された時間だけ表示され、その後は消えるようになる。

#### 【0100】

ズーム状態表示領域 104 は、ズーム機能を有する内視鏡が接続されている場合に表示され、ズーム状態表示領域 104 には、現在のズーム位置が、広角 (W) と望遠 (T) の間のどの位置にあるかが、四角いアイコンの位置によって、示される。

#### 【0101】

また、図示しないが、内視鏡に設けられた複数のスイッチや、プロセッサ等に接続された 1 又は 2 以上のフットスイッチは、各種機能を割り当てることができ、かつ変更することもできるが、割り当てられた各スイッチの機能をユーザが確認できるように、どのスイッチに何の機能が割り当てられているかを示す情報を、画面 14a 上に、表示できるようになっている。例えば、内視鏡の操作部のスイッチ 1 には、リリースボタン機能が割り当てられ、操作部のスイッチ 2 は、録画ボタン機能が割り当てられ、フットスイッチ 1 には、プリント機能が割り当てられ、というように、各種ボタンに各種機能が割り当てられる。ユーザが所定のキー操作等を行うと、画面 14a 上に、各スイッチとその割り当てられた機能とを対応付けた対応リストが表示される。よって、ユーザは、スイッチに割り当てられた機能を確認したい場合は、その所定のキー操作等を行うと、予め決められた時間だけ、その対応リストが表示されるので、ユーザは、各スイッチの機能を確認することができる。

#### 【0102】

さらにまた、ユーザは、接続されている内視鏡の仕様を、画面 14a 上に表示させて確認することができる。ユーザは、例えばキーボード 19 に対して所定の操作をすると、内視鏡の情報を表示するウィンドウが、画面 14a 上に表示される。そのウィンドウには、内視鏡の機種名、シリアルナンバー、チャンネル径、先端径、挿入部径等が表示されるが、各径と共に、各部の外周長も並べて表示される。手技に応じて、径表示 (例えば mm (ミリメートル)) よりも、外周長表示 (例えば fr (フレンチ)) の方が、ユーザにとっては理解し易い場合があるからである。

#### 【0103】

### (2) メッセージ系機能

画面 14 上には、各種メッセージが表示可能となっている。メッセージは、例えば、エ

10

20

30

40

50

ラーメッセージである。図 8 において、一点鎖線で示すように、所定のメッセージウインドウ 1 1 1 が画面 1 4 a 上に現れて、エラーメッセージ等のメッセージが表示される。

【 0 1 0 4 】

メッセージには、予め定められた優先順位が付けられている。メッセージウインドウ 1 1 1 の数は、予め決められており、表示すべきメッセージが、その予め決められた数を超えると、優先順位の高いものからその予め決められた数のメッセージだけが表示可能となる。よって、複数のメッセージが発生したときは、最も優先順位の高いメッセージが表示され、それよりも低い優先順位のメッセージは、優先順位の高いメッセージに隠れて表示されない。言い換えれば、優先順位の高いメッセージウインドウ 1 1 1 が優先順位の低いメッセージウインドウ 1 1 1 の上に重ねて表示される。そして、例えば最上位の優先順位のメッセージに対応するエラーの発生原因が除去されると、そのエラーメッセージに対応するメッセージウインドウ 1 1 1 は消えるが、その次に優先順位の高いメッセージのメッセージウインドウ 1 1 1 が現れるように表示制御が行われる。

10

【 0 1 0 5 】

メッセージウインドウ 1 1 1 には、周辺機器の誤接続時のエラーメッセージも表示される。親プロセッサには、複数の周辺機器が接続され、かつ同じ形式のコネクタが複数存在する。例えば、U S B (Universal Serial Bus) 等の共通規格のコネクタが複数あるため、ユーザは、間違ったコネクタに周辺機器を接続してしまう場合がある。

【 0 1 0 6 】

そこで、親プロセッサは、各コネクタに周辺機器が接続されると、その周辺機器と通信してその周辺機器の種別情報を得て、コネクタ毎に、正しい周辺機器が接続されているか否かをチェックし、間違った周辺機器が接続されていると、エラーメッセージウインドウ 1 1 1 を画面 1 4 a 上に表示して、ユーザに対する警告を行う。

20

【 0 1 0 7 】

( 3 ) 周辺機器制御機能

内視鏡システム 1 の親プロセッサには、種々の周辺機器が接続可能であるため、光源装置 1 7 が送気用のポンプを有し、体内に二酸化炭素を送るための送ガス装置が接続されている場合もある。送ガス装置が動作しているときに、光源装置 1 7 の送気用のポンプが動作すると、体腔内の二酸化炭素濃度が低下してしまうので、二酸化炭素濃度が低下しないように制御するために、光源装置 1 7 のポンプと送ガス装置のポンプの排他制御が行われる。ユーザにより光源装置 1 7 のポンプがオンする指示がされた後に、送ガス装置のポンプに対するオンの指示がされたときには、親プロセッサは、後の指示を有効とし、光源装置 1 7 のポンプを停止し、送ガス装置のポンプをオンとする、というように、後からの指示を有効とする制御が行われる。作動中のポンプは、上述したように、画面 1 4 a 上にアイコンで表示される。

30

【 0 1 0 8 】

また、各プロセッサは、接続された内視鏡の情報を記憶する機能を有する。すなわち、各プロセッサは、内視鏡の接続履歴の情報を不揮発性メモリに、ログデータとして記録する。

【 0 1 0 9 】

また、各周辺機器は自己の動作ログデータを記録しているので、親プロセッサは、接続されている複数の周辺機器のログデータを収集して、サーバ装置 4 1 に送信する機能を有している。

40

【 0 1 1 0 】

また、接続されている周辺機器も時計機能と有している場合は、親プロセッサは、各周辺機器に時刻情報を送信して、各周辺機器の時計を、自己の時計と合わせるようになっている。

【 0 1 1 1 】

なお、キーボード 1 9 に、特定の周辺機器の特定の機能を実行するためのキーを設けるようにしてもよい。例えば、モニタ 1 4 に対して、P I P (Picture In Picture) 機能、

50

P O P (Picture Out Picture) 機能を有効とするための専用のキーや、モニタ 1 4 の表示チャンネルの切替スイッチを、キーボード 1 9 に設ける。このようにすれば、ユーザは、周辺機器を直接操作しなくても、キーボード 1 9 から周辺機器を操作可能となる。

【 0 1 1 2 】

また、親プロセッサには、周辺機器がコネクタと一対一で接続されるだけでなく、1つのコネクタに数珠繋ぎで複数の周辺機器が接続される場合がある。そのような場合に、同一機能の装置が複数接続されている場合は、親プロセッサは、エラーメッセージ表示を行う。例えば、録画機器が複数接続されている場合は、親プロセッサは、1つの録画機器しか制御できないため、そのような場合は、上述したいようなエラーメッセージが表示される。

10

【 0 1 1 3 】

また、内視鏡故障時、プロセッサ故障時、等、内視鏡システム 1 が正常に動作できない場合は、親プロセッサは、図 8 の一点鎖線で示すように、画面 1 4 a 上に、画面を大きく覆う、故障表示のウインドウ 1 1 2 を表示して、故障が検知されたことをユーザに告知するようになっている。

【 0 1 1 4 】

また、親プロセッサは、所定の操作に応じて、内視鏡システム 1 を構成する装置の一覧を表示することができる。例えば、ユーザが、キーボード 1 9 に対して、所定の操作を行うと、画面 1 4 a 上に、システム構成情報として、プロセッサ、光源装置、内視鏡、プリンタ、録画機器などの、種別情報や製造番号などを、リスト形式で示すウインドウが表示されるようになっている。

20

【 0 1 1 5 】

また、親プロセッサは、自己の設定画面において、周辺機器の設定を行うことが可能となっている。その結果、ユーザは、周辺機器の設定を、周辺機器毎に設定画面をモニタ 1 4 に表示させて行う必要がない。親プロセッサの設定画面中に、接続される周辺機器の設定項目が含まれているので、ユーザは、その設定画面を用いて各周辺機器の設定を行うことができる。

【 0 1 1 6 】

また、親プロセッサは、静止画を記録することができるが、記録した静止画を外部メモリにも記録することができる。たとえば、外部メモリとして U S B メモリがあるが、外部メモリに正しくデータを書き込むことができない場合がある。そこで、親プロセッサは、接続された外部メモリの簡易チェック機能を有する。

30

ここでは、親プロセッサは、テストデータを外部メモリに書き込み、その後読み出して、正しく読み出されるかを確認し、さらに、書き込んだデータを消去して、その後データが正しく消去されているかを確認する、という処理工程を実行することにより、外部メモリの簡易チェック機能が実現される。

【 0 1 1 7 】

( 4 ) 設定系機能

親プロセッサは、自己及び周辺機器の設定内容を U S B メモリなどの外部メモリに保存する機能を有している。さらに、親プロセッサは、外部メモリに記録されている設定内容を、自己及び周辺機器の設定に反映させる機能も有している。

40

よって、ユーザは、一度設定した内容を再度入力し直したりせずに、あるシステムで設定した内容を、他の内視鏡システムにおいても利用することができる。

【 0 1 1 8 】

また、セキュリティ上、設定画面を表示させるために、ユーザは、自己の I D とパスワードを入力しないと、設定画面が表示されないようになっている。設定画面には、種々の設定画面があるが、セキュリティの必要な設定画面を表示しようとする、ユーザは、自己の I D とパスワードの入力が求められ、正しく認証されると、設定画面が表示される。

【 0 1 1 9 】

なお、各種設定画面を起動するための設定画面リストを表示させるときに、ユーザに、

50

ＩＤとパスワードの入力を求めるようにしてもよい。

また、図 8 に示すように、患者の生年月日を表示するときに、元号の記号が表示されるが、各プロセッサでは、新たな元号の設定と登録も可能となっている。

【 0 1 2 0 】

また、ユーザは、キーボードを操作しなくても、所定の操作を行うことができるようになっている。例えば、ユーザが親プロセッサに対して所定の操作を行うと、画面 1 4 a 上に、複数の操作機能ボタンが表示される。画面上に表示された各ボタンは、プロセッサのフロントパネル上の上下左右の矢印キーで、選択用のカーソルを移動可能となっており、ユーザが所望の機能のボタンを選択した状態で、フロントパネル上の決定キーを操作すると、選択された機能が実行される。よって、ユーザは、キーボード 1 9 を用いなくても、親プロセッサや各種機器に対して、所望の操作を指示することができる。

10

【 0 1 2 1 】

( 5 ) 静止画記録機能

また、プロセッサのフロントパネルには、「検査」ボタンが設けられており、ユーザは、検査開始のトリガー、及び検査終了のトリガーをプロセッサに指示できるようになっている。「検査」ボタンを押すことにより、検査開始となって、フロントパネルとキーボードのＬＥＤランプが点灯して検査中が表示され、再度「検査」ボタンが押されると、検査終了のトリガーとなって、フロントパネルとキーボードのＬＥＤランプが消灯する。

さらに、プロセッサは、設定により、「検査」ボタンを無効とすることもできる。

【 0 1 2 2 】

20

なお、ユーザが「検査」ボタンを押すのを忘れて検査開始のトリガーを指示するのを失念した場合のために、静止画あるいは動画の記録指示が最初にされたことが検知されると、その指示が、検査開始のトリガーとなるように、なっている。

【 0 1 2 3 】

さらになお、ユーザが検査終了のトリガーを指示するのを失念したときのために、プロセッサの電源のオフ、あるいは内視鏡の取り外しが検出されたときを、検査終了のトリガーとするように、ユーザはプロセッサに設定することができるようになっている。

【 0 1 2 4 】

よって、「検査」ボタンの機能が有効と設定されている場合に、検査終了のトリガーが指示されずにプロセッサの電源オフ等がされたときは、次にプロセッサがオンされたときには、前回の検査は、検査終了とされる。

30

【 0 1 2 5 】

また、同様に、検査中に、患者情報の変更がされようとしたときには、画面上に検査終了であるかを、ユーザに確認させるようになっている。よって、この確認がされたときに、それまでの検査を検査終了とするように、ユーザは、プロセッサに設定することができる。

【 0 1 2 6 】

さらに、プロセッサは、内部メモリに静止画を記録するが、内部メモリに空き容量がなくなったときでも記録操作を中止せず、プリンタなど周辺機器への記録をできるようになっている。

40

さらにまた、内視鏡には、記録する画像あるいは記録した画像が重要な画像であることを示すフラグなどの情報を記録するための、専用のボタンが設けられている。例えば、通常の記録のためのリリースボタンと、重要な画像であることも記録するための第 2 のリリースボタンを、内視鏡の操作部に設け、ユーザは、検査後に重要な画像であるがわかるようになる。なお、専用のボタンは、プロセッサに設けても良い。

【 0 1 2 7 】

( 6 ) ＰＣ用出力機能

各プロセッサは、パーソナルコンピュータ（以下、ＰＣという）用のモニタへの出力端子を有する。そのため、各プロセッサは、インターレース方式の映像信号を、プログレッシブ方式の映像信号に変換するインターレース・プログレッシブ変換（以下、ＩＰ変換と

50

いう)を行うと共に、フレームレート変換も行うが、2つの変換のための処理回路の規模を小さくし、処理遅延を小さくするために、2つの変換を1つのメモリを用いて行っている。

【0128】

図9は、各プロセッサに含まれる画像処理プロセッサの構成を示すブロック図である。画像処理プロセッサ91は、デジタルの映像信号が入力される画像処理部92と、フィールドメモリ93と、フレームレート変換部94と、IP変換部95と、モニタ出力処理部96とを含む。

【0129】

画像処理部92は、入力された映像信号をフィールドメモリ93へ書き込み、フレームレート変換部94が、フィールドメモリ93に書き込まれる映像信号の読み出しのタイミングを制御する。IP変換部95は、フィールドメモリ93からの映像信号に基づいて、プログレッシブ方式の映像信号を生成してIP変換を行う。

10

【0130】

具体的には、フィールドメモリ93には、奇数フィールドの映像信号と偶数フィールドの映像信号が記憶され、フレームレート変換部94は、フィールドメモリ93に記憶された奇数フィールドの映像信号と偶数フィールドの映像信号の読み出しのタイミングを制御することで、入力フレームレートと出力フレームレートの周波数のズレを吸収する。

【0131】

IP変換部95は、同一のフレーム出力期間内に読み出した、最新の奇数フィールドと1つ前の偶数フィールドの映像信号、あるいは最新の偶数フィールドと1つ前の奇数フィールドの映像信号から、プログレッシブ映像信号を生成して、モニタ出力処理部96へ出力する。

20

【0132】

出力フレームレートが入力フレームレートよりも高いときは、同じフィールドの映像信号を2回出力するようにして、周波数のズレが吸収される。また、出力フレームレートが入力フレームレートよりも低いときは、出力されないフィールドの映像信号を設けることにより、周波数のズレが吸収される。

【0133】

さらに、IP変換部95は、2つのフィールドの映像信号から1つの出力フレームを生成するときに、例えば3点メディアンによる方法を用いた、メディアンフィルタ処理をして出力フレームの映像信号を生成する。

30

なお、IP変換部95は、メディアンフィルタの代わりに、動き量に応じて切り替えられるフィルタ処理、補間演算による合成処理、等を行うようにしてもよい。

以上のように、フレームレート変換とIP変換を共通のフィールドメモリを用いて行うので、処理回路の規模を小さくし、処理遅延も小さくすることができる。

【0134】

以上説明した各実施の形態によれば、2台の医療機器を組み合わせて使用するとき、共通する設定が不要な医療機器システムを提供することができる。


本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲において、種々の変更、改変等が可能である。

40


【0135】

本出願は、2011年8月26日に日本国に出願された特願2011-185130号を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範囲に引用されるものとする。


【図 1】

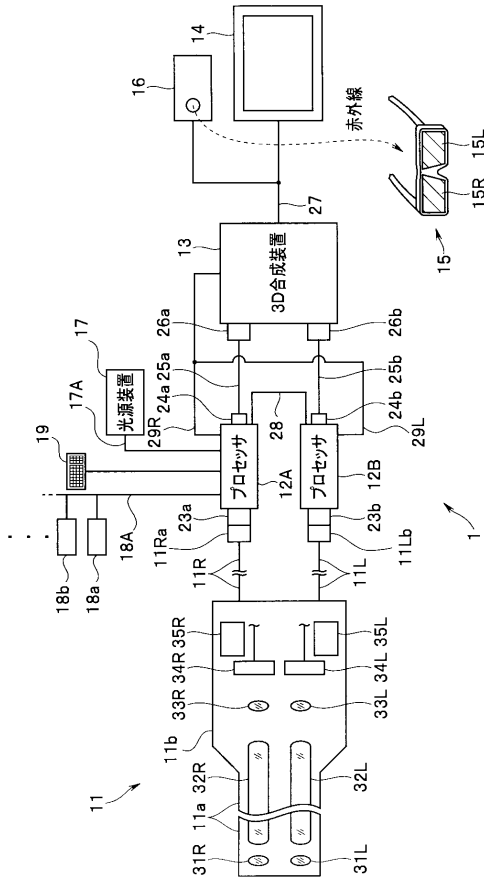


【図 2】

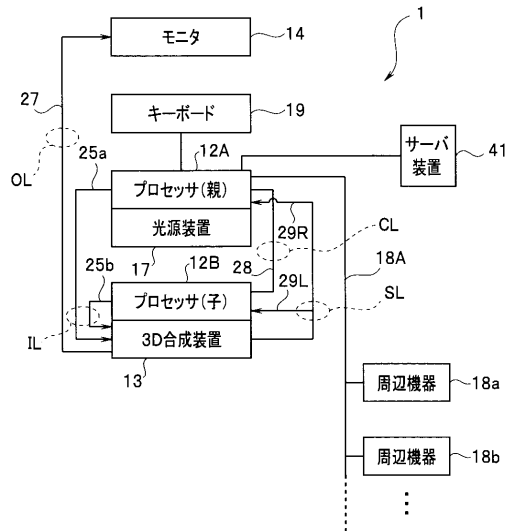


【図 3】

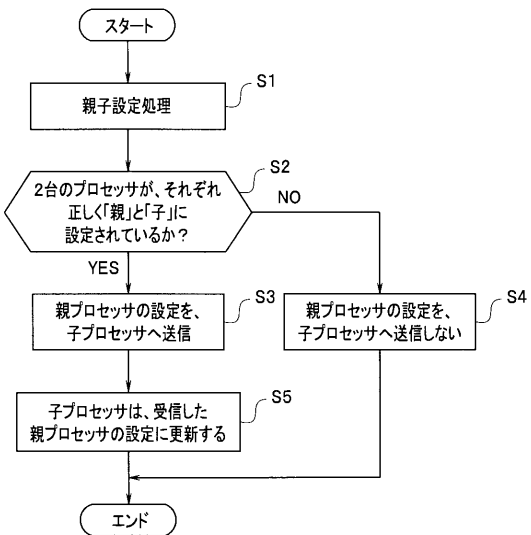


【図 4】

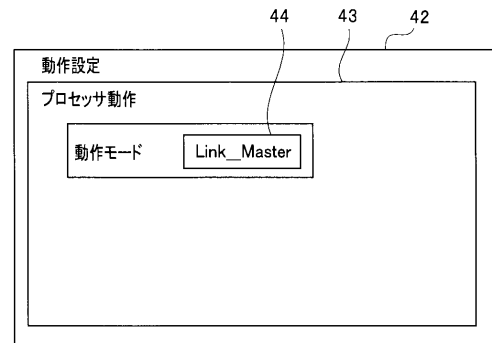


【図 5】

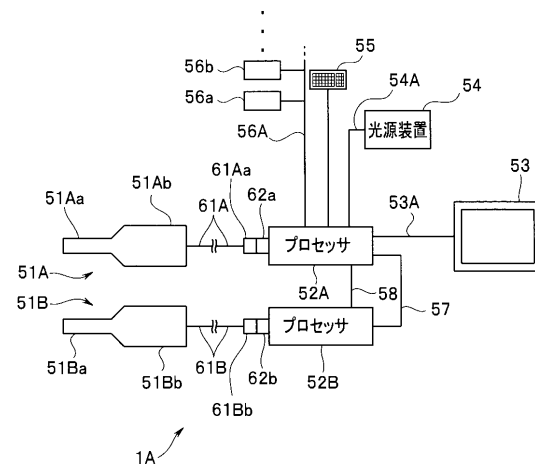


【図 6】

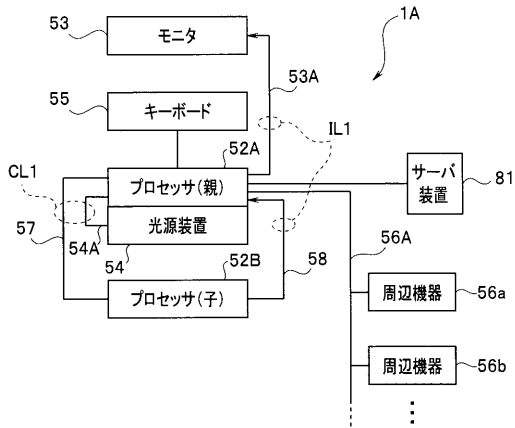


【図 7】

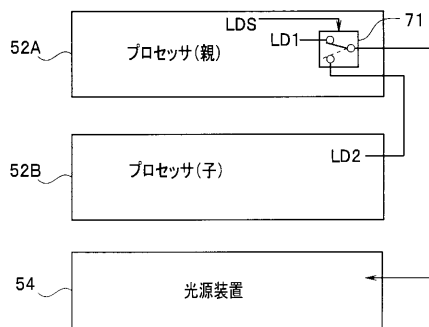

【図 9】

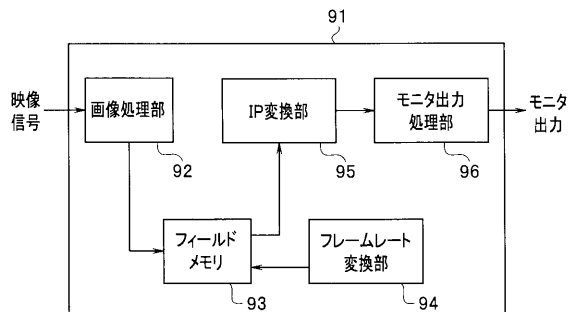

【図 8】

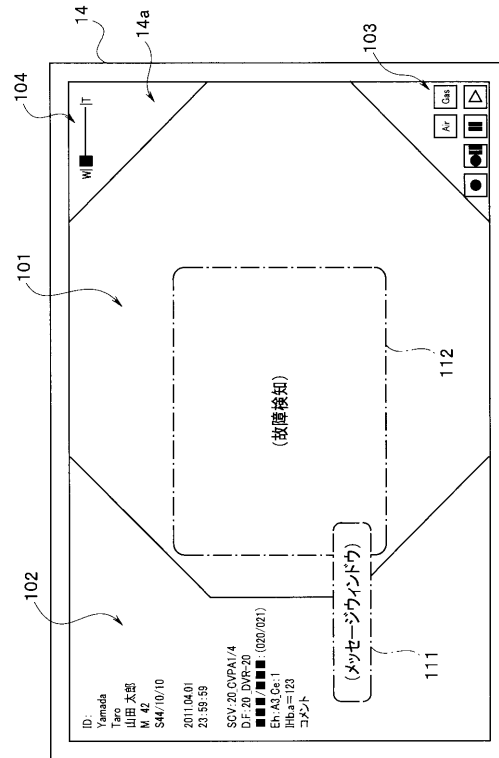

## 【手続補正書】

【提出日】平成25年4月26日(2013.4.26)

## 【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0001

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0001】

本発明は、内視鏡システムに関し、特に、少なくとも一部の設定を共通にする2台の医療機器を含む内視鏡システムに関する。

## 【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

そこで、本発明は、2台の医療機器を用いてシステムを構築するときに、共通する設定が不要な内視鏡システムを提供することを目的とする。

## 【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

本発明の一態様の内視鏡システムは、第1のプロセッサと第2のプロセッサとが通信可能に接続されている内視鏡システムにおいて、体腔内を撮像し、第1の撮像信号を出力する第1の撮像素子と、前記第1の撮像素子からの前記第1の撮像信号を処理して第1の画像信号を出力し、通信により、設定されている第1の設定内容を送信する第1のプロセッサと、前記体腔内を撮像し、第2の撮像信号を出力する第2の撮像素子と、前記第1のプロセッサよりも優先順位が低く決定され、前記第2の撮像素子からの前記第2の撮像信号を処理して第2の画像信号を出力し、通信により、前記第1のプロセッサから受信した前記設定内容に基づき、共通する設定内容を変更する第2のプロセッサと、前記第1の画像信号と前記第2の画像信号により三次元画像を生成する三次元画像生成装置と、前記第1のプロセッサへの操作指示が入力される操作機器と、を備え、前記第1のプロセッサは、前記操作機器に静止画表示の操作指示が入力されると、前記第1の画像信号のみを出力するように前記三次元画像生成装置へ設定あるいは指示する。

## 【手続補正5】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1のプロセッサと第2のプロセッサとが通信可能に接続されている内視鏡システムにおいて、

体腔内を撮像し、第1の撮像信号を出力する第1の撮像素子と、  
前記第1の撮像素子からの前記第1の撮像信号を処理して第1の画像信号を出力し、通信により、設定されている第1の設定内容を送信する第1のプロセッサと、  
前記体腔内を撮像し、第2の撮像信号を出力する第2の撮像素子と、  
前記第1のプロセッサよりも優先順位が低く決定され、前記第2の撮像素子からの前記

第 2 の撮像信号を処理して第 2 の画像信号を出力し、通信により、前記第 1 のプロセッサから受信した前記設定内容に基づき、共通する設定内容を変更する第 2 のプロセッサと、

前記第 1 の画像信号と前記第 2 の画像信号により三次元画像を生成する三次元画像生成装置と、

前記第 1 のプロセッサへの操作指示が入力される操作機器と、  
を備え、

前記第 1 のプロセッサは、前記操作機器に静止画表示の操作指示が入力されると、前記第 1 の画像信号のみを出力するように前記三次元画像生成装置へ設定あるいは指示することを特徴とする内視鏡システム。

**【請求項 2】**

前記第 1 の撮像素子と前記第 2 の撮像素子は、内視鏡に設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡システム。

**【請求項 3】**

前記設定内容は、画質設定と映像出力設定に関する情報を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡システム。

**【請求項 4】**

前記第 2 のプロセッサは、受信した前記第 1 のプロセッサの前記設定内容の中から更新に必要な情報のみを抽出して更新を行うことにより、前記共通する設定内容を変更することを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡システム。

**【請求項 5】**

前記第 2 のプロセッサは、前記設定内容の変更の後、自己の操作パネルのランプを消灯することを特徴とする請求項 1 に記載の内視鏡システム。

## 【 国際調査報告 】

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/070317

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

A61B1/04(2006.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61B1/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

|                           |           |                            |           |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Jitsuyo Shinan Koho       | 1922-1996 | Jitsuyo Shinan Toroku Koho | 1996-2012 |
| Kokai Jitsuyo Shinan Koho | 1971-2012 | Toroku Jitsuyo Shinan Koho | 1994-2012 |

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                               | Relevant to claim No. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| X         | JP 2000-19426 A (Olympus Optical Co., Ltd.),<br>21 January 2000 (21.01.2000),<br>(Family: none)                                  | 1-10                  |
| X         | JP 2003-38432 A (Pentax Corp.),<br>12 February 2003 (12.02.2003),<br>paragraphs [0029], [0043], [0048], [0058]<br>(Family: none) | 1, 3, 7-10            |
| X         | JP 2003-38422 A (Pentax Corp.),<br>12 February 2003 (12.02.2003),<br>paragraphs [0026], [0037], [0040], [0045]<br>(Family: none) | 1, 3, 7-10            |

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.
 ☐ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&amp;" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
31 August, 2012 (31.08.12)Date of mailing of the international search report  
11 September, 2012 (11.09.12)Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/070317

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                                                                         | Relevant to claim No. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A         | JP 2009-279060 A (Hoya Corp.),<br>03 December 2009 (03.12.2009),<br>paragraphs [0028] to [0030], [0034]<br>& US 2009/290016 A1                                             | 1-10                  |
| A         | JP 2006-288831 A (Olympus Medical Systems Corp.),<br>26 October 2006 (26.10.2006),<br>paragraphs [0033] to [0036], [0047]<br>(Family: none)                                | 1-10                  |
| A         | JP 2010-35874 A (Olympus Medical Systems Corp.),<br>18 February 2010 (18.02.2010),<br>paragraphs [0011], [0016]<br>& US 2010/160728 A1 & EP 2151182 A1<br>& CN 101642363 A | 1-10                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| 国際調査報告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | 国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 2 / 0 7 0 3 1 7                   |         |
| <b>A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））</b><br>Int.Cl. A61B1/04(2006, 01) i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                        |         |
| <b>B. 調査を行った分野</b><br>調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））<br>Int.Cl. A61B1/04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                        |         |
| 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの<br>日本国実用新案公報 1922-1996年<br>日本国公開実用新案公報 1971-2012年<br>日本国実用新案登録公報 1996-2012年<br>日本国登録実用新案公報 1994-2012年                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |                                                        |         |
| 国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                        |         |
| <b>C. 関連すると認められる文献</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |                                                        |         |
| 引用文献の<br>カテゴリー*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示                                                         | 関連する<br>請求項の番号                                         |         |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JP 2000-19426 A（オリンパス光学工業株式会社）<br>2000.01.21,（ファミリーなし）                                    | 1-10                                                   |         |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JP 2003-38432 A（ペンタックス株式会社）<br>2003.02.12, 段落【0029】、【0043】、【0048】、<br>【0058】<br>（ファミリーなし） | 1, 3, 7-10                                             |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                        |         |
| * 引用文献のカテゴリー<br>「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの<br>「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの<br>「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）<br>「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献<br>「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献<br>「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの<br>「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの<br>「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの<br>「&」同一パテントファミリー文献 |                                                                                           |                                                        |         |
| 国際調査を完了した日<br>31.08.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | 国際調査報告の発送日<br>11.09.2012                               |         |
| 国際調査機関の名称及びあて先<br>日本国特許庁（ISA/J P）<br>郵便番号100-8915<br>東京都千代田区霞が関三丁目4番3号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | 特許庁審査官（権限のある職員）<br>小田倉 直人<br>電話番号 03-3581-1101 内線 3292 | 2Q 9163 |

| 国際調査報告                |                                                                                                                              | 国際出願番号 PCT/J P 2 0 1 2 / 0 7 0 3 1 7 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| C (続き) . 関連すると認められる文献 |                                                                                                                              |                                      |
| 引用文献の<br>カテゴリー*       | 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示                                                                                            | 関連する<br>請求項の番号                       |
| X                     | JP 2003-38422 A (ペンタックス株式会社)<br>2003.02.12, 段落【0026】、【0037】、【0040】、<br>【0045】<br>(ファミリーなし)                                   | 1, 3, 7-10                           |
| A                     | JP 2009-279060 A (HOYA株式会社)<br>2009.12.03, 段落【0028】－【0030】、【0034】<br>& US 2009/290016 A1                                     | 1－10                                 |
| A                     | JP 2006-288831 A (オリンパスメディカルシステムズ株式会社)<br>2006.10.26, 段落【0033】－【0036】、【0047】<br>(ファミリーなし)                                    | 1－10                                 |
| A                     | JP 2010-35874 A (オリンパスメディカルシステムズ株式会社)<br>2010.02.18, 段落【0011】、【0016】<br>& US 2010/160728 A1 & EP 2151182 A1 & CN 101642363 A | 1－10                                 |

## フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN

(72)発明者 玉井 宏

東京都渋谷区幡ヶ谷 2 丁目 4 3 番 2 号 オリンパスメディカルシステムズ株式会社内

Fターム(参考) 4C161 BB06 CC06 FF40 JJ18 JJ19 LL03 LL08 MM03 MM04 NN05


NN07 WW01 WW10 WW18 XX10 YY07

(注) この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

|                |                                                                                                                                                                                 |         |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 专利名称(译)        | 内窥镜系统                                                                                                                                                                           |         |            |
| 公开(公告)号        | <a href="#">JPWO2013031512A1</a>                                                                                                                                                | 公开(公告)日 | 2015-03-23 |
| 申请号            | JP2013519894                                                                                                                                                                    | 申请日     | 2012-08-09 |
| [标]申请(专利权)人(译) | 奥林巴斯医疗株式会社                                                                                                                                                                      |         |            |
| 申请(专利权)人(译)    | オリンパスメディカルシステムズ株式会社                                                                                                                                                             |         |            |
| [标]发明人         | 浦崎剛<br>大島龍<br>玉井宏                                                                                                                                                               |         |            |
| 发明人            | 浦崎 剛<br>大島 龍<br>玉井 宏                                                                                                                                                            |         |            |
| IPC分类号         | A61B1/04                                                                                                                                                                        |         |            |
| CPC分类号         | A61B1/00009 A61B1/00006 A61B1/00193                                                                                                                                             |         |            |
| FI分类号          | A61B1/04.370                                                                                                                                                                    |         |            |
| F-TERM分类号      | 4C161/BB06 4C161/CC06 4C161/FF40 4C161/JJ18 4C161/JJ19 4C161/LL03 4C161/LL08 4C161/MM03 4C161/MM04 4C161/NN05 4C161/NN07 4C161/WW01 4C161/WW10 4C161/WW18 4C161/XX10 4C161/YY07 |         |            |
| 代理人(译)         | 伊藤 进<br>长谷川 靖<br>ShinoUra修                                                                                                                                                      |         |            |
| 优先权            | 2011185130 2011-08-26 JP                                                                                                                                                        |         |            |
| 其他公开文献         | JP5331948B2                                                                                                                                                                     |         |            |
| 外部链接           | <a href="#">Espacenet</a>                                                                                                                                                       |         |            |

#### 摘要(译)

内窥镜系统包括处理器12A和12B，并且处理器中的设置至少部分地是共同的。并且，基于预定的操作（S1），将被确定为具有较高优先级的处理器12A中的设置内容发送到被确定为具有较低优先级的处理器12B（S3），并且处理器12B将处于在接收到的处理器12A的设置内容之中，与处理器12B中的设置内容相同的数据（S5）。

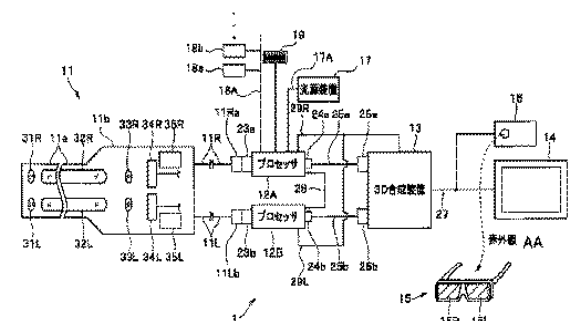

- 17 Light source apparatus
- 12A, 12B Processors
- 13 3D combination apparatus
- AA Infrared radiation