

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2017-164511

(P2017-164511A)

(43) 公開日 平成29年9月21日 (2017.9.21)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 1/00 (2006.01)	A 6 1 B 1/00 5 5 0	2 H 0 4 0
G 0 1 N 27/333 (2006.01)	G 0 1 N 27/333 3 3 1 Z	4 C 0 3 8
G 0 1 N 27/416 (2006.01)	G 0 1 N 27/416 3 5 1 E	4 C 1 6 1
A 6 1 B 5/07 (2006.01)	A 6 1 B 5/07 1 0 0	
A 6 1 B 10/00 (2006.01)	A 6 1 B 10/00 T	

審査請求 有 請求項の数 8 O L (全 15 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2017-81368 (P2017-81368)	(71) 出願人	504171134
(22) 出願日	平成29年4月17日 (2017.4.17)		国立大学法人 筑波大学
(62) 分割の表示	特願2013-2957 (P2013-2957)		茨城県つくば市天王台一丁目1番1
	の分割	(74) 代理人	100106909
原出願日	平成25年1月10日 (2013.1.10)		弁理士 棚井 澄雄
		(74) 代理人	100188558
			弁理士 飯田 雅人
		(74) 代理人	100169764
			弁理士 清水 雄一郎
		(72) 発明者	金子 剛
			茨城県つくば市天王台一丁目1番1 国立
			大学法人筑波大学内
		(72) 発明者	福田 淳二
			茨城県つくば市天王台一丁目1番1 国立
			大学法人筑波大学内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 大腸癌検出装置、大腸癌検出キット、被験体における大腸癌の可能性を判断するための被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度の測定方法、及び大腸癌の進行度を予測するためのデータを

(57) 【要約】

【課題】大腸内視鏡検査において、定性的な視覚情報に加えて、鉄イオン濃度測定に基づく定量的な情報をリアルタイムに得られる大腸癌検出装置を提供する。

【解決手段】本発明の大腸癌検出装置は、被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度を測定するための鉄センサーを備えることを特徴とする。

【選択図】なし

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度を測定するための鉄センサーを備えることを特徴とする大腸癌検出装置。

【請求項 2】

被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度を測定するための鉄センサー又は鉄イオン測定キットを備えることを特徴とする大腸癌検出キット。

【請求項 3】

さらに、内視鏡を備え、

前記内視鏡は被験者の体腔内に少なくとも一部が導入され、前記被験者の内部の被写体の撮像を行うものである請求項 2 に記載の大腸癌検出キット。

【請求項 4】

被験体における大腸癌の可能性を判断するための被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度の測定方法であって、

被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度を測定する測定工程と、

前記鉄イオン濃度が大腸癌の所見の認められなかった患者の鉄イオン濃度よりも高い場合に、被験体が大腸癌である可能性が高いと判断する判断工程と、
を備えることを特徴とする方法。

【請求項 5】

前記測定工程において、鉄センサー又は鉄イオン測定キットを用いる請求項 4 に記載の方法。

【請求項 6】

前記判断工程において、前記鉄イオン濃度が $15 \mu\text{M}$ 以上である場合に、被験体が大腸癌である可能性が高いと判断する請求項 4 又は 5 に記載の方法。

【請求項 7】

大腸癌の進行度を予測するためのデータを収集する方法であって、

大腸にポリープなどの病変を有する患者から消化管洗浄液を採取する採取工程と、

前記消化管洗浄液中の鉄イオン濃度を測定する測定工程と、

前記鉄イオン濃度と前記鉄イオン濃度と対応する患者の大腸病変の大きさとが相関関係にあることを指標として前記患者における大腸癌の進行度を予測する予測工程と、
を備えることを特徴とする方法。

【請求項 8】

前記測定工程において、鉄センサー又は鉄イオン測定キットを用いる請求項 7 に記載の方法。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、大腸癌検出装置、大腸癌検出キット、被験体における大腸癌の可能性を判断するための被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度の測定方法、及び大腸癌の進行度を予測するためのデータを収集する方法に関する。

【背景技術】**【0002】**

内視鏡は、鉗子チャンネルに連通する鉗子口を有しており、鉗子などの内視鏡処置具が、該鉗子チャンネルに挿通されている。係る内視鏡は、内視鏡処置具を介して、観察対象の内部の腫瘍の採取や摘出をすることができる（例えば、特許文献 1 参照）。

このように、内視鏡は、観察対象の内部の視覚情報を取得するだけでなく、患者の処置や治療をする器具としての機能を有している。

【先行技術文献】**【特許文献】****【0003】**

10

20

30

40

50

【特許文献 1】特開 2 0 1 2 - 2 0 0 4 1 5 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

近年、内視鏡に多機能性が求められており、内視鏡検査から得られる情報を補完するための技術が必要とされている。

【0005】

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、大腸内視鏡検査において、定性的な視覚情報に加えて、鉄イオン濃度測定に基づく定量的な情報をリアルタイムに得られる大腸癌検出装置を提供することを目的とする。

10

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明者らは上記の課題を解決するため、鋭意研究を行った結果、被験体由来の消化管洗浄液を分析する鉄センサーを備えた内視鏡により課題を解決できることを見出した。本発明の一実施態様は、下記(1)～(8)を提供するものである。

(1) 本発明の大腸癌検出装置は、被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度を測定するための鉄センサーを備えたことを特徴とする。

(2) 本発明の大腸癌検出キットは、被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度を測定するための鉄センサー又は鉄イオン測定キットを備えたことを特徴とする。

(3) 本発明の大腸癌検出キットは、さらに、内視鏡を備え、前記内視鏡は被験者の体腔内に少なくとも一部が導入され、前記被験者の内部の被写体の撮像を行うものであることが好ましい。

20

(4) 本発明の被験体における大腸癌の可能性を判断するための被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度の測定方法は、被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度を測定する測定工程と、前記鉄イオン濃度が大腸癌の所見の認められなかった患者の鉄イオン濃度よりも高い場合に、被験体が大腸癌である可能性が高いと判断する判断工程と、を備えたことを特徴とする方法である。

(5) 本発明の被験体における大腸癌の可能性を判断するための被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度の測定方法は、前記測定工程において、鉄センサー又は鉄イオン測定キットを用いることが好ましい。

30

(6) 本発明の被験体における大腸癌の可能性を判断するための被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度の測定方法は、前記判断工程において、前記鉄イオン濃度が $15 \mu\text{M}$ 以上である場合に、被験体が大腸癌である可能性が高いと判断することが好ましい。

(7) 本発明の大腸癌の進行度を予測するためのデータを収集する方法は、大腸にポリープなどの病変を有する患者から消化管洗浄液を採取する採取工程と、前記消化管洗浄液中の鉄イオン濃度を測定する測定工程と、前記鉄イオン濃度と前記鉄イオン濃度と対応する患者の大腸病変の大きさとが相関関係にあることを指標として前記患者における大腸癌の進行度を予測する予測工程と、を備えたことを特徴とする方法である。

(8) 本発明の大腸癌の進行度を予測するためのデータを収集する方法は、前記測定工程において、鉄センサー又は鉄イオン測定キットを用いることが好ましい。

40

【発明の効果】

【0007】

本発明によれば、定性的な視覚情報に加えて、鉄イオン濃度測定に基づく定量的な情報をリアルタイムに得られる。

【図面の簡単な説明】

【0008】

【図 1】イオン選択性電極を用いた鉄イオン濃度測定の説明図である。

【図 2】大腸癌検出用鉄センサー 1 の要部を示した縦断面図である。

【図 3】大腸癌検出用鉄センサー 1 の横断面図である。

【図 4】大腸癌検出用鉄センサー 1 の縦断面図である。

50

【図 5】大腸癌検出用鉄センサー 11 の要部を示した縦断面図である。

【図 6】大腸癌検出用鉄センサー 11 の横断面図である。

【図 7】大腸癌検出用鉄センサー 11 の縦断面図である。

【図 8】(a) は、内視鏡 200 の斜視図である。(b) は、内視鏡 200 の先端部分 201 の横断面図である。

【図 9】内視鏡 300 の斜視図である。

【図 10】内視鏡カプセル 400 の斜視図である。

【図 11】実施例において作製した鉄イオン選択電極及び参照電極の写真である。

【図 12】鉄イオン濃度(横軸)と電位差(縦軸)との関係を示したキャリブレーションプロットを示すグラフである。(a) は、0.1 M KCl に鉄イオンを加えたサンプルの測定結果を示し、(b) は、消化管洗浄液に鉄イオンを加えたサンプルの測定結果を示す。

【図 13】実施例における様々な患者から採取した消化管洗浄液中の鉄イオン濃度測定結果である。

【発明を実施するための形態】

【0009】

[大腸内視鏡検査]

本発明の内視鏡を説明するにあたり、先ず、本発明の内視鏡を用いた大腸内視鏡検査法について説明する。本発明の内視鏡を用いた大腸内視鏡検査法は、患者である被験者由来の消化管洗浄液を分析する工程を有する。

【0010】

被験者由来の消化管洗浄液としては、消化管洗浄液を経口投与し、本発明の内視鏡を直腸から挿入して吸収採取した溶液、又は、被験者の体腔内に溜まった消化管洗浄液が挙げられる。消化管洗浄液としては、市販の大腸内視鏡検査用洗浄溶液が挙げられる。被験者由来の消化管洗浄液の採取方法としては、例えば、大腸内視鏡検査前日に、大腸癌検診を受ける者に 2 L の大腸内視鏡検査用洗浄溶液を飲んでもらい、検査当日に採取する方法が挙げられる。

本発明の内視鏡を用いた大腸内視鏡検査においては、消化管洗浄液の溜まりやすい S 状結腸まで内視鏡を挿入すればよいため、検診を受ける者の身体的負担が軽減される。

【0011】

前記被験者由来の消化管洗浄液を分析する工程は、前記消化管洗浄液中の鉄イオンの濃度を測定する工程であることが好ましい。係る工程においては、従来公知の被験者由来の消化管洗浄液であれば特別な処置を必要しないという簡便さを有する点で優れている。例えば、消化管洗浄液中に PEG (ポリエチレングリコール) が存在する場合には、これを用いた抗原抗体反応において反応効率の低減を考慮する必要があるが、係る工程においては、消化管洗浄液中に PEG が存在していても測定系に何ら影響を与えるおそれがない。

【0012】

前記被験者由来の消化管洗浄液を分析する工程は、イオン選択性電極を用いて前記消化管洗浄液中の鉄イオンの濃度を測定する工程である工程が好ましい。

本発明において、イオン選択性電極とは、特定のイオンと選択的に応答する電極を意味する。イオン選択性電極を用いた測定系の概略を図 1 に示す。イオン選択性電極を用いた測定系 70 は、測定試料中に含まれるイオンの濃度を測定するイオン選択性電極 71 と、外部参照電極 72 と、電位差計 73 を有する。

本発明においては、陽イオン A^+ (鉄イオン) に応答するイオン選択性電極 71 を用いる。イオン選択性電極 71 は、内部参照電極 71a、及び目的イオン A^+ (鉄イオン) の活量 a_A が一定の内部溶液 71b および陽イオンのみを透過することのできるイオン選択膜 71c から構成されている。

外部参照電極 72 は、内部参照電極 72a、外部電極内部液 72b、及び液絡部 72c から構成されている。

【0013】

図1のように、イオン選択性電極71と外部参照電極72を目的イオン（鉄イオン）の活量（ a_A ）sampleの試料溶液74（被験体由来の消化管洗浄液）に浸す。このとき、2つの電極の電位差（起電力）をEとすると、これは次式（1-1）で表される。

【0014】

【数1】

$$E = E_{ref, int} - E_{ref, ext} + E_{memb} + E_{lj} \quad \dots (1-1)$$

【0015】

ここで、 $E_{ref, int}$ 及び $E_{ref, ext}$ はそれぞれ内部参照電極71aおよび外部参照電極72の電極電位であり、 E_{memb} はイオン選択膜71cを介して内部溶液71bと試料溶液74（被験体由来の消化管洗浄液）の間に発生する膜電位である。また、 E_{lj} は外部参照電極72と試料溶液74（被験体由来の消化管洗浄液）の間に発生する液間電位差である。イオン選択膜71cが、 A^+ （鉄イオン）のみを透過させる理想的な場合、膜電位は次式（1-2）で表される。

10

【0016】

【数2】

$$E_{memb} = \frac{RT}{z_A F} \ln \left[\frac{(a_A)_{sample}}{(a_A)_{int}} \right] \quad \dots (1-2)$$

20

【0017】

ここで、 z_A は目的イオンの電荷数、 R は気体定数、 T は絶対温度、 F はファラデー定数である。

内部参照電極71aおよび外部参照電極72の電極電位は一定であり、液間電位差が無視できれば、 $(a_A)_{int}$ は一定であるので、式（1-1）は式（1-2）を用いて次式（1-3）となる。これはイオン選択性電極の基本式で、ネルンストの式と呼ばれる。

【0018】

【数3】

30

$$\begin{aligned} E &= E^{\circ} + \left(\frac{RT}{z_A F} \right) \ln(a_A)_{sample} \\ &= E^{\circ} + \left(\frac{2.30RT}{z_A F} \right) \log(a_A)_{sample} \quad \dots (1-3) \end{aligned}$$

40

【0019】

ここで、 E° は電極の構成により決まる定数である。 $2.30RT/z_A F$ はネルンスト係数と呼ばれ、試料溶液中の目的イオンの活量が10倍変化したときの起電力の変化量であり、25℃では1価のイオンに対して59.16mV、2価のイオンに対して29.58mVである。測定された起電力Eより、式（1-3）を用いて試料溶液74（被験体由来の消化管洗浄液）中の目的イオン（鉄イオン）の活量が決定できる。イオンの活量 a_A と濃度 C_A には $a_A = f_A C_A$ の関係があるので、 A^+ イオンの活量係数 f_A が分かれば濃度 C_A を求めることができる。

従って、本発明において、既知の鉄イオン濃度と得られた電位差との関係を表したスタンダードカーブを作成し、該スタンダードカーブから被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イ

50

オンの濃度を測定することができる。

【 0 0 2 0 】

イオン選択性電極 7 1 は、内部参照電極 7 1 a、内部溶液 7 1 b、及びイオン選択膜 7 1 c から構成されている。

内部参照電極 7 1 a としては、金属 / ハロゲン化金属電極が挙げられ、銀 / 塩化銀線が好ましい。内部溶液 7 1 b としては、塩化カリウム水溶液、塩化銅水溶液などの金属塩水溶液、塩化カリウム水溶液、及び他の金属塩水溶液との混合溶液が挙げられ、硝酸鉄と塩化カリウムとの混合溶液が好ましい。

イオン選択膜 7 1 c としては、特に限定されず、ポリ塩化ビニル、シリコンゴム、ポリ塩化ビニリデン、ポリウレタン、フォトレジスト、漆などの公知の高分子を膜材料とするものが挙げられる。高いイオン選択性を実現するという観点から、膜材料に、可塑剤を混合し、溶媒に溶解して成膜してなる液体膜が好ましい。このような液体膜には、目的イオン以外のイオン（対イオン）の膜中への取り込みを防ぐために、テトラキス〔 3 , 5 - ピス（トリフルオロメチル）フェニル〕ホウ酸カリウム等の塩を添加してもよい。

【 0 0 2 1 】

外部参照電極 7 2 は、内部参照電極 7 2 a、外部電極内部液 7 2 b、及び液絡部 7 2 c から構成されている。内部参照電極 7 2 a としては、金属 / ハロゲン化金属電極が挙げられ、銀 / 塩化銀線が好ましい。外部電極内部液 7 2 b としては、塩化カリウム水溶液、塩化銅水溶液などの金属塩水溶液が挙げられ、塩化カリウム水溶液が好ましい。塩化カリウム水溶液はゲル化していてもよい。塩化カリウム水溶液がゲル化していると参照電極の耐圧性を向上できる。

【 0 0 2 2 】

以上のとおりのイオン選択膜を有するイオン選択性電極を、外部参照電極とともに従来公知の方法に従い試料溶液（被験体由来の消化管洗浄液）に浸漬することにより両電極間の電位差が測定される。係る電位差から、試料溶液（被験体由来の消化管洗浄液）中のイオン濃度が算出される。

【 0 0 2 3 】

[大腸癌検出用鉄センサー]

第一実施形態

本発明の内視鏡は、上述した被験体由来の消化管洗浄液を分析する鉄センサーを備えている。以下に、大腸癌検出用鉄センサーの好ましい形態について説明する。

【 0 0 2 4 】

図 2 は、本実施形態の大腸癌検出用鉄センサー 1 の要部を示した縦断面図である。図に示すように、本実施形態の大腸癌検出用鉄センサー 1 は、円筒状に形成されたイオン選択性電極 3 0 及び外部参照用電極 2 0 を備えている。これらの電極には、それぞれリード線 3 が接続しており、これらリード線 3 は電位差計を有する図示略のイオン濃度測定装置本体に接続されている。

そして、イオン選択性電極 3 0 と外部参照用電極 2 0 を、鉄イオン濃度を求めたい被験体由来の消化管洗浄液に浸漬又は接触させると、内部液と消化管洗浄液との間に鉄イオン濃度の差に応じた起電力が生じ、その起電力が、イオン選択性電極 3 0 と、外部参照用電極 2 0 との電位差となって表れる。図示略のイオン濃度測定装置本体は、その電位差をパラメータとして、被験体由来の消化管洗浄液の鉄イオン濃度を表示する。

【 0 0 2 5 】

図 3 は、大腸癌検出用鉄センサーの第一実施形態の横断面図であり、図 4 の A - A 線方向の断面図である。図 4 は、大腸癌検出用鉄センサーの第一実施形態の縦断面図である。

図 3 及び図 4 に示されるように、本実施形態の大腸癌検出用鉄センサー 1 は、円筒状に形成された外筒体 1 0 と、外筒体 1 0 内に相互に離間して配置されたイオン選択性電極 3 0 及び外部参照用電極 2 0 と、これらの電極と外筒体 1 0 との間に充填された電極固定用組成物の硬化体 4 0 と、イオン選択性電極 3 0 及び外部参照用電極 2 0 側の端面 5 0 に、これら電極の端部 2 2 , 3 2 を覆うように固着された電解質結晶体 6 0 と、これら電極 2

10

20

30

40

50

０、３０、電極固定用組成物の硬化体４０、及び電解質結晶体６０の一端外周域を被覆する微孔膜８０と、を備えている。

【００２６】

イオン選択性電極３０及び外部参照用電極２０としては、上述したものが挙げられる。

外筒体１０としては、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネート等の従来公知の可とう性樹脂から形成されてなるものが好ましい。

電極固定用組成物の硬化体４０としては、消化管洗浄液に浸漬又は接触させても膨潤しない等の観点から、従来公知の（メタ）アクリル酸系モノマー類と重合開始剤を含有する電極固定用組成物の硬化体が好ましい。

10

電解質結晶体６０としては、塩化カリウム結晶体が好ましい。

微孔膜８０としては、鉄イオン透過性を有するものであれば特に限定されず、外筒体１０を構成する材質と同じものから形成されてなるものが好ましい。

【００２７】

第二実施形態

図５は、本実施形態の大腸癌検出用鉄センサー１１の要部を示した縦断面図である。図に示すように、本実施形態の大腸癌検出用鉄センサー１１は、外部参照用電極１２０が、イオン選択性電極１３０の側面を覆うように取り囲み、これらが一体となって円筒状に形成されたものを備えている（図６参照）。イオン選択性電極１３０及び外部参照用電極１２０には、それぞれリード線３が接続しており、これらリード線３は電位差計を有する図示略のイオン濃度測定装置本体に接続されている。更に、イオン選択性電極１３０のイオン選択膜１３０ａは、外部参照用電極１２０の液絡部１２０ａを含む底面より突出しており、これらイオン選択膜１３０ａ及び液絡部１２０ａが消化管洗浄液と接触できるように形成されている。

20

【００２８】

図６は、大腸癌検出用鉄センサーの第二実施形態の横断面図であり、図７のＢ－Ｂ線方向の断面図である。図７は、大腸癌検出用鉄センサーの第二実施形態の縦断面図である。

図６及び図７に示される大腸癌検出用鉄センサー１１の構成は、イオン選択性電極１３０及び外部参照用電極１２０以外、大腸癌検出用鉄センサー１の構成と同じであるため、説明を省略する

30

【００２９】

[内視鏡]

第一実施形態

本発明の内視鏡は、上述した被験体由来の消化管洗浄液を分析する鉄センサーを備えている。以下に、本発明の内視鏡の好ましい形態について説明する。

【００３０】

本実施形態の内視鏡２００は、観察対象である被験者の内部である体腔内に挿入部２０２が導入され、被験者の内部の被写体の撮像を行う装置である。

図８（ａ）に示すように、内視鏡２００は、管状で長尺に形成された可とう性を有する挿入部２０２と、挿入部２０２の先端側に設けられた湾曲部２０３を湾曲操作する操作部２０４と、撮像した体腔内の画像を表示する図示略のモニター部と連結するコネクター部２０７と、コネクター部２０７と操作部２０４を繋ぐユニバーサルコード部２０６と、を備えている。

40

図８（ｂ）は、図８（ａ）における挿入部２０２の先端部分２０１の横断面図である。図８（ｂ）に示すように、本実施形態の内視鏡２００は、大腸癌検出用鉄センサー２０５を、観察対象の内部に導入される先端部分２０１に備えている。大腸癌検出用鉄センサーの好ましい実施形態については上述したとおりであり、イオン選択性電極を備えたものである。該大腸癌検出用鉄センサーは、先端部分２０１から図示略の外部イオン濃度測定装置本体まで、ケーブル接続され、該ケーブルは、挿入部２０２、操作部２０４、ユニバーサルコード部２０６、及びコネクター部２０７内を挿通している。

50

【 0 0 3 1 】

本実施形態の本実施形態の内視鏡 2 0 0 は、先端部分 2 0 1 に取り付けられた大腸癌検出用鉄センサー 2 0 5 により、S 状結腸中の消化管洗浄液を分析できる。本実施形態によれば、消化管洗浄液の溜まりやすい S 状結腸まで内視鏡を挿入すればよいため、検診を受ける者の身体的負担が軽減される。

さらに、本実施形態によれば、従来は視覚情報にのみに依存していた内視鏡検査法を、リアルタイムに得られる鉄イオンの濃度情報を含めたものに補完できる。即ち、本実施形態によれば、生理機能的検査に分析的手法を取り入れ、付加価値を持たせることができる。

【 0 0 3 2 】

第二実施形態

図 9 は、本実施形態の内視鏡 3 0 0 の斜視図である。本実施形態において、第一実施形態の内視鏡 2 0 0 と同じ構成については、同一の符号を付し、その説明を省略する。

図 9 に示すように、内視鏡 3 0 0 は、吸液タンク 3 0 6 を有し、吸液タンク 3 0 6 内に大腸癌検出用鉄センサー 3 0 5 を備えている。大腸癌検出用鉄センサーの好ましい実施形態については上述したとおりであり、イオン選択性電極を備えたものである。

本実施形態の内視鏡 3 0 0 は、図示略の吸引源により、該内視鏡 3 0 0 内に挿通している図示略の吸引管路を介して、吸引タンク 3 0 6 に、被験者の S 状結腸中の消化管洗浄液を採取する。吸引タンク 3 0 6 には、大腸癌検出用鉄センサー 3 0 5 が備えられており、採取された消化管洗浄液の鉄イオンの濃度を測定する。

本実施形態によれば、第一実施形態の効果に加えて、従来の吸液タンクに付属品として大腸癌検出用鉄センサーを設置すればよいため、より簡便に該内視鏡を製造することができる。

【 0 0 3 3 】

第三実施形態

図 1 0 は、本実施形態の内視鏡 4 0 0 の斜視図である。内視鏡 4 0 0 は、カプセル型内視鏡であり、観察対象である被験者の内部である体腔内に、全体が導入され、被験者の内部の被写体の撮像を行う。

図 1 0 に示すように、内視鏡 4 0 0 は、小型化された大腸癌検出用鉄センサー 4 0 5 を備えている。大腸癌検出用鉄センサーの好ましい実施形態については上述したとおりであり、イオン選択性電極を備えたものである。

内視鏡 4 0 0 は、一般的にはプラスチック材料を形成してなり、その表面と同一平面をなすように、大腸癌検出用鉄センサー 4 0 5 を備えている。図 1 0 には、一つの大腸癌検出用鉄センサー 4 0 5 を示しているが、内視鏡 4 0 0 は、複数の大腸癌検出用鉄センサー 4 0 5 を備えていてもよい。また、内視鏡カプセル 4 0 0 は、その表面に一部突出するように、大腸癌検出用鉄センサー 4 0 5 を備えていてもよい。

【 0 0 3 4 】

内視鏡 4 0 0 は、撮像部 4 0 1、並びに、図示略の電源部、制御部、照明部、及び無線部等が、カプセル型筐体 4 1 6 内に配設されることにより構成されている。カプセル型筐体 4 1 6 は、半球ドーム状の先端カバー筐体 4 1 6 a と、円筒状の胴部筐体 4 1 6 b とからなる。

そして、大腸癌検出用鉄センサー 4 0 5 は、小型化されたイオン濃度測定装置本体を備えている。大腸癌検出用鉄センサー 4 0 5 が体腔内の消化管洗浄液と接触した際に、内視鏡 4 0 0 内でイオン選択性電極及び外部参照電極間の電位差測定が行われる。大腸癌検出用鉄センサー 4 0 5 及び撮像部 4 0 1 は、外部と無線通信を行う図示略の無線部と接続されており、電位差及び体腔内の撮像情報が、無線部を通じて、身体外部の図示略の内視鏡ユニットに送信され、内視鏡ユニットは、撮像された画像及び鉄イオン濃度の表示、記録等を行う。当該記録においては、各画像および電位差情報に時刻情報を付加して記録を行う。これにより、事後的にデータ解析する際に、電位差データが変動した時点における画像がどれかを判別することができる。なお、内視鏡 4 0 0 に記憶部を備えることにより、

10

20

30

40

50

随時データを送信するのではなく、自己の記憶部に記憶させるものであってもよい。当該自己の記憶部への記録時においても、各画像および電位差情報に時刻情報を付加して記録を行う。また、内視鏡４００自身で電位差情報をモニタしつつ、これが所定の閾値を超えた際（若しくは上昇傾向と判断された場合等）に、撮像頻度を増加させる制御を行うものであってもよい（大腸癌検出用鉄センサー４０５から得られる情報を制御部によって判別し、所定の閾値を超える若しくは値が増加傾向となった場合に、撮像部４０１に対して撮像頻度を増加させる制御を行う）。これにより病変部位の疑いがある個所付近で集中して撮像を行うことができる。

【００３５】

従来のカプセル型内視鏡は、約１０時間体腔内を移動しながら、約７万２０００枚の画像を撮像し続ける。内視鏡施行医は、これらすべての撮像画像を確認しなければならない。

本実施形態によれば、内視鏡４００が体腔内を移動する際、撮像情報に加えて、鉄イオン濃度の情報を得られるため、病変部位をリアルタイムに簡便に認識することができる。

【００３６】

以下、実施例により本発明を説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

【実施例】

【００３７】

(１)鉄イオン選択性電極及び参照電極の作製

鉄イオン選択性電極及び外部参照電極の内部参照電極を次のようにして作製した。

先ず、銀線（直径５００μm、長さ５cm、ニラコ製）に参照電極用銀／塩化銀インク（ビー・エー・エス製）を塗布した。その後、室温で自然乾燥させることで銀／塩化銀線からなる内部参照電極を得た。

【００３８】

次にイオン選択膜を以下の手順で作製した。

５，１０，１５，２０-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin(ALDRICH製)、Benzyl acetate(ALDRICH製)、Oleic acid(SIGMA-ALDRICH製)、Poly(vinyl chloride)(Fluka製)をそれぞれ５．０wt%、５５．０wt%、１０．０wt%、３０．０wt%で混合し、Tetrahydrofuran(和光純薬工業製)を適切な量加えて溶解させた。この溶液をPVCチューブ(外径２mm、内径１mm、長さ３cm、三商製)の一方の穴に少量塗布し、室温で２４時間放置することで乾燥させた。

【００３９】

このPVCチューブに、内部電解液として１mM $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ (和光純薬工業製)と０．１M KClを含んだ溶液を注入し、上述のようにして作製した内部参照電極を挿入した。最後に、シーリング用シリコンゴム(信越シリコン製)をPVCチューブの他方の穴に塗布し乾燥させ、図１１に示す鉄イオン選択性電極を得た。

【００４０】

また、外部参照電極を作製するため、PVA-SbQ(東洋合成工業製)と０．２M KCl溶液を１：１で混合した溶液をPVCチューブの一方の穴に塗布した。さらに、紫外線を５分間照射することで電解質ゲルを作製した。次に、内部電解液として０．１M KCl溶液を注入し、上述の内部参照電極を挿入した後に、他方の穴をシーリングした。このようにして、図１１に示す外部参照電極を得た。

【００４１】

(２)キャリブレーションプロットの作成

先ず、作製した鉄イオン選択性電極を５mM $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液に２４時間浸漬させ、コンディショニングを行った。その後純水ですすぎ、電極外部を洗浄した。

【００４２】

サンプル溶液として、異なる濃度の $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ を含む 0.1 M KCl 溶液、消化管洗浄液をそれぞれ用意した。容積 20 mL のビーカーに 10 mL のサンプル溶液を入れ、図 11 の鉄イオン選択性電極と外部参照電極を浸漬させた。

【0043】

また、電位差測定のために、電気化学測定装置 (AUTLAB EN 55022、Eco Chemie 製) を使用した。この電気化学測定装置に、鉄イオン選択性電極と外部参照電極を電氣的に接続した。

【0044】

鉄イオン選択性電極と外部参照電極間の電位差をモニタリングし、電位が安定した後の電位差を鉄イオン濃度の常用対数に対してプロットした。それぞれのサンプルで、5 回の独立した測定を行った。

10

【0045】

図 12 (a) に、鉄イオン濃度と得られた電位差との関係を表したキャリブレーションプロットを示す。図 12 (a) に示すように、鉄イオン濃度と電位差の間には明らかな直線関係が観察された。

一方、 0.1 M KCl に鉄イオンを加えたサンプルと、消化管洗浄液に鉄イオンを加えたサンプルでは、電位差と傾きに大きな違いは見られなかった。そこで、消化管洗浄液を用いた場合、 100 pM から 1 mM の間で直線関係を得ることができた (図 12 (b) 参照)。これは、患者から採取した消化管洗浄液中の鉄イオンを測定するために十分な感度だと考えられる。

20

【0046】

(3) 患者から採取した消化管洗浄液中の鉄イオン濃度の測定

14 人の様々な疾患をもった患者から採取した消化管洗浄液をサンプルとして、鉄イオン濃度を測定した。上記と同様に、サンプルに浸漬させた鉄イオン選択性電極と外部参照電極間の電位差を測定し、上述のキャリブレーションプロットを用いて鉄イオン濃度を決定した。それぞれのサンプルで、3 回の独立した測定を行った。

【0047】

図 13 に、14 サンプルの鉄イオン測定結果を示す。さらに、それぞれの患者の診断結果と測定した鉄イオン濃度を表 1 に示す。結果として、所見の認められなかった患者から採取した消化管洗浄液中の鉄イオン濃度は低濃度であった。一方ポリープなどの病変を有する患者から採取した消化管洗浄液中の鉄イオン濃度はそれに比較して高く、特に進行大腸癌患者から採取したサンプルが最も高い鉄イオン濃度を示した。これらの結果は病変からの出血に伴い鉄イオンが消化管洗浄液中に混入することが原因だと考えられた。大腸病変の大きさと鉄イオン濃度に相関関係があることが示唆された。

30

【0048】

【表 1】

Sample	avg (μM)	STDEV	診断
1	2.05	3.46	所見なし
2	4.26	4.66	Crohn病
3	1.09	0.07	所見なし
4	3.60	2.96	潰瘍性大腸炎
5	94.94	27.42	横行結腸 Is polyp 10mm
6	6.03	3.87	下行結腸 lsp polyp 8mm
7	282.90	93.24	type3 cancer
8	31.38	36.62	multiple polyp max6mm
9	3.64	3.92	所見なし
10	15.87	22.94	直腸 lsp 5mm+ 上行結腸 lp5mm&lp3mm
11	0.55	0.75	所見なし
12	29.91	49.76	S状結腸 lsp10mm
13	1.32	1.95	所見なし
14	1.77	0.87	multiple polyp max6mm

10

【0049】

尚、作製した鉄イオン選択性電極を用いて測定した鉄イオン濃度の結果は、市販の鉄イオン測定キット（フナコシ製）を用いて測定した結果と対応していることを確認している。

20

【0050】

以上の結果から、本発明の内視鏡によれば、定性的な視覚情報に加えて、鉄イオン濃度測定に基づく定量的な情報をリアルタイムに得られることが明らかである。

【符号の説明】

【0051】

1, 11, 205, 405 ... 大腸癌検出用鉄センサー、10 ... 外筒体、20, 120 ... 外部参照用電極、20a, 72c, 120a ... 液絡部、22, 32 ... 端部、30, 71, 130 ... イオン選択性電極、30a, 71c, 130a ... イオン選択膜、40 ... 電極固定用組成物の硬化体、50 ... 端面、60 ... 電解質結晶体、70 ... 測定系、71a, 72a ... 内部参照電極、71b ... 内部溶液、72 ... 外部参照電極、72b ... 外部電極内部液、73 ... 電位差計、74 ... 試料溶液、80 ... 微孔膜、200, 300, 400 ... 内視鏡、201 ... 先端部分、202 ... 挿入部、203 ... 湾曲部、204 ... 操作部、206 ... ユニバーサルコード部、207 ... コネクター部、306 ... 吸引タンク、401 ... 撮像部、416 ... カプセル型筐体、416a ... 先端カバー筐体、416b ... 胴部筐体。

30

【図 1】

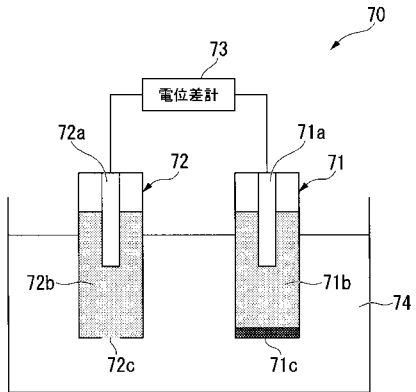


図 1

【図 2】

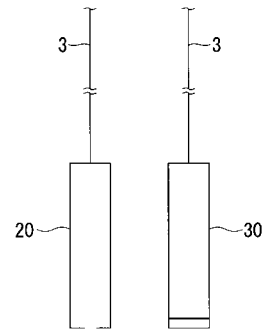


図 2

【図 3】




図 3

【図 4】

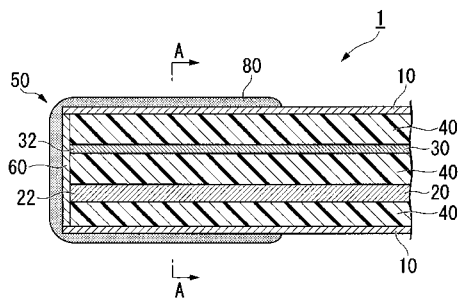


図 4

【図 6】




図 6

【図 5】

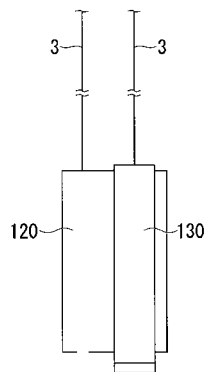


図 5

【図 7】

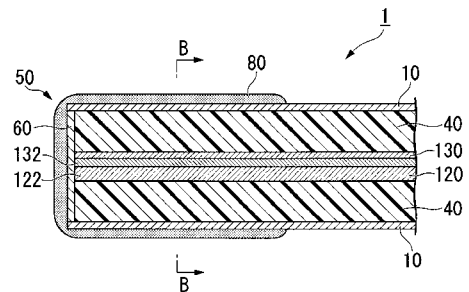


図 7

【図 8】

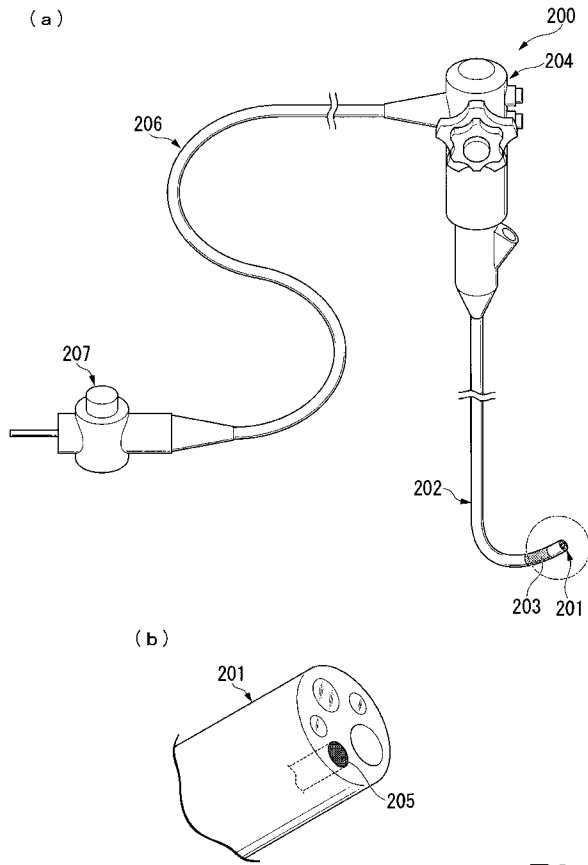


図 8

【図 9】

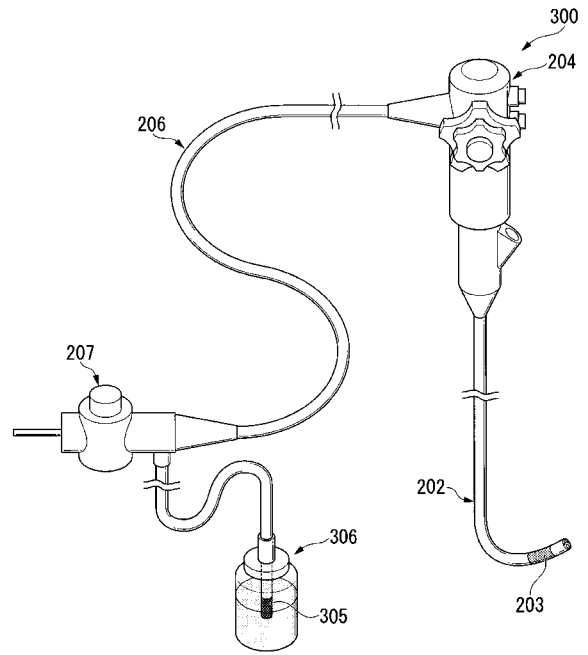


図 9

【図 10】

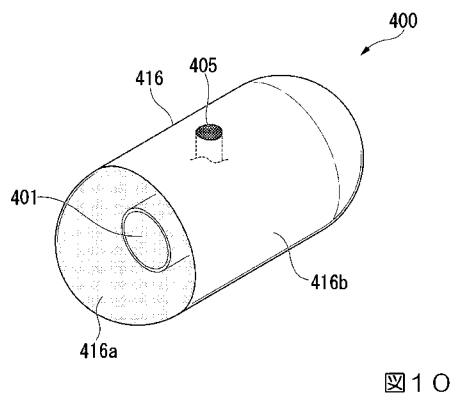


図 10

【図 11】

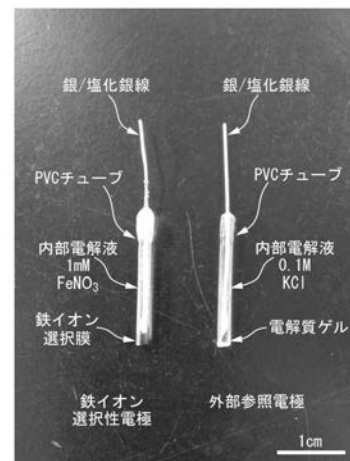


図 11

【 図 1 2 】

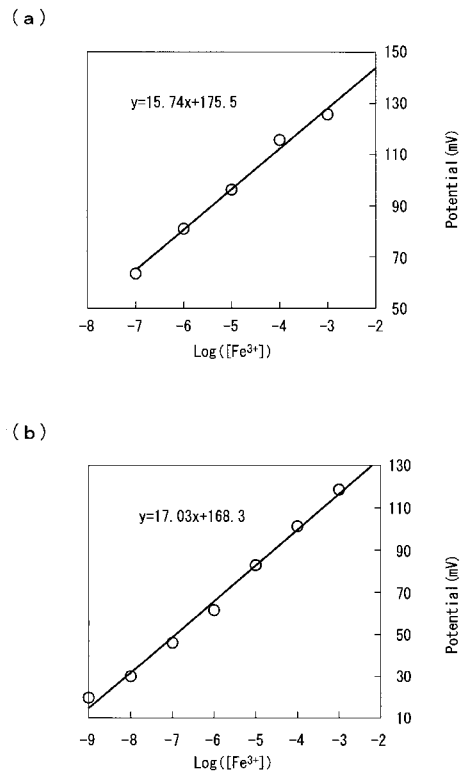


図 1 2

【 図 1 3 】

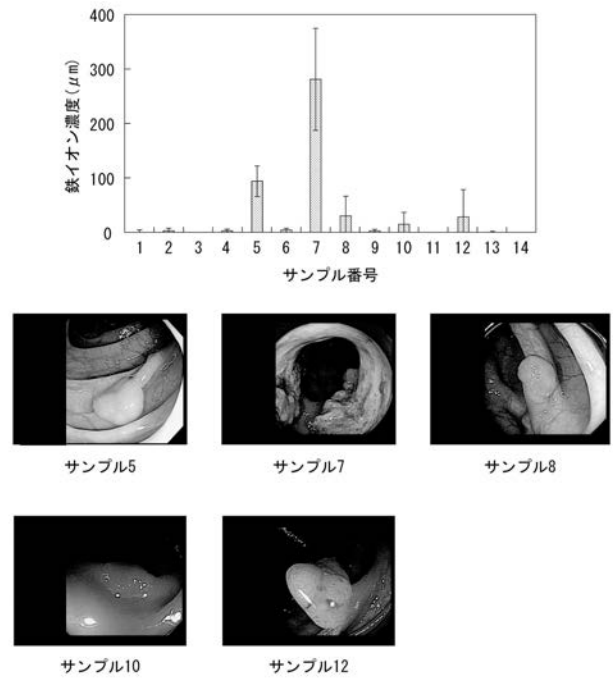


図 1 3

フロントページの続き

(51) Int. Cl. F I テーマコード (参考)
G 0 2 B 23/24 (2006.01) G 0 2 B 23/24 C

- (72) 発明者 松井 裕史
茨城県つくば市天王台一丁目 1 番 1 国立大学法人筑波大学内
(72) 発明者 鈴木 英雄
茨城県つくば市天王台一丁目 1 番 1 国立大学法人筑波大学内
(72) 発明者 鈴木 博章
茨城県つくば市天王台一丁目 1 番 1 国立大学法人筑波大学内
(72) 発明者 木村 翔平
茨城県つくば市天王台一丁目 1 番 1 国立大学法人筑波大学内

F ターム (参考) 2H040 BA23
4C038 CC02 CC03 CC06
4C161 AA04 BB00 CC06 DD03 DD07 FF14 HH05 HH51

- (54) 【発明の名称】大腸癌検出装置、大腸癌検出キット、被験体における大腸癌の可能性を判断するための被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度の測定方法、及び大腸癌の進行度を予測するためのデータを収集する方法

专利名称(译)	结肠癌检测装置，结肠癌检测试剂盒，测定来自受试者的消化道灌洗液中的铁离子浓度的方法，用于判断受试者的结肠直肠癌的可能性，以及预测结直肠癌的进展的方法如何收集数据		
公开(公告)号	JP2017164511A	公开(公告)日	2017-09-21
申请号	JP2017081368	申请日	2017-04-17
[标]申请(专利权)人(译)	国立大学法人筑波		
申请(专利权)人(译)	国立大学法人筑波		
[标]发明人	金子剛 福田淳二 松井裕史 鈴木英雄 鈴木博章 木村翔平		
发明人	金子 剛 福田 淳二 松井 裕史 鈴木 英雄 鈴木 博章 木村 翔平		
IPC分类号	A61B1/00 G01N27/333 G01N27/416 A61B5/07 A61B10/00 G02B23/24		
FI分类号	A61B1/00.550 G01N27/333.331.Z G01N27/416.351.E A61B5/07.100 A61B10/00.T G02B23/24.C A61B1/31 A61B1/31.ZDM		
F-TERM分类号	2H040/BA23 4C038/CC02 4C038/CC03 4C038/CC06 4C161/AA04 4C161/BB00 4C161/CC06 4C161/DD03 4C161/DD07 4C161/FF14 4C161/HH05 4C161/HH51		
代理人(译)	塔奈澄夫 飯田正人 清水雄一郎		
其他公开文献	JP6568139B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明公开了结肠镜检查中，除了定性的视觉信息，以提供获得基于实时的铁离子浓度测定用的量化信息的结肠直肠癌检测装置。 解决方案：本发明的结肠癌检测装置的特征在于包括铁传感器，用于测量来自受试者的消化道清洗液中的铁离子浓度。 【选择图】无

(19) 日本国特許庁 (JP)	(12) 公 開 特 許 公 報 (A)	(11) 特許出願公開番号 特開2017-164511 (P2017-164511A)
		(43) 公開日 平成29年9月21日 (2017. 9. 21)
(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 1/00 (2006. 01)	A 6 1 B 1/00 5 5 0	2 H 0 4 0
G O 1 N 27/333 (2006. 01)	G O 1 N 27/333 3 3 1 Z	4 C 0 3 8
G O 1 N 27/416 (2006. 01)	G O 1 N 27/416 3 5 1 E	4 C 1 6 1
A 6 1 B 5/07 (2006. 01)	A 6 1 B 5/07 1 0 0	
A 6 1 B 10/00 (2006. 01)	A 6 1 B 10/00 T	
審査請求 有 請求項の数 8 O L (全 15 頁) 最終頁に続く		
(21) 出願番号	特願2017-81368 (P2017-81368)	(71) 出願人 504171134
(22) 出願日	平成29年4月17日 (2017. 4. 17)	国立大学法人 筑波大学
(62) 分割の表示	特願2013-2957 (P2013-2957) の分割	茨城県つくば市天王台一丁目1番1
原出願日	平成25年1月10日 (2013. 1. 10)	(74) 代理人 100106909 弁理士 櫻井 澄雄
		(74) 代理人 100188558 弁理士 飯田 聖人
		(74) 代理人 100169764 弁理士 清水 雄一郎
		(72) 発明者 金子 剛 茨城県つくば市天王台一丁目1番1 国立 大学法人筑波大学内
		(72) 発明者 福田 淳二 茨城県つくば市天王台一丁目1番1 国立 大学法人筑波大学内
		最終頁に続く
(54) 【発明の名称】 大腸癌検出装置、大腸癌検出キット、被験体における大腸癌の可能性を判断するための被験体由来の消化管洗浄液中の鉄イオン濃度の測定方法、及び大腸癌の進行度を予測するためのデータを		