

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号
特許第5943480号
(P5943480)

(45) 発行日 平成28年7月5日(2016.7.5)

(24) 登録日 平成28年6月3日(2016.6.3)

(51) Int.Cl.
A 6 1 B 90/00 (2016.01)

F I
A 6 1 B 19/00 5 0 2

請求項の数 11 (全 18 頁)

(21) 出願番号	特願2013-2448 (P2013-2448)	(73) 特許権者	501228071
(22) 出願日	平成25年1月10日 (2013.1.10)		エスアールアイ インターナショナル
(62) 分割の表示	特願2010-173758 (P2010-173758) の分割		S R I I n t e r n a t i o n a l
原出願日	平成8年6月5日 (1996.6.5)		アメリカ合衆国 カリフォルニア州 94
(65) 公開番号	特開2013-99555 (P2013-99555A)		025 メンロパーク レイベンスウッド
(43) 公開日	平成25年5月23日 (2013.5.23)		アベニュー 333
審査請求日	平成25年1月10日 (2013.1.10)		333 Ravenswood Aven
審判番号	不服2015-18655 (P2015-18655/J1)		ue, Menlo Park, Cal
審判請求日	平成27年10月15日 (2015.10.15)		ifornia 94025, U. S.
(31) 優先権主張番号	08/485,587	(74) 代理人	100093919
(32) 優先日	平成7年6月7日 (1995.6.7)		弁理士 奥村 義道
(33) 優先権主張国	米国 (US)		
(31) 優先権主張番号	08/487,020		
(32) 優先日	平成7年6月7日 (1995.6.7)		
(33) 優先権主張国	米国 (US)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 遠隔操縦ロボットシステム用の外科手術マニピュレーター

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基部エンド及び末端エンドを有する長尺シャフトと、基部エンドと末端エンドの間の長手方向軸と、末端エンド上のエンドエフェクターと、装着用インターフェースとを含む外科手術用具、

第1及び第2エンド付き本体を有するサポートと、前記用具の装着用インターフェースに係合して該用具を用具ホルダーに開放可能に連結するための連結用インターフェースとを含む該用具ホルダー、

前記用具ホルダーに対し前記用具をロックするためのロックアセンブリ、及び

前記用具ホルダー及びこれと一緒に前記外科手術用具を操作するためのドライブアセンブリを含むマニピュレーターアセンブリであって、用具ホルダーはマニピュレーターアセンブリに開放可能に連結できる該マニピュレーターアセンブリ、を含む外科手術システムであって、

前記用具ホルダーは、前記ドライブアセンブリを外科手術用具に連結すると共に、少なくとも二つの動作作動 (motion actuations) をドライブアセンブリから前記用具に伝達するための第1及び第2リンクを含み、前記動作作動は長手方向軸の回りの前記用具の回転及び前記エンドエフェクターの作動を含む、前記外科手術システム。

【請求項 2】

前記ドライブアセンブリが、前記用具を用具軸の回りで回転させるための第1制御可能モーターと、前記エンドエフェクターを前記用具上で作動させるための第2制御可能モーターと、

10

20

ターと、前記用具を軸方向に変換させるための第 3 制御可能モーターとを含み、前記用具ホルダーが、動作作動を前記第 3 モーターから前記用具に伝達するための第 3 リンクを含む請求項 1 記載の外科手術システム。

【請求項 3】

前記用具ホルダーが、マニピュレーターアセンブリから前記用具に、また前記用具からマニピュレーターアセンブリに電気信号を伝達するための一つ以上の電氣的貫通接続 (feedthrough) をさらに含む請求項 1 記載の外科手術システム。

【請求項 4】

前記外科手術用具から遠く離れて配置され、該外科手術用具を入力制御装置で遠隔制御するための該入力制御装置と、前記用具ホルダーに連結されたサーボ機構とをさらに含む請求項 1 記載の外科手術システム。

10

【請求項 5】

複数の異なる外科手術用具をさらに含み、該異なる外科手術用具は内視鏡処置の間、使用できるように、連続的に用具ホルダーに連結可能である、請求項 1 記載の外科手術システム。

【請求項 6】

ロボットシステムにより操作する方法であって、

用具ホルダーに消毒用具を開放可能に連結する工程であって、前記用具は基部エンド及び末端エンドを有する長尺シャフトと、基部エンドと末端エンドの間の長手方向軸と、末端エンド上のエンドエフェクターと、装着用インターフェースとを含む該工程；

20

前記用具の装着用インターフェースを用具ホルダーに係合する工程；

前記用具を用具ホルダーにロックする工程；

少なくとも二つの動作作動を前記用具ホルダーを通してマニピュレーターアセンブリから前記用具に伝達する工程であって、前記少なくとも二つの動作作動は長手方向軸の回りの前記用具の回転及び前記エンドエフェクターの作動を含む、該工程；及び

前記用具ホルダーを消毒するため、用具ホルダーを前記マニピュレーターアセンブリ及び前記用具から開放する工程；

を含む、前記方法。

【請求項 7】

前記伝達工程が、ドライブアセンブリからの入力に応答して前記長手方向軸に沿って前記用具を変換させる工程をさらに含む請求項 6 記載の方法。

30

【請求項 8】

前記伝達工程が、前記用具を長手方向軸の回りに回転させる工程及び前記ドライブアセンブリからの入力に応答して前記用具上のエンドエフェクターを回転関節で接続する (articulate) 工程をさらに含む請求項 6 記載の方法。

【請求項 9】

設定されたベースに第 1 軸を中心として旋回自在に装着された第 1 リンクを用意する工程；

第 1 軸は、前記用具上の球回転の所望の遠隔中心が用具の一部の上を中心とし、且つ前記第 1 軸と垂直に交差する第 2 軸上にあるように、前記用具を第 2 リンクと一緒に所望の位置に保持する工程；

40

前記用具が前記第 2 リンクと平行関係の平面内で移動するように、該用具の移動を拘束するため、該第 2 リンクを旋回自在に第 1 リンクに接続する工程；及び

前記第 1 及び第 2 リンクにより前記用具上の球回転の遠隔中心を前記設定されたベースに対し所望の固定位置に維持しながら、前記用具を操作する工程；

をさらに含む請求項 6 記載の方法。

【請求項 10】

前記用具に対し作用する力を感知する工程、

前記力を入力制御装置に伝達する工程であって、該センサーにより検出された力は用具に対し作用する重力を含む該工程、

50

前記用具の垂直に対する方向を測定する工程、及び
前記用具に対し作用する重力が入力制御装置に伝達されるのを防止するため、前記方向を表示するサーボ機構に信号を送る工程、
をさらに含む請求項 6 記載の方法。

【請求項 11】

前記用具ホルダーから前記用具を取り外す工程、及び
該ホルダーに異なる用具を開放可能に連結する工程、
をさらに含む請求項 6 記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

10

【0001】

この発明は外科手術マニピュレーターに係り、特に外科手術で使用するロボット支援型装置に関する。

【背景技術】

【0002】

標準的な腹腔鏡外科手術では、患者の腹部にガスが吹き入れられ、腹腔鏡外科手術用具のための入口を形成する小さな切り口（約 1 / 2 インチ）を通してトロカール・スリーブが送られる。一般に腹腔鏡外科手術用具は、外科手術する部位を視るための腹腔鏡、並びにクランプ、把持器、はさみ、ホチキス及び針ホルダーのような作業用具を含む。これらの作業用具は、各用具の作業端が延長チューブに沿って約 12 インチだけそのハンドルから離れていることを除けば、従来の（オープン）外科手術で用いられる用具と同じである。外科手術を行うため、外科医はトロカール・スリーブを通して用具を送り、また、スリーブを通じてそれらを入れたり出したりスライドさせ、スリーブ内でそれらを回転させ、腹部壁内でスリーブにてこ入れし（即ち旋回させ）、そして用具の末端にあるエンドエフェクターを作動させることにより、腹部内においてそれらの用具を操作する。

20

【0003】

ロボットに支援された遠隔操縦ロボット外科手術（オープン及び内視鏡処置）では、外科手術用具の位置は、手で直接制御するか又は固定クランプで制御するよりむしろ、サーボモーターにより制御される。外科医が患者から離れた所にて表示イメージを通じて手術を見ながら入力制御装置を操作する際には、サーボモーターは外科医の手の動きに追従する。サーボモーターは、外科手術用具を支持及び制御する電気機械的装置又は外科手術マニピュレーターの典型的な一部であり、この外科手術用具は、オープン外科手術部位に直接導入されるか又はトロカール・スリーブを通して患者の腹部のような体腔内に導入される。手術の間、外科手術用具により、組織つかみ器、針ドライバーなどのような種々の外科手術用具が機械的作動され且つ制御される。これらの外科手術用具の各々は外科医のために種々の機能を行う、即ち、針を保持又は駆動したり、血管をつかんだり、組織を切開したりする。

30

【0004】

リモート操作により遠隔外科手術を行うこの新しい方法では、多くの新しい試みが為される。そのような試みの一つは、外科医が遠隔操縦ロボットシステムを操作するとき、位置、力及び触覚を外科手術用具から外科医の手に伝え返すことである。リモート操作の他の技術とは違って、遠隔外科手術により外科医には直接手で外科手術用具を操作している感じを与えることができる。例えば、用具が患者の組織構造又は器官に作用しているとき、システムは用具に対する反作用の力を検出してこの力を入力制御装置に伝えることが可能でなければならない。このようにして、外科医は表示イメージ上で組織構造に接触している用具を見て、入力制御装置上でこの接触による圧力を直接感じるができる。しかしながら、適当なフィードバックを与えることには、システムに作用する他の力が起因する問題をはらみうる。このような力としては、例えば、遠隔操縦ロボット機構内の摩擦、外科手術マニピュレーターに作用する重力及び慣性力、又は外科手術切り口によりトロカール・スリーブに働く力などが挙げられる。

40

50

【 0 0 0 5 】

さらに、効果的な遠隔外科手術を可能にするためには、マニピュレーターは高い応答性を有しなくてはならず、また外科医が外科手術を行う際にしばしば現れる最も速い手の動きでさえ正確に追従できなければならない。この迅速で応答性の高い性能を達成するために、遠隔操縦ロボットサーボシステムは、適度に高いサーボ帯域を有するように設計されねばならず、このことは、マニピュレーターが低い慣性を有し且つ相対的に低いギヤ比のドライブモーター又はプーリーカップリングを用いるようにマニピュレーターを設計することを要求する。

【 0 0 0 6 】

遠隔外科手術に関する他の試みは、電気機械式外科手術マニピュレーターの一部が外科手術用具と直接接触してしまうこと、及び作業部位に隣接して配置されることから生じる。従って、外科手術マニピュレーターは外科手術中に汚染されるかもしれないし、一般には処分されるか又は手術と手術の間に消毒される。もちろん、コストの観点からは装置を消毒するのが好ましいであろう。しかしながら、サーボモーター、センサー、及びモーターをロボット制御するのに必要な電気接続は、一般には従来の方法（例えば蒸気、熱及び圧力、又は化学薬品）を用いて消毒することはできない。というのは、それらが消毒工程で損傷を受けるか又は破壊されてしまうからである。

【 0 0 0 7 】

別の試みとしては、異なる外科手術用具が1回の手術中に数回同じ用具ホルダーに取付けられ、取り外されることである。例えば腹腔鏡処置では、患者の腹部内への入口の数は、患者に必要なない切り口を開けないという要望はもちろんのことスペースの制約ゆえに、その手術中は一般に制限される。よって、一般には幾つかの異なる外科手術用具が、手術中は同じ口カール・スリーブを通して導入される。同様に、オープン外科手術では、一般に外科手術部位の周りには1又は2以上の外科手術マニピュレーターを置く十分な空間が無く、そのため外科医の助手はホルダーから用具を取り外して他の外科手術機器を取り替えることをしばしば強いられる。

【 0 0 0 8 】

従って、必要なのは、リモート制御により外科手術用具を保持し操作し、且つ、外科手術用具を用具ホルダーに取り外し可能に連結するためのシステム及び方法である。本装置は、手術中に汚染された後でも再使用できるように容易に消毒できる構成とすべきである。さらに、本装置は、遠隔操縦ロボット操作の間外科手術用具に対して伝えられ且つ該用具から伝えられる力から、適当なフィードバックを外科医に与えることができなければならない。また、本装置は、装置に作用する重力が外科医に感じられないようにこれらの力を補償するよう構成すべきである。加えて、本装置は高い応答性を有しなくてはならず、外科医が外科手術を行う際にしばしば現れる最も速い手の動きにさえ正確に追従できなければならない。さらに、内視鏡外科手術の間用具をホルダーに素早く且つ容易に取り付け、取り外しできて、用具交換の時間を最小にするよう構成されたシステムを提供することが望ましい。

【 発明の概要 】

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 0 9 】

従来のオープン外科手術中又は腹腔鏡検査のような内視鏡処置の間外科手術用具を開放可能に保持し操作するための装置及び方法が提供される。本装置は、用具ホルダーを有するマニピュレーターアセンブリを含み、この用具ホルダーは、消毒できるようにドライブアセンブリに取り外し可能に連結される。マニピュレーターアセンブリは、さらに、ホルダー末端に取り付けられた力感知エレメントと、外科手術用具に働く力を検出して外科医にフィードバックするためのドライブアセンブリとを含む。本発明はまた、外科手術用具を開放可能に保持するためのシステム及び方法に関する。システムは、用具側の装着ピンを用具ホルダー側のロックスロットに自動的にロックして用具をホルダーに開放可能に連結するための用具サポートを含む。ツイストロック動作により、オープン外科手術、腹腔

10

20

30

40

50

鏡検査又は胸腔鏡検査のような外科処置の間、外科医は種々の用具をホルダーに素早く取付け、取り外すことができる。

【 0 0 1 0 】

一態様では、装置は、作業テーブルのような面に対する種々の受動又はパワー駆動位置決め装置により固定可能なサポートベースと、ベース上に移動可能に取り付けられた用具ホルダーとを含む。用具ホルダーは本体と用具サポートから成り、用具サポートは、本体に移動自在に連結され、外科手術用具と係合するインターフェースを有して用具を用具ホルダーに開放可能に装着する。ドライブアセンブリは用具ホルダーに作動連結されて、少なくとも二自由度を用具に与える。ドライブアセンブリは、用具サポートを動かすための第1ドライブと、サポートベースに対して用具ホルダーを動かすための第2ドライブとを含む。本装置は、ベース及びドライブアセンブリから取り外し可能に用具ホルダーを連結するための手段を含み、それにより、外科処置の後ホルダーは装置の残りの部分から分離して消毒できる。

10

【 0 0 1 1 】

特定の構成では、サポートベースは、末端及び基部のサポート部材を備えたフレームと、サポート部材内に回転可能に取り付けられた一対のシャフトとを含む。用具ホルダーは、用具が軸方向移動できるようにサポートシャフト上にスライド可能に取り付けられる。加えて、シャフトは各々ドライブモーターに連結され、第2及び第3の自由度（例えば回転やエンドエフェクターの作動）を用具に与える。ドライブモーターは、外科手術中に汚染されないように、基部サポート部材に連結される。回転可能シャフトは、それらを上方にスライドさせてそれらのベアリング及び用具ホルダーとの係合を外すことにより取り外すことができ、そのため用具ホルダーをサポートベースから容易に取り外して消毒できる。サポートベースの下部（末端サポート部材を含む）も、消毒して用具ホルダーに接触した部分を浄化できる。このようにして、サーボモーターや遠隔操縦ロボットシステムに要求される電気接続に損傷を与えることなく、外科処置の後に外科手術マニピュレーターを容易に消毒できる。

20

【 0 0 1 2 】

サポートベースはさらに、末端サポート部材に取り付けられたカニューレ又はトロカール・スリーブのようなスリーブを含む。スリーブは、用具をその中に受け入れるための軸方向通路と、スリーブの末端エンド近くの軸方向通路内に取り付けられた力感知エレメントとを有する。力感知エレメントは、外科手術中に用具の末端部分によりエレメントに作用する横方向の力を検出するように構成される。力感知エレメントは装置の残りの末端に取り付けられるので、外科手術の切り口により又は用具ホルダーに作用する重力及び慣性力によりカニューレに働く力からこのエレメントは影響されない。位置決め装置により支持される際には外科手術マニピュレーターはクリノメーターと共に使用でき、ローカル重力場の方向に対する用具ホルダーの真の方向が求まる。マニピュレーターと共にクリノメーター及び力センサーを使用することにより、遠隔操縦ロボット機構に作用する外部の力に影響されずに、用具端に対して作用する力を外科医が直接感知するような遠隔操縦ロボットシステムを設計するのが容易になる。換言すれば、外科医は、用具が力感知エレメントに接触している地点においてまるで自分の手が用具を保持している様に感じるのである。

30

40

【 0 0 1 3 】

本発明は、用具シャフトの末端エンドに連結されたエンドエフェクター（例えば一対の顎部）を有する外科手術用具を保持し操作するのに特に有効である。このために、用具ホルダーはさらにアクチュエーター・ドライバーを含み、これは用具上のエンドエフェクターと係合できるインターフェースを備える。アクチュエーター・ドライバーはカップリングを含み、このカップリングは、ドライバーの一部をサポートベースに対して軸方向に移動させるためのドライブアセンブリに、ドライバーを連結し、それにより、用具のエンドエフェクターを作動させる。好適な構成では、カップリングは同心螺旋アクチュエーターであり、ドライブモーターの回転をエンドエフェクター・アクチュエーターの軸方向の運

50

動に変換する。螺旋アクチュエーターの対称設計ゆえに、ドライブモーターにより与えられる作動力は用具に対して如何なる有効な側面負荷をも発生せず、このことにより、用具の軸方向運動や回転のような他の自由度との摩擦連結が避けられる。

【 0 0 1 4 】

本発明の別の態様では、用具は、基部エンド及び末端エンドを有する延長シャフトと、シャフトから径方向に基部及び末端エンド間に延在する突起を有する装着手段とを含む。用具ホルダーはサポートを含み、サポートは、用具シャフトを受け入れる軸方向通路を備えた本体と、突起を受け入れるための軸方向通路に連通した第 1 穴とを有する。第 2 穴は本体において第 1 穴まで横方向に切り込まれて連通し、突起が第 2 穴内で回転できる。外科手術の間に用具が偶然に捻られて用具ホルダーから外れないようにするため、ホルダーはさらに本体に連結されたロック手段を含み、このロック手段は第 2 穴内で突起を自動的にロックし、それにより、用具を用具ホルダーに開放可能にロックする。

10

【 0 0 1 5 】

好適な構成では、装着手段の突起は、用具シャフトから外方向に延在する一对の対向アーム（例えば装着ピン）を含む。第 1 穴は軸方向に延びたスロットであり、これは装着ピンを受け入れる。第 2 穴は垂直ロックスロットであり、これは軸方向スロットに整列した第 1 部分と、用具サポートの本体の回りを周方向に延在する第 2 部分とを有する。この構成により、装着ピンは軸方向スロットをスライドしてロックスロット内に回転でき、用具をホルダーに取り付けられる。用具は、同じ 2 工程を逆の順に行うことにより外すことができる。このツイスト - ロック動作により、外科手術中に外科医は種々の用具を用具ホルダーに迅速に嵌めたり外したりできる。

20

【 0 0 1 6 】

好ましくは、ロック手段は、装着ピンを用具ホルダーにロックするための開放可能ラッチアセンブリから成る。ラッチアセンブリはラッチに連結されたバネ負荷プランジャを含み、これは装着ピンをロックスロット内に捕獲することにより用具を適所に正常にロックする。プランジャは用具ホルダーから外方向に延在するボタンを有し、このボタンはラッチをロックスロットから出すためのものである。このボタンはマニュアルで又は自動的に押すことができ、外科医が用具に容易にアクセスできるとき装着ピンを開放して用具を取り替え可能にする。

【 0 0 1 7 】

30

本発明は、小さな経皮貫通で体空洞（例えば腹部又は胸部空洞）内に導入するよう構成された内視鏡用具を開放可能に保持するのに特に有効である。このために、好ましくは用具は、体空洞内で組織構造と係合する末端エンドと連結したエンドエフェクター（例えば一对の顎部）を含む。エンドエフェクターを作動するため、用具はアクチュエーターピンのような第 2 のアーム対を有し、これはシャフトから横方向に延在しエンドエフェクターに作動連結する。好ましくは、アクチュエーターピンはシャフトに対して軸方向に変位できてエンドエフェクターを作動する（例えば顎部を開閉する）。用具ホルダーはさらに、エンドエフェクターを作動するための外部ドライバーとアクチュエーターアームに開放可能に連結したアクチュエータードライバーを含む。好ましくは、アクチュエータードライバーは、用具サポートについて説明したのと同様の横方向スロットを備えたツイスト - ロックインターフェースを含み、用具サポートとアクチュエータードライバーの両方に同時に用具を嵌めたり外したりできる。

40

本発明の他の特徴や利点は以下の記載から明らかとなり、好適実施態様が添付図面に関連して詳細に述べられる。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 1 8 】

【 図 1 】本発明によるマニピュレーターアセンブリに装着された口ポット内視鏡外科手術用具の部分断面立面図である。

【 図 1 A 】図 1 のマニピュレーターアセンブリの部分断面立面図であり、用具ホルダーがアセンブリの残りの部分から取り除かれているのを示す。

50

【図 2 A】図 1 の外科手術用具の拡大された側断面図である。

【図 2 B】図 1 の外科手術用具の拡大された前面断面図である。

【図 3】図 3 A と図 3 B は、それぞれ用具サポートとアクチュエーターピンキャッチの斜視図であり、外科手術用具をマニピュレーターアセンブリに開放可能に装着するものである。

【図 4】図 3 A と図 3 B の用具サポートとアクチュエーターピンキャッチ内に装着された外科手術用具の前面立面図である。

【図 5】図 3 B のアクチュエーターピンキャッチを軸方向に移動させるためのアクチュエータードライバーの前面立面図である。

【図 6】図 6 A と図 6 B は、図 5 のアクチュエーターキャリッジアセンブリと螺旋アクチュエーターの拡大断面図である。

【図 7】図 1 のマニピュレーターアセンブリのフレームの一部の拡大詳細図であり、フレームからシャフトを取り外すための連結機構を示す。

【図 8】図 3 A の用具サポートの部分断面図であり、本発明によるツイストロックインターフェースのためのロック機構を示す。

【図 9】図 1 のマニピュレーターアセンブリを保持するためのリモート中心位置決め器の立面図である。

【発明を実施するための形態】

【0019】

図面を詳細に参照すると、同じ番号は同じ要素を示しており、マニピュレーターアセンブリ 2 が本発明の原理に従って描かれている。一般に、マニピュレーターアセンブリ 2 は、ベース 6 に取り外し可能に装着された用具ホルダー 4 と、用具ホルダー 4 に開放可能に連結された外科手術用具 14 を操作するためのドライブアセンブリ 7 とを含む。

図 1 を参照すると、ベース 6 は、基部及び末端の長サポート部材 17、19 を有するフレーム 16 と、ベアリング 22 を介してサポート部材 17、19 に回転可能に連結された第 1 及び第 2 ボールスプラインシャフト 18、20 とから成る。以下に詳細に述べるように（図 9 参照）、フレーム 16 はさらに、マニピュレーターアセンブリ 2 をリモート中心位置決め器 300 に取り付けるためのサポートブラケット 24 を含む。ドライブアセンブリ 7 は第 1、第 2 及び第 3 ドライブ 8、10、12 を含み、これらはフレーム 16 に装着され外科手術用具 14 に三自由度を与えるように構成される。好適実施態様では、第 1 ドライブ 8 は用具 14 をそれ自身の軸を中心として回転させ、第 2 ドライブ 10 は用具 14 の末端のエンドエフェクター 120 を作動させ、そして第 3 ドライブ 12 は用具 14 をフレーム 16 に対して軸方向に変位させる。もちろん、他の構成が可能なことは当業者には容易に分かるであろう。例えば、アセンブリ 2 は、外科手術用具 14 に別の自由度（例えば用具手首の回転や屈曲）を与えるための更なるドライブを含むことができる。

【0020】

第 1 ドライブ 8 はフレーム 16 に固定された回転ドライブモーター 26 を含み、この回転ドライブモーター 26 は、第 1 シャフト 18 をフレーム 16 に対して回転させるためのドライブベルト 28 により第 1 シャフト 18 に連結される。第 2 ドライブ 10 はフレーム 16 に固定されたグリッパードライブモーター 30 を含み、このモーター 30 は、第 2 シャフト 20 をフレーム 16 に対して回転させるためのドライブベルト 32 により第 2 シャフト 20 に連結される。第 3 ドライブ 12 は垂直ドライブモーター 34 を含み、このモーター 34 は、用具ホルダー 4 をフレーム 16 に対して軸方向に変位するためのドライブベルト 36 及び 2 つのプーリー 38 を介して用具ホルダー 4 に連結される。好ましくは、ドライブモーター 26、30、34 はサーボ制御エレクトロニクス（図示せず）を介してコントローラー機構に連結されて、リモート制御で外科手術用具 14 を操作するための遠隔操縦システムを形成する。患者から遠隔位置にて外科医が入力制御装置を操作するとき、ドライブモーターは外科医の手の動きに追随する。ドライブモーターを制御するための適当な遠隔操縦ロボットシステムは、1992 年 1 月 21 日提出の一般譲渡された同時係属出願第 08/823,932 号である「臨場感を伴った遠隔操作システム及び方法（TELE

10

20

30

40

50

OPERATOR SYSTEM AND METHOD WITH TELEPRESENCE) 」に記載されており、参考のためここに添付する。

【 0 0 2 1 】

好ましくは、上記遠隔操縦ロボットサーボシステムは、少なくとも 10 h z の 3 d B カットオフ周波数を示すサーボ帯域を有し、システムが外科医の素早い手の動きに迅速かつ正確に応答できるようにする。このシステムを効果的に操作するために、用具ホルダー 4 は相対的に小さな慣性を有し、ドライブモーター 26、30、34 は相対的に小さい比のギヤ又はプリー連結を有する。

【 0 0 2 2 】

特定の実施態様では、外科手術用具 14 は内視鏡用具であり、これは経皮貫通して腹部又は胸部空洞のような体空洞内に導入するように構成される。この実施態様では、マニピュレーターアセンブリ 2 はフレーム 16 の末端サポート部材 19 上のカニユーレ 50 を支持し、これは内視鏡外科手術処置の間は入口用の切り口内に配置される (図 1 ではカニユーレ 50 は概略的に描かれており、一般にはずっと長いことに留意せよ) 。好ましくは、カニユーレ 50 は、結腸切除やニセン・ファンドプリケーション (Nissen fundoplication) のような胸部内視鏡外科手術に適応した従来の気密トロカールスリーブである。

【 0 0 2 3 】

図 1 に示されているように、好ましくはカニユーレ 50 は、カニユーレ 50 内の環状ベアリング 54 に装着された力感知エレメント 52 (例えば歪みゲージ又は力感知抵抗器) を含む。外科手術中ベアリング 54 は用具 14 を支持し、用具が回転し且つベアリング 54 の中心穴を通して軸方向に移動できるようにする。ベアリング 54 は、用具 14 により与えられる横方向の力を力感知エレメント 52 に伝え、この力感知エレメント 52 は、コントローラー機構に作動連結され、遠隔操縦ロボットシステムにおいて外科医が保持している入力制御装置 (図示せず) にこれらの力を伝える。このようにして、外科手術切り口を取り囲む組織のようなカニユーレ 50 に作用する力により妨害されることなく、又はマニピュレーターアセンブリ 2 に作用する重力や慣性力により妨害されることなく、用具 14 に作用する力が検出できる。このことにより、ロボットシステムにおいてマニピュレーターアセンブリを使用するのが容易になる。というのは、外科医は用具 14 の端に作用する力を直接感知するからである。もちろん、用具 14 の末端エンドに作用する重力も力感知エレメント 52 により検出される。しかしながら、これらの力は、用具の直接操作中においても外科医により感知されるものである。

【 0 0 2 4 】

図 1 に示されているように、用具ホルダー 4 はボールスプラインベアリング 62、64 を介してシャフト 18、20 上に装着されたシャシー 60 を含み、シャシー 60 はシャフト 18、20 に対して軸方向に動くことは出来るがシャフト 18、20 と共に回転することは防止される。好ましくは、シャシー 60 は、ステンレス鋼のように高温消毒工程での膨張に耐える材料から構成されるので、シャシー 60 は外科手術処置の後に消毒できる。シャシー 60 は、外科手術用具 14 を受け入れるための中心空洞 66 と、シャシー 60 から横方向に延在するアーム 68 を含む。アーム 68 はドライブベルト 36 に固定され、ドライブベルト 36 の回転により用具ホルダー 4 をシャフト 18、20 に沿って軸方向に移動させる。

【 0 0 2 5 】

用具ホルダー 4 はベース 6 及びドライブモーターに取り外し可能に連結され、ホルダー 4 全体を取り外して蒸気、熱圧力、化学薬品などのような従来の方法により消毒できる。好適な構成では、アーム 68 は、回転できドライブベルト 36 からアームを開放するトルクスイッチ 69 を含む (図 1) 。加えて、図 1 A に示されているように、シャフト 18、20 はベアリング 22 に取り外し可能に連結され、フレーム 16 のサポート部材 17、19 からシャフトを軸方向に引っ込められる。このために、好ましくは末端ベアリング 22 は、シャフト 18、20 の取り外しを可能にするための連結機構を含む。図 7 に示されているように、末端サポート部材 19 は各末端ベアリング 22 内にサポートカラー 71 を含

10

20

30

40

50

み、この末端ベアリング 22 は、シャフト 18、20 の一つに対する通路用の内部穴 72 を備える。各サポートカラー 71 は内部溝 73 を有し、シャフト 18、20 の各々はそれらの下端部近くに環状溝 74 を有し（図 1 A 参照）、この環状溝 74 は、シャフトがフレーム 16 内に適切に装着されると内部溝 73 と整列する（図 1）。バネクリップ 75 は各内部溝 73 内に置かれ、それぞれのサポートカラー 71 内に各シャフト 18、20 を保持する。バネクリップ 75 は切れ目（図示せず）を有し、シャフトに軸方向の閾値力が働く際にシャフト 18、20 の取り外しを可能にする。

【0026】

用具ホルダー 4 をベース 6 から取り外すため、オペレーターはトグルスイッチ 69 を回転してドライブベルト 36 からアーム 68 を開放しドライブ 8、10 からドライブベルト 28、32 を取り外す。図 1 A に示されているように、オペレーターは用具ホルダー 4 を保持しシャフト 18、20 を上方に引っ張って、バネクリップ 75 を開放するのに十分な力を与える。シャフト 18、20 は末端ベアリング 22 から外れてボールスプラインベアリング 62、64 を介してスライドし、その結果用具ホルダー 4 はベース 6 から分離される。本発明は、用具ホルダー 4 をベース 6 及びドライブアセンブリ 7 に取り外し可能に連結するための上記手段に制限されるものでないことは理解すべきである。例えば、外科医が単純に部材 19 を取り外してホルダーを下方にシャフト 18、20 からスライドさせるように、末端サポート部材 19 はフレーム 16 の残りの部分と取り外し可能に連結できる。同様に、基部サポート部材 17 をフレーム 16 に取り外し可能に連結できる。あるいは、ドライブモーターは、ベース 6 に取り外し可能に取り付けられた別のサーボボックス（図示せず）内に収容できる。この構成では、サーボボックスはベース 6 から取り外されて、ベース 6 全体がホルダー 4 と共に消毒できる。

【0027】

ベース 6 の下部（末端サポート部材 19 を含む）も、（例えばベース 6 の下部を消毒槽に浸すことにより）消毒でき、ホルダー 4 又は用具 14 と接触する部分を浄化できる。この種の消毒を容易にするために、好ましくはシャフト 18、20 は図 1 に示されているものより幾らか長くし、ベース 6 の下部（ドライブアセンブリ 7 を含む）をホルダー 4 及び用具 14 から十分に離して配置する。この様にして、遠隔操縦ロボットシステムで求められるドライブモーター又は電気接続を損傷することなく、外科手術処置の後に外科手術マニピュレーターを容易に消毒できる。

【0028】

用具ホルダー 4 はさらに、外科手術用具 14 をマニピュレーターアセンブリに開放可能に連結するための用具サポート 70（詳細は図 3 A 参照）を含む。用具サポート 70 は装着ベアリング 74 を介してシャシー 60 内に回転可能に取り付けられ、サポート 70 及び用具はそこで回転できる。図 1 に示されているように、サポート 70 は環状リングギア 76 と外接し、この環状リングギアの歯は、第 1 シャフト 18 に装着されたドライブギア 78 の歯と噛み合う。ドライブギア 78 は第 1 シャフト 18 と共に回転するように第 1 シャフト 18 の回りに構成され、それと共に用具サポート 70 と外科手術用具を回転させる。ドライブギア 78 は第 1 シャフト 18 に対して軸方向にも動くよう構成され、用具ホルダー 4 をフレーム 16 に対して軸方向に移動可能とする。

【0029】

用具ホルダー 4 はさらに、軸方向ガイドスロット 82 内でシャシー 60 のどちらかの側面に移動可能に取り付けられたアクチュエータードライバー 80 を含む（詳細は図 5 を参照）。アクチュエータードライバー 80 はリングギア 86 を有する螺旋アクチュエーター 84（詳細は図 6 B 参照）を含み、このリングギア 86 は、第 2 シャフト 20 に装着されたグリッパードライブギア 88 と噛み合う。第 2 シャフト 20 が回転することにより、グリッパードライブギア 88 が回転し、それによりシャシー 60 内でリングギア 86 及び螺旋アクチュエーター 84 を回転させる。アクチュエータードライバー 80 はさらに、外科手術用具 14 のエンドエフェクターアクチュエーターを用具ホルダー 4 に開放可能に連結するためのアクチュエーターキャリッジアセンブリ 90（詳細は図 6 A 参照）を含む（図

10

20

30

40

50

2 参照)。以下において更に詳細に述べるように、キャリッジアセンブリ 90 は螺旋アクチュエーター 84 及びシャシー 60 内に装着され、螺旋アクチュエーター 84 が回転することに応じてキャリッジアセンブリ 90 がシャシー 60 に対して軸方向に移動する。

【0030】

図 2 A 及び図 2 B には、遠隔操縦ロボット外科手術のためのマニピュレーターアセンブリ 2 のようなモーター駆動マニピュレーターにより操作できる内視鏡外科手術用具 14 の特定の実施例が示される。外科手術用具 14 は、経皮貫通を通して体腔内に送るのに適した従来の種々の内視鏡用具（例えば組織把持器、針ドライバー、マイクロ鋏、電気メス解剖用具など）とできる。好適実施態様では、用具 14 は、基部エンド 102、末端エンド 104 及びそれらの間の長手方向軸 106 を有するシャフト 100 を含む組織把持器である。刻み付きハンドル 114 がシャフト 100 の基部エンド 102 に取り付けられ、用具 14 の操作を容易にする。

10

【0031】

好ましくは、シャフト 100 は 2 ~ 10 mm の範囲（通常は 4 ~ 8 mm）の外径を有するステンレス鋼管であり、2 ~ 15 mm の範囲の内径を有するカニューレ内に嵌まる。シャフトもまた患者の経皮切り口を通して直接導入される。シャフト 100 は、腹部のような体腔内の目標場所にとどき且つ体腔から十分に延びるような長さに設定され、外科手術用具 14 を容易に操作できるようにする。よって、シャフト 100 は少なくとも 10 ~ 40 cm の間、好ましくは 17 ~ 30 cm の間とすべきである。図面ではシャフト 100 は円形の断面形状を有して示されているが、その他矩形、三角形、楕円または溝状の断面形状とできる。

20

【0032】

特定の構成では、シャフト 100 は、用具サポート 70 及びマニピュレーターアセンブリ 2 の第 1 ドライブ 8 に対して開放可能に外科手術用具 14 を連結するための装着手段を含む。好適実施態様では、装着手段はシャフト 100 から横方向外側に延在する 1 対の対向装着ピン 116 から成る。装着ピン 116 はシャフト 100 にしっかりと接続され、以下で詳細に説明するように用具サポート 70 上のツイスト・ロック・インターフェースと係合するのに適している。本発明は一对の対向ピンに限定されるものではなく、装着手段には一つの装着ピン又はシャフトの周囲に延在する複数のピンを含み得ることも分かる。その他、ピン 116 はもし望めば球状や環状のような様々な別の形状を有し得る。

30

【0033】

用具 14 はエンドエフェクター 120 を含み、これは末端エンド 104 から延在し、腹腔鏡外科手術の間、腹部のような患者の組織構造に係合する。好適実施態様では、エンドエフェクター 120 は 1 対の顎部 122、124 を含み、これらは開閉位置間で移動可能で血管を掴んだり、縫合用縫糸を保持したりする。好ましくは、顎部 122、124 は横方向溝又は対向表面上に別の構造特徴（図示せず）を有し、組織構造を掴むのを容易にする。顎部 122、124 により組織を損傷するのを避けるために、顎部は、顎部 122、124 を包むゴム製のエラストマースリーブ、フォーム又は外科手術ガーゼのような非外傷性手段（図示せず）をも含む。

【0034】

40

顎部 122、124 を開閉位置間で移動させるために、用具 14 はエンドエフェクターアクチュエーターを含み、これはアクチュエータードライバー 80 及びマニピュレーターアセンブリ 2 の第 2 ドライブ 10 に開放可能に連結される（図 4 参照）。好適実施態様では、エンドエフェクターアクチュエーターは一对の対向アクチュエーターピン 132 を含み、これらのピンはシャフト 100 内で軸方向に延在するスロット 134 から横方向に突出している。アクチュエーターピン 132 は長ロッド 136 に連結され、この長ロッドはシャフト 100 の内腔 138 内にスライド可能に配置される。アクチュエーターピン 132 はスロット 134 内でスライド可能であり、そのため、ロッド 136 はシャフト 100 及び装着ピン 116 に対して軸方向に移動可能であり従来技術のように顎部 122、124 を開閉する。長ロッド 136 は、シャフト 100 内の内腔 142 内に配置された基部部

50

分 1 4 0 を有し、アクチュエーターピン 1 3 2 が横方向に動くのを防ぎ、外科手術処置の間、ロッド 1 3 6 がシャフト 1 0 0 内で一般に中心に確実に残るようにする。

【 0 0 3 5 】

好ましくは、顎部 1 2 2、1 2 4 は環状圧縮バネ 1 4 4 により閉位置に置かれ、この環状圧縮バネはシャフト 1 0 0 内においてアクチュエーターピン 1 3 2 とシャフト 1 0 0 の内面に固定された環状ディスク 1 4 6 の間に配置される。このことにより、内視鏡処置の間、外科手術チームはカニユーレ 5 0 内に組織を突き刺すことなく、又は周囲の組織を損傷することなく、カニユーレ 5 0 (又は他のタイプの経皮貫通) を通って体腔内に顎部 1 2 2、1 2 4 を導入できる。

【 0 0 3 6 】

図 3 A、図 3 B、図 4 にはツイストロック機構が示されており、これは外科手術用具 1 4 をマニピュレーターアセンブリ 2 に開放可能に接続し、内視鏡外科手術処置の間、異なる用具を素早く交換できるようになっている。図 3 A に示されているように、用具サポート 7 0 は環状カラー 2 0 0 を含み、これは外科手術用具 1 4 のシャフト 1 0 0 を受け入れるための中心穴 2 0 2 を定める。カラー 2 0 0 はさらに軸方向に延在し穴 2 0 2 と連通したスロット 2 0 4 を定め、このスロットは、装着を可能にし且つ用具 1 4 のアクチュエーターピン 1 1 6、1 3 2 がそれを通してスライドできるようなサイズにされる(図 4 参照)。2 つのロックスロット 2 0 6 が横断角度(好ましくは 90°)にて環状カラー 2 0 0 内に軸方向延在スロット 2 0 4 まで切り込まれる(ロックスロットのうちの一つだけが図 3 A には示されている)。以下で議論するように、ロックスロット 2 0 6 は環状カラー 2 0 0 の中心近くにてスロット 2 0 4 と交差し、穴 2 0 2 の周囲(好ましくは約 90°)に延在し両方の装着ピン 1 1 6 がそれを介して回転できる。

【 0 0 3 7 】

図 3 A、図 8 に示されているように、用具サポート 7 0 はさらに、装着ピン 1 1 6 をロックスロット 2 0 6 内にロックするための手段を含み、それにより、外科手術中に用具が偶然に捻られて用具サポート 7 0 から外れることはない。好ましくは、図 3 A に示されているように、ロック手段はプランジャ 2 1 0 を有するラッチアセンブリを含み、このプランジャがカラー 2 0 0 の穴 2 1 2 内にスライド可能に配置される。プランジャ 2 1 0 は L 型ラッチ 2 1 3 を含み、この L 型ラッチは、穴 2 1 2 を通って延在するロッド 2 1 5 により開放ボタン 2 1 4 に連結される。プランジャ 2 1 0 は第 1 位置と第 2 位置の間で移動可能である。この第 1 位置では、ラッチ 2 1 3 はロックスロット 2 0 6 内に配置されて装着ピン 1 1 6 はそれを通して自由に回転でき、上記第 2 位置では、ラッチ 2 1 3 はロックスロット 2 0 6 の一つ内に少なくとも部分的に配置されて装着ピン 1 1 6 が回転するのを防ぐ。好ましくは、ラッチ 2 1 3 は圧縮バネ 2 1 6 により第 2 位置、即ちロック位置に置かれる。

【 0 0 3 8 】

外科医によるマニュアル操作又はベース 6 による自動操作のためのボタン 2 1 4 が、サポート 7 0 の上面に設けられる。好ましくは、用具ホルダー 4 がその最も基部の位置に動かされたとき(図 1 参照)、フレーム 1 6 の基部サポート部材 1 7 は開放スイッチ 2 1 4 を押し下げてラッチ 2 1 3 を第 1 位置即ち開放位置に移動させる。この構成により、用具ホルダー 4 が最も基部の位置にあり用具 1 4 のシャフト 1 0 0 が容易にアクセス可能となきにのみ、用具を交換できる。加えて、このことにより、用具の末端がカニユーレ 5 0 に貫通して体腔内にあるとき用具が偶然に開放されることが防げる。

【 0 0 3 9 】

交差する軸方向スロット及びロックスロット 2 0 4、2 0 6 は、外科手術用具 1 4 の装着ピン 1 1 6 を用具ホルダー 4 に開放可能に連結するためのインターフェースを形成する。図 4 に示されるように、用具 1 4 を挿入するために、外科医は装着ピン 1 1 6 を軸方向スロット 2 0 4 に整列させ、装着ピン 1 1 6 がロックスロット 2 0 6 に整列するまで環状カラー 2 0 0 の穴 2 0 2 を通して用具をスライドさせる。それから、用具はロックスロット 2 0 6 を通して十分なだけ(好ましくは約 1 / 4 回転)回転され、ピンが軸方向スロ

10

20

30

40

50

ト 2 0 4 にもはや整列しないようにする。用具 1 4 が末端に移動すると、スイッチ 2 1 4 が開放され（図 1）、ラッチ 2 1 3 がロックスロット 2 0 6 内に移動し、装着ピン 1 1 6 が回転し戻り軸方向スロット 2 0 4 に整列することを防ぎ、用具 1 4 が用具サポート 7 0 に固定される。一つの装着ピンを上記構成と共に用いて外科手術用具をサポートにロックできることに留意すべきである。しかしながら、2つの対向ピンが好ましい。というのは、この構成によりロックスロット 2 0 6 の内面に作用する捩り力が減じられるからである。

【 0 0 4 0 】

好ましくは、図 8 に示されているように、ロック手段はカラー 2 0 0 内に配置されたボール止め金 2 1 7 を含む。ボール止め金 2 1 7 はバネ 2 1 8 によりロックスロット 2 0 6 の一つ内上方に置かれる。ボール止め金 2 1 7 は、軸方向スロット 2 0 4 に整列した位置から約 90° 回転した位置に装着ピン 1 1 6 を一時的に捕獲する働きをする。このことにより、用具 1 4 が用具ホルダー内にツイストされた際、装着ピンが完全に回転されて適切な位置におかれる（即ちラッチ 2 1 3 から離れる）。さもなければ、スイッチ 2 1 4 が開放された際、ラッチ 2 1 3 が装着ピン 2 1 6 と係合してラッチがロック位置に完全に移動することが出来なくなり、それにより外科手術の間に用具 1 4 が偶然外れる可能性が生じてしまう。

【 0 0 4 1 】

図 3 B、図 4、図 5 に示されているように、用具ホルダー 4 のアクチュエータードライバー 8 0 はさらに、用具 1 4 のアクチュエーターピン 1 3 2 を開放可能に保持し移動させるためのアクチュエーターピンキャッチ 2 2 0 を含む。アクチュエーターピンキャッチ 2 2 0 は用具サポート 7 0 と同様に構成され（図 3 A）、環状カラー 2 2 2 を含み、この環状カラーは、シャフト 1 0 0 を受け入れる穴 2 2 4 及びアクチュエーターピン 1 3 2 を受け入れる軸方向延在スロット 2 2 6 を定める。装着ピンに関して上記議論したように、ロックスロット 2 2 8 は 90° の角度にてアクチュエーターピンキャッチ 2 2 0 内に切り込まれ、アクチュエーターピンはロックスロット内に回転できアクチュエーターピン 1 3 2 をアクチュエータードライバー 6 6 に連結する。アクチュエーターピン 1 3 2 は装着ピン 1 1 6 の末端に位置するので（好ましくは用具はまず顎部が挿入される）、スロット 2 2 6 はカラー 2 2 2 を通って完全に延在する必要はない。もちろん、アクチュエーターピン 1 3 2 及び装着ピン 1 1 6 は、もし望めば装着ピンがアクチュエーターピンの末端にくるように逆にできる。

【 0 0 4 2 】

図 6 A を参照すると、アクチュエーターピンキャッチ 2 2 0 はアクチュエーターキャリッジアセンブリ 9 0 内のボールベアリング 2 3 0 に回転可能に取り付けられる。ベアリング 2 3 0 により、ピンキャッチ 2 2 0 は軸方向の相対的な運動を防ぎつつキャリッジアセンブリ 9 0 内で自由に回転できる。よって、用具 1 4 が第 1 ドライブ 8 により回転される際、アクチュエーターピン 1 3 2 はキャリッジアセンブリ 9 0 内で回転する。キャリッジアセンブリ 9 0 はさらに、一对の内部ローラー 2 3 6 及び一对の外部ローラー 2 3 8 を回転可能に支持するための 2 組の心棒 2 3 2 を含む。図 1 に示されているように、外部ローラー 2 3 8 はシャシー 6 0 の軸方向ガイドスロット 8 2 内にスライド可能に配置され、キャリッジアセンブリ 9 0 がシャシー 6 0 に対して回転するのを防ぐ。内部及び外部ローラー 2 3 6、2 3 8 は螺旋アクチュエーター 8 4 及び用具ホルダー 4 のシャシー 6 0 と協働してホルダーに対して軸方向に移動し、それにより、ピンキャッチ 2 2 0 及びアクチュエーターピン 1 3 2 をそれらと共に用具 1 4 のシャフト 1 0 0 に対して軸方向に移動させる（上述のようにこのシャフトは顎部 1 2 2、1 2 4 を作動させる）。

【 0 0 4 3 】

図 6 B に示されているように、螺旋アクチュエーター 8 4 は、キャリッジアセンブリ 9 0 及び外科手術用具 1 4 を受け入れる中心穴 2 4 0 と、2つの対向螺旋溝 2 4 2、2 4 4 を含み、これらの溝の各々は螺旋アクチュエーター 8 4 の周囲に延在し（好ましくは 180° より僅かに小さく）て図 5 に示されるようにキャリッジアセンブリ 9 0 の内部ローラ

10

20

30

40

50

ー 2 3 6 を受け入れる。シャシー 6 0 の軸方向ガイドスロット 8 2 内に拘束された外部ローラー 2 3 8 により、螺旋アクチュエーター 8 4 が回転することでキャリッジアセンブリ 9 0 (及びアクチュエーターピンキャッチ 2 2 0) が回転の感度に依存して上下に移動する。螺旋アクチュエーター 8 4 の対称的な設計ゆえに、第 2 ドライバー 1 0 により作用する作動力は用具 1 4 の如何なる効果的な側面負荷も発生させず、このことにより、軸方向 (第 3 ドライバー 1 2) 及び回転 (第 1 ドライバー) のような他の自由度との摩擦連結が避けられる。好適実施態様では、螺旋溝 2 4 2、2 4 4 のピッチは、機構が容易に後方駆動できるように設定され、位置サーボ遠隔操作システムにおいて握み力を感知することが可能となる。

【 0 0 4 4 】

10

図 3 A、図 3 B に示されるように、用具ホルダー 4 はさらに、用具サポート 7 0 に固定された一対の軸方向ガイドピン 2 5 0、2 5 2 を含む。アクチュエーターピンキャッチ 2 2 0 は、ガイドピン 2 5 0、2 5 2 を受け入れる一対の開口 2 5 4、2 5 6 を有する。ガイドピン 2 5 0、2 5 2 は、ピンキャッチ 2 2 0 とサポート 7 0 の間での相対的な回転を防ぎ (その結果、アクチュエーター及び装着ピン 1 1 6、1 3 2 は両方とも用具と共に回転できる)、そして互いに相対的な軸方向の運動を可能にする (その結果、エンドエフェクター 1 2 0 はアクチュエーターピン 1 3 2 の軸方向移動により作動され得る)。

【 0 0 4 5 】

図 9 はリモート中心位置決め器 3 0 0 の立面図であり、これは患者の上でマニピュレーターアセンブリ 2 を支持するのに用いることができる (サポートマニピュレーター 2 は図 8 には示されていないことに留意)。リモート中心位置決め器 3 0 0 はマニピュレーターアセンブリ 2 に対して 2 自由度を与え、入り口切り口に一致する地点 3 0 8 の回りに回転するよう拘束する。好ましくは、地点 3 0 8 はカニユーレ 5 0 内のベアリング 5 4 のほぼ中心となる (図 1)。リモート中心位置決め器 3 0 0 の更に完全な説明は、一般譲渡された同時係属出願第 0 8 / 0 6 2、4 0 4 号、1 9 9 3 年 5 月 1 4 日提出、「リモート中心位置決め器」に記載されており、参考のためここに添付する。

20

【 0 0 4 6 】

第 1 リンク手段は参照番号 3 2 1 により一般的に示され、平行四辺形の形式の第 2 リンクは参照番号 3 2 3 により示される。第 1 リンク手段はベースプレート上に旋回自在に装着されて x - x 軸の回りを回転する。第 2 リンク手段は第 1 リンク手段に旋回自在に接続され、第 1 リンクと平行な面内を移動するよう適合される。5 つのリンク部材 (その延長部を含む) 3 1 1、3 1 2、3 1 3、3 1 4、3 1 5 は、ピボット継ぎ手 3 1 6 - 3 2 0 と共に接続される。エレメント 3 1 3 の一部は平行四辺形リンクのピボット 3 2 0 を越えて延在する。平行四辺形リンクは、リンク部材 3 1 3 において操作エンドを有し、リンク部材 3 1 2 において駆動エンドを有する。後に望まれるように、延長されたエレメント 3 1 3 は、外科手術用具、又はマニピュレーターアセンブリ 2 のサポートブラケット 2 4 のような他の装置を支持できる。ピボット継ぎ手により、リンク部材を含む平面内でのみリンク部材の相対的な運動が可能となる。

30

【 0 0 4 7 】

平行四辺形リンクは、対応するリンク部材 3 1 4、3 1 5 及びリンク部材 3 1 2、3 1 3 により形成される。平行四辺形のリンク部材 3 1 4、3 1 5 の部分は、平行四辺形の部材 3 1 2、3 1 3 の部分と同じ長さである。これらの部材は平行四辺形内で共に接続され、それらの部材により形成される平面内でのみ相対的な運動を行う。参照番号 3 2 2 により一般に示された回転自在継ぎ手は、適当なベース 3 2 4 に接続される。回転自在継ぎ手 3 2 2 は、ベースサポート手段 3 2 4 に固定装着するのに適応したベースプレート 3 2 6 上に取り付けられる。ピボットプレート 3 2 8 は、例えばピボット 3 3 0、3 3 2 において適当な手段によりベースプレート 3 2 6 に旋回自在に取り付けられる。よって、ピボットプレート 3 2 8 は所望の角度 θ 2 だけ軸 x - x の回りを回転できる。これは、マニュアルまたは適当なピボットドライブモーター 3 3 4 により行うことができる。

40

【 0 0 4 8 】

50

第1リンクは、回転自在継ぎ手322のピボットプレート328上に回転自在に取り付けられる。リンクエレメント311、312及びリンク部材は相対的に固くて曲がらず、そのため外科手術で用いられる用具を適切に支持できる。アルミニウムや他の金属製のロッドはそのようなリンクとして有効である。リンクエレメント311、312はベースプレート328上に回転自在に取り付けられ、ピボット336、338により回転自在継ぎ手に対して回転する。少なくとも一つのピボット336、338が、回転のその軸がx-x軸に垂直となり且つx-x軸と交差するように、位置決めされる。移動はマニュアルでも行えるし、リンクドライブモーター340を用いても行える。第1リンクもまた、リンクエレメント311、312、ピボット316、318によりそれらに接続されたリンク部材315の部分、及びベースプレート328により形成された平行四辺形の形式の形状とされる。よって、リンク部材315の一つは、第1及び第2リンク手段321、323の両方において使用される。リンクエレメント312はまた、第1及び第2リンク手段321、323の両方の共通リンクを形成する。本発明に従い、リンクエレメント311が回転する際、及び/又はピボットプレート328が軸x-xの回りを回転する際、上記実施態様の装置により球回転のリモート中心308が与えられる。よって、エレメント313のエンドは所望の角度 $\theta 1$ 及び $\theta 2$ だけ移動でき、またはそれ自身の軸の回りに回転できる一方、回転のリモート中心は同じ配置のままである。

10

【0049】

図9には、リモート中心位置決め器300のベースに取り付けられたクリノメーター350も示されている。リモート中心位置決め器は、実行される特定の外科手術に依存して、垂直に対して任意の方向に取り付けることができ、クリノメーター350はこの方向を測定するのに用いることができる。測定された方向は、遠隔操縦ロボットシステムを制御するのに必要なサーボ制御信号を計算して実行するのに用いることができ、外科医がシステム機構に作用する重力を感じないようにする。

20

【0050】

本発明の精神を逸脱することなく他の人により改変及び変更は為し得る。例えば、本発明は内視鏡外科手術に制限されないことを理解すべきである。実際、遠隔操縦ロボット制御機構に従った用具ホルダー4は特にオープン外科手術処置の間有効であり、異なる部屋又は完全に違う病院のような遠隔場所から外科医が手術するのを可能にする。

【先行技術文献】

30


【特許文献】

【0051】


【特許文献1】米国特許出願第08/823,932号

【特許文献2】米国特許出願第08/062,404号


【 図 1 A 】

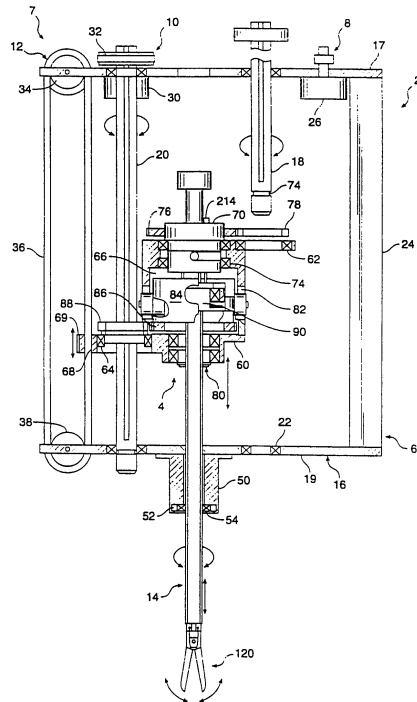


【 図 2 B 】

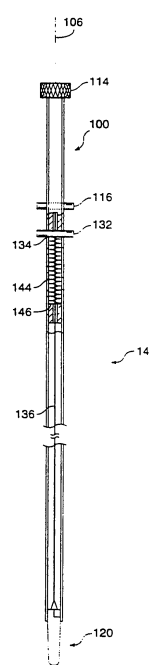

【図 3】

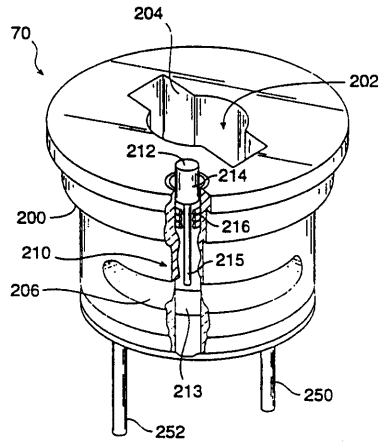


A

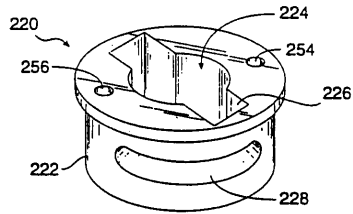


B


【図 4】

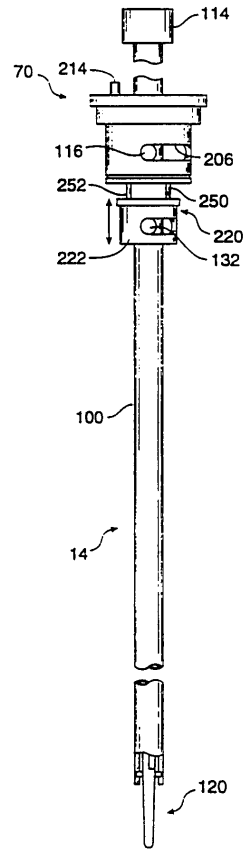


【図 5】

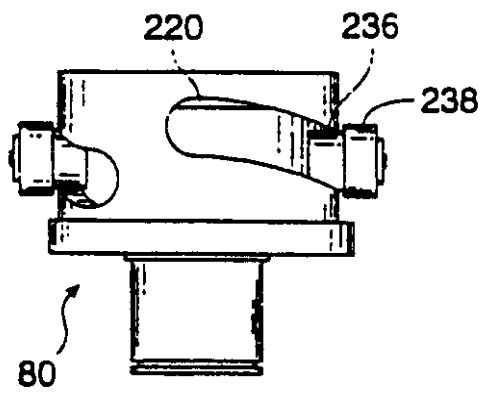

【図 6】

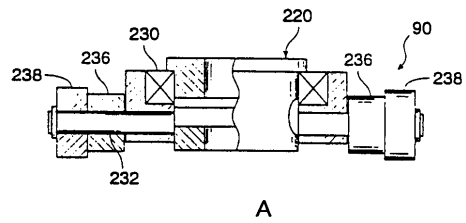


A

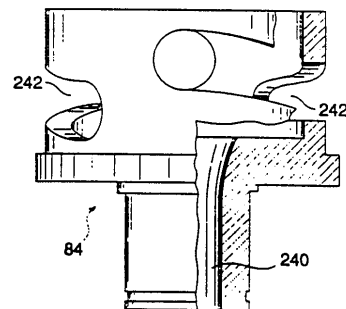


B


【図 7】

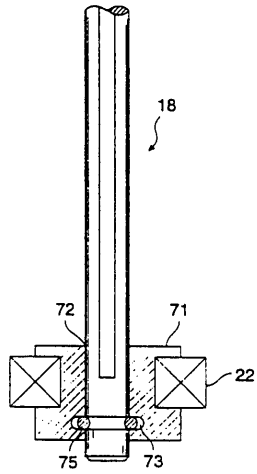

【図 8】

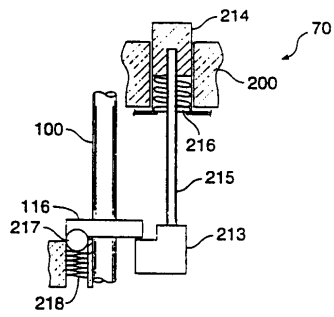

【図 9】

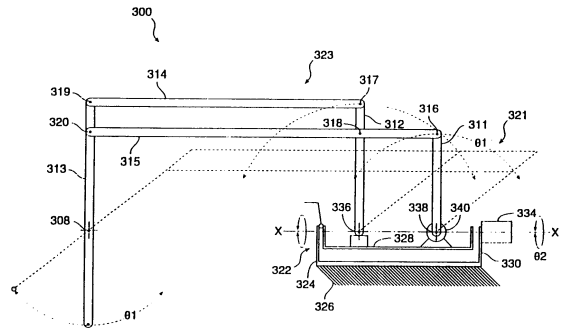

フロントページの続き

- (72)発明者 ジェンセン, ジョエル, エフ.
アメリカ合衆国 カリフォルニア州 9 4 0 6 1 レッドウッド・シティー、ノーザンバーランド
・アヴェニウ 4 2 6
- (72)発明者 ヒル, ジョン, ダブリュー.
アメリカ合衆国 カリフォルニア州 9 4 3 0 3 パロ・アルト、チャールストン・コート 7 1
3

合議体

審判長 山口 直

審判官 平瀬 知明

審判官 内藤 真徳

- (56)参考文献 特開平 7 - 1 3 6 1 7 3 (J P , A)
特開平 7 - 1 9 4 6 1 0 (J P , A)

- (58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)
A61B 19/00

专利名称(译)	用于遥控机器人系统的手术机械手		
公开(公告)号	JP5943480B2	公开(公告)日	2016-07-05
申请号	JP2013002448	申请日	2013-01-10
[标]申请(专利权)人(译)	斯坦福研究院		
申请(专利权)人(译)	ES伯爵国际眼		
当前申请(专利权)人(译)	ES伯爵国际眼		
[标]发明人	ジェンセン ジョエル エフ ヒル ジョン ダブリュー		
发明人	ジェンセン, ジョエル, エフ. ヒル, ジョン, ダブリュー.		
IPC分类号	A61B90/00 A61B17/00 A61B17/28 A61B19/00 B25J9/10 B25J15/04 B25J18/04		
CPC分类号	A61B17/29 A61B34/30 A61B34/35 A61B34/70 A61B34/71 A61B34/76 A61B2017/00367 A61B2017/00464 A61B2017/00477 A61B2017/2902 A61B2017/292 A61B2034/305 A61B2090/506 B25J9/1065 B25J15/04 B25J18/04		
FI分类号	A61B19/00.502 A61B34/35 B25J3/00.A		
F-TERM分类号	3C707/AS35 3C707/HS27 3C707/HT02 3C707/JT05 3C707/JU12 3C707/KS33		
优先权	08/485587 1995-06-07 US 08/487020 1995-06-07 US		
其他公开文献	JP2013099555A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种用于在内窥镜治疗期间可打开地保持和操纵手术器械的装置和方法。解决方案：操纵器组件2包括：可固定到表面的支撑基座6;仪器支架4可移动地连接到基座6并具有用于可打开地保持手术器械的支架;驱动组件7可操作地连接到器械支架4上，用于为器械提供至少两个自由度;套筒70，其连接到器械支架4和驱动组件7的支撑基座6上，并且具有用于接收器械14的轴的轴向路径;力传感元件52连接到套管70并检测由器械轴的远端传递到套管70的侧向力，并且可操作地连接到控制器以将指示侧向力的信号传递给套管70。控制器。

(21) 出願番号	特願2013-2448 (P2013-2448)	(73) 特許権者	501228071
(22) 出願日	平成25年1月10日 (2013.1.10)		エスアールアイ インターナショナル
(62) 分割の表示	特願2010-173758 (P2010-173758)		SRI International
	の分割		アメリカ合衆国 カリフォルニア州 94
原出願日	平成8年6月5日 (1996.6.5)		025 メンロパーク レイバンスウッド
(65) 公開番号	特開2013-98555 (P2013-98555A)		アベニュー 333
(43) 公開日	平成25年5月23日 (2013.5.23)		333 Ravenswood Aven
審査請求日	平成25年1月10日 (2013.1.10)		ue, Menlo Park, Cal
審判番号	不服2015-18655 (P2015-18655/J1)		ifornia 94025, U. S.
審判請求日	平成27年10月15日 (2015.10.15)		A.
(31) 優先権主張番号	08/485,587	(74) 代理人	100093919
(32) 優先日	平成7年6月7日 (1995.6.7)		弁理士 奥村 義道
(33) 優先権主張国	米国 (US)		
(31) 優先権主張番号	08/487,020		
(32) 優先日	平成7年6月7日 (1995.6.7)		
(33) 優先権主張国	米国 (US)		