

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2011-521262

(P2011-521262A)

(43) 公表日 平成23年7月21日(2011.7.21)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO 1 N 33/574 (2006.01)	GO 1 N 33/574 D	
GO 1 N 33/543 (2006.01)	GO 1 N 33/543 5 4 1 A	
GO 1 N 33/533 (2006.01)	GO 1 N 33/533	

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願2011-510646 (P2011-510646)  
 (86) (22) 出願日 平成21年5月19日 (2009.5.19)  
 (85) 翻訳文提出日 平成22年12月27日 (2010.12.27)  
 (86) 国際出願番号 PCT/US2009/044510  
 (87) 国際公開番号 W02009/143149  
 (87) 国際公開日 平成21年11月26日 (2009.11.26)  
 (31) 優先権主張番号 61/054, 219  
 (32) 優先日 平成20年5月19日 (2008.5.19)  
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 505060347  
 ベリデックス・エルエルシー  
 Veridex, LLC  
 アメリカ合衆国、08869 ニュージャ  
 ージー州、ラリタン、ユーエス・ハイウエ  
 イ・202・ノース 1001  
 33 Technology Drive  
 , Warren, NJ 07059, U.  
 S. A.  
 (74) 代理人 100088605  
 弁理士 加藤 公延  
 (74) 代理人 100130384  
 弁理士 大島 孝文


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 免疫磁気濃縮された希少細胞の改良されたイメージング

(57) 【要約】

過剰な未結合磁性流体を除去し、免疫磁氣的に濃縮された循環腫瘍細胞をイメージングする方法を提供する。観察表面内に予備形成した溝を有する容器は、細胞整合及びイメージング用に最適に設計されている。未結合粒子を遠心分離により分離した後、外部より適用された力が磁気応答粒子 - CTC 複合体を透明収集壁に向かって輸送する。チャンバの観察面の、溝が形成された内側表面は、容易なイメージングのために粒子の均一分布を提供する。本発明は、例えば疾病における CTC の定量分析において、定量分析及びサンプル調製を自動化細胞計数技術と組み合わせて行うことにも有用である。

FIGURE 1

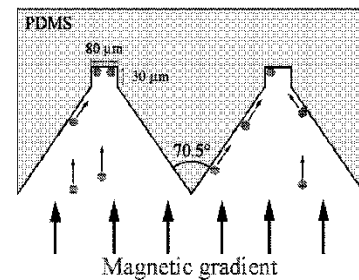

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

流体媒質中に浮遊する希少細胞を光学的に分析する改良された方法であって、

- a . 癌を有することが疑われる患者から血液サンプルを獲得することと、
- b . 前記血液サンプルを、上皮細胞の表面上の E p C A M 抗原に特異的な抗体と結合した磁性流体粒子と混合することと、
- c . 結合した磁性流体から未結合磁性流体を除去することと、
- d . 観察チャンパ内で時間遅延積分を用いて前記血液サンプル中の磁気応答成分を観察することと、を含み、

前記成分が、前記チャンパの光学的に透明な面の内側表面上の観察表面に沿って、予備成型された整合構造内にて均一に分布されている、方法。

10

## 【請求項 2】

前記整合構造が壕形状の溝である、請求項 1 に記載の方法。

## 【請求項 3】

前記整合構造が、画像観察表面及び整合表面を有する溝を含む、請求項 1 に記載の方法。

## 【請求項 4】

前記画像観察表面が 80 μ m である、請求項 1 に記載の方法。

## 【請求項 5】

前記未結合磁性流体の除去が、

- a . 磁性流体粒子を有する前記血液サンプルを、円錐管内にて 900 r p m で回転させることと、
  - b . 前記サンプルを前記円錐管の底から吸引することと、
  - c . 工程 ( a ) 及び ( b ) を 5 回繰り返すことと、
- を含む、請求項 1 に記載の方法。

20

## 【請求項 6】

前記観察が、C T C としての結合上皮細胞を確認することを更に含む、請求項 1 に記載の方法。

## 【請求項 7】

前記確認が、

- a . 核に D A P I で陽性の第 1 標識を行うことと、
  - b . 細胞骨格にサイトケラチン - P E で陽性の第 2 標識を行うことと、
  - c . 白血球に C D 4 5 - A P C で陽性の第 3 標識を行うことと、
- を含む、請求項 6 に記載の方法。

30

## 【請求項 8】

捕捉した C T C の明視野検査を行うことを更に含む、請求項 7 に記載の方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

( 関連出願の相互参照 )

本出願は、同時係属中の米国特許仮出願第 61 / 054 , 219 号 ( 2008 年 5 月 19 日 ) に対して優先権及び利益を主張し、この出願は全体が参考として本明細書に組み込まれる。

40

## 【背景技術】

## 【0002】

本発明は、微細な生物試料の定性分析及び定量分析を行うための改良された装置及び方法に関する。より詳細には、本発明は、結合剤を有する磁気応答粒子と免疫特異的又は非特異的に結合して、流体媒質中で磁気標識種を生成しやすい微細な生物試料又は物質を単離、収集、固定化及び / 又は分析するための装置及び方法に関する。本明細書で使用されるとき、「磁気標識試料」等の用語は、そのような磁気標識を受けやすい、研究上の関心

50

対象であるそのような生物試料又は物質を指すものとする。

【0003】

米国特許第5,985,153号には、収集チャンバ内に存在する磁気標識標的試料を外部磁気勾配によりチャンバの1つの表面に引き付け、内部磁気勾配によりそれらの試料をその表面上に精密に配列する装置及び方法が記載されている。磁気標識生物試料の収集表面への移動は、垂直磁気勾配を印可して、磁気標識生物試料を収集表面に移動させることにより行われる。収集表面には、例えば複数の強磁性ライン等の強磁性捕捉構造が設けられ、該構造は、サンプルチャンバの光学的に透明な（観察）面上に支持されている。

【0004】

磁気標識生物試料が外部から印可された磁気勾配により表面に十分近接して引かれると、試料は強磁性収集構造により生成された強力な局部勾配の影響下に置かれ、横方向にて隣接する位置に固定化される。この局部勾配は、生物試料が表面に衝突した後に、生物試料を透明な表面に保持し得る接着力を上回ることが好ましい。あるいは、この表面の接着性は、水平方向の磁気力が磁気標識生物試料を強磁性構造に向かって移動させるように十分弱い必要がある。表面の滑らかさ、及び疎水性又は親水性の性質は、収集表面用に選択される材料、又は滑りやすい表面を得るためのこの表面の処理に影響を与え得る因子である。

10

【0005】

米国特許第10/733829号及び同第6,790,366号には、上述した外部から印可される勾配の原理を組み込み、更に透明収集壁上に高い内部勾配を有する磁気捕捉構造を組み込んだ流体サンプル中の生物学的物質を分離、固定化及び定量するための方法及び装置が記載されている。捕捉構造は、自動計数技術を用いた定量分析のために、捕捉した生物学的物質の均一な配列を促す。

20

【0006】

米国特許第11/447562号には、自動光学分析用に標識試料を整合させる、チャンバの光学的に透明な（観察）面の流体側上の小V形の溝が記載されている。チャンバの光学的に透明な（観察）面の流体側上の小V形の溝と、磁気標識試料の最適な希釈とにより、自動光学分析用の整合表面が提供される。磁気標識試料及び未結合磁気粒子は、外部から印可された磁気勾配の影響下、チャンバの観察面の内側表面に向かって移動する。磁気標識試料及び未結合磁気粒子が表面に接近する際、それらはV形溝の傾斜と接触し、該傾斜は磁気標識試料及び未結合磁気粒子を溝の頂部に強制的に移動させる。

30

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

米国特許第11/344757号には、検出可能に標識された希少標的細胞の自動収集及び画像分析のためのデバイス及び方法が記載されている。それらの磁気標識希少細胞はCellTracksプラットフォーム内で時間遅延積分イメージング（Time Delay Integration Imaging）（TDI）に供される。しかしながら、癌患者の血液中の循環腫瘍細胞（CTC）を評価して疾患活動性と関連付ける際、免疫磁気分離により残留された未結合磁気粒子が画像を歪め、CTCとして捕捉した標的の確認を妨げる。

40

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明は、CellTracksプラットフォーム内でのTDIを用いた標識希少細胞の分析において、未結合磁気粒子の完全な除去を可能にする小溝設計を提供する。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】細胞整合構造の概略図。

【図2】滑らかな整合表面及びイメージング表面を有する、走査型電子顕微鏡を使用したPDMSインプリントの写真。

【図3】厚さ1.0mmの典型的なガラス顕微鏡スライドと比較した、厚さ1.3mmの

50

P D M S スラブ及び厚さ 0 . 5 m m の P M M A スラブの透過スペクトル。

【図 4】過剰な未結合磁気粒子の画像上の強度における影響を示す図。E p C A M 磁性流体レベルの上昇は画像強度の低下を招き、強度評価におけるばらつきが増大する。

【図 5】40  $\mu$  g / m l の磁性流体の存在及び不在下での全強度における差異を示す図。磁性流体が存在する場合、分布が悪化する。

【図 6】捕捉された S K B R - 3 細胞を示す、明視野、D A P I 及び P E 画像の組み合わせ。

【発明を実施するための形態】

【0010】

癌患者の血液中の循環腫瘍細胞 ( C T C ) は、疾患活動性と相関することが公知である。C e l l T r a c k s プラットホームは、疑わしい標的細胞を計数し、疾患活動性と相関付ける磁気濃縮及び画像分析を提供する。細胞、細胞片及び細胞成分等の標的を容器の収集表面と接触させて収集し、その後の強磁性収集構造に隣接させる整合を行わない。これらの細胞は、白血球細胞、上皮起源の細胞、内皮細胞、真菌細胞及び細菌細胞を含む。収集表面は、外部磁石により生成される磁場勾配に直交して配向されている。得られる像は、チャンパ上の光学的に透明な面上に実質的に均質に分布するように収集された磁気ナノ粒子及び磁気標識生物試料を含む一方、選択されない実体は、流体媒質中にて下方に残留する。

10

【0011】

C T C を迅速に検出し特徴付けるために、希少細胞分析において C e l l T r a c k s プラットホーム内に組み込んだ時間遅延積分 ( 米国特許第 1 1 / 3 4 4 7 5 7 号 ) を用いる。標的希少細胞 ( C T C ) の免疫磁気分離法は、E p C A M の陽性の選択により達成される。E p C A M に特異的であり、かつ磁気ナノ粒子に共有結合したモノクローナル抗体により、上皮細胞接着分子 ( E p C A M ) に関する抗原を発現している循環細胞が選択される。この複合体が磁場に暴露された際に、残りの血液成分から分離される。

20

【0012】

その後、捕捉された標的は、細胞内構成成分の一連の蛍光標識を介して分析される。蛍光染料 D A P I を使用して、C T C と、非特異的に選択された白血球との核を標識し、C T C の細胞骨格はサイトケラチン - P E で標識され、白血球は C D 4 5 - A P C で標識される。標識細胞は、分析表面に沿って整合するよう磁氣的に操作される。しかしながら、このシステムでは、免疫磁気分離により残留された未結合磁気粒子が画像の歪みを生じ、C T C の存在を確認する能力を低減させるであろう。

30

【0013】

空間的にパターン化された標的試料の収集を提供して、微細な生物サンプルの定性及び定量分析を行うために、本発明は、イメージングチャンパの内側表面上に予備成型された構造を形成し及び使用することに関する。一般に、予備成型された溝は、イメージングチャンパの観察表面の内側部分内に予備成型された長い V 形の溝である。これらの構造は、以前報告された N i ラインと同様の又はそれ以上に良好な細胞の整合を提供する。また、それらの構造は、細胞全体をイメージングするのに光学的に適した、高度に透明な材料から形成される。

40

【0014】

図 1 は、本発明の溝を用いた細胞整合の原理を示す。チャンパ内で磁氣的に誘導される細胞の移動は、磁気勾配の存在により生じる。ここで、磁気標識細胞は構造の傾斜表面 ( 整合表面 ) と衝突して溝の頂部 ( 指示したイメージング表面 ) 内に滑落するか、又はイメージング表面の頂部に直接当たるであろう。いずれの状況においても、細胞は溝内に整合し、続くイメージングを可能にする。

【0015】

溝の傾斜表面に沿った移動を十分にするために、表面は平坦であり、細胞の壁への付着が防止されなければならない。滑らかで精密な構造を達成するために、公知のウェハエッチング技術が用いられる。しかしながら、費用及び光学的要件により、シリコンウェハは

50

適切ではなく、ポリジメチルシロキサン (PDMS) レプリカ成型がこれらの要件を満たす構成を提供する。本発明において、この基準を満たすであろう構成も考慮される。シリコンウェハ上にエッチングされた構造は、最終的な構造の逆であり、シリコン鋳型上に注がれた際、正確な形状を有するPDMS鋳物が提供される。硬化後、この形状はイメージングチャンバのガラス表面を代替できる寸法に切断される。

#### 【0016】

エッチングは、チャンバの製造に使用できる光学的に透明な任意の材料に関して達成することができる。例として、精密加工の容易さ、微細な細部、及び容易に再現可能であることから、エッチングにシリコンウェハを使用してもよい。本発明では、同様の特性を有し、当技術分野で公知の任意の材料が考えられる。構造のエッチングには、2つの通常のエッチング技術を用いる。最初に、溝のエッチングに必要なエッチマスクを形成する。このマスクは、BHF (緩衝フッ化水素酸) エッチングを用いて形成される。BHFエッチングが完了した後、溝がエッチングされるべきでないシリコンウェハ上の場所に、 $SiO_2$ の薄い層が残留する。溝のエッチングには、異方性エッチングも用いられる。ここでは、エッチャントとしてKOHが使用される。このプロセスを適切に配向されたウェハに適用する場合、シリコンウェハの結晶面により制限されたV溝がエッチングされる。したがって、高度に再現可能な、一定のエッチ角度が生成される。角度は、図1に示す一実施形態では、70.5度であるウェハの配向に依存する。他の技術は、深い反応性イオンエッチング (DRIE) である。この技術を用いることにより、高いアスペクト比 (構造の長さとの比) を有する構造をエッチングすることができる。DRIEはエッチング工程と堆積工程との間を周期的に交代して、帆立貝状の側壁を形成する。

10

20

#### 【0017】

PDMS成型により、加工ウェハ上に陽性のインプリントを得る。PDMS、即ちポリジメチルシロキサン (Dow Corning (Sylgard 184, Dow Corning, Midland, MI, USA) は、Si (ケイ素) とO (酸素) との間にシロキサン結合を含むポリマーである。このポリマー分子は一緒に結合して、約50~100の平均数を有する、より長いポリマーを形成する。

#### 【0018】

最終的なPDMSは、架橋剤を添加して得られる。架橋剤はポリマーと接続して、ポリマーの長いネットワークを形成し、透明な、弾性を有する、化学的に不活性かつ熱的に安定な材料を生じる。重合後、PDMSは、接着する物質が殆ど存在しない、吸湿性でない透明な可撓性物質を形成し、かくしてPDMSが接着する物質は殆ど存在しない事実により、側部に対する細胞のいずれの付着も防止される。更に、PDMSは熱的に安定であり、約300~900nm透明である。これらの特性は全て、蛍光イメージングシステムにおけるその用途及び可視光の透過において重要である。形成後、溝をチャンバの観察面の寸法に切断する。

30

#### 【0019】

最小限の細胞損失で殆どの過剰な磁気粒子を除去するために、図1に示す観察面用の細胞整合構造を開発した。図1に、細胞整合構造の概観を提供する。図1に示すPDMSミクロ構造は、所定の領域内で細胞を整合させ、イメージング時間を短縮するよう開発された。この構造は、幅80 $\mu$ m、長さ30mmの6つのチャネルを含む30 $\times$ 2.7mm<sup>2</sup>のPDMSチップから構成されている。これらのPDMSチップは、ウェハ鋳型からインプリントされる。本発明者らは、PDMSをその卓越した透過特性、再現能力、及び使用の容易さにより選択した。この形態は、サンプルのイメージング時間を32分間から12分間へと短縮する。

40

#### 【0020】

図2は、本発明で使用される構造を有するPDMSインプリントの走査型電子顕微鏡写真を示す。この写真は、観察表面上の滑らかな整合表面及びイメージング表面を示す。

#### 【0021】

図3は、本発明で使用されるPDMSの厚さの透過スペクトルを、典型的なガラス顕微

50

鏡スライドと比較する。厚さ 0.5 mm を有する PMMA は、波長 400 nm ~ 800 nm においてガラス顕微鏡スライドの透過率を追跡する。

【0022】

最大の CTC 回収を確実にするために、過剰な結合磁気粒子 (EpCAM - 磁性流体) が使用される。しかしながら、イメージング中、過剰な磁性流体はイメージング表面上に細長い凝集体を形成し、これは細胞の定量及び定性イメージングに影響を与える。図 4 は、イメージングにおける過剰な未結合磁気粒子の影響を示す。総核強度は、磁性流体の濃度が  $2 \mu\text{g}/\text{ml}$  (円形) を越えると急に落下する一方、CV は、患者サンプル中に通常見出される濃度、例えば  $40 \mu\text{g}/\text{ml}$  (三角形) 等において 40% に上昇する。

【0023】

過剰な未結合磁気粒子のイメージングに対する影響と、除去方法の結果とを図 5 に示す。SKBR-3 細胞は、磁性流体濃度  $40 \mu\text{g}/\text{ml}$  及び  $0 \mu\text{g}/\text{ml}$  により画像化された。総強度の分布は、過剰な磁性流体を有するサンプルにおいて有意に悪化している。

【0024】

本発明はこの問題を回避し、円錐管内でサンプルを 900 rpm で回転させる方法を提供する。これは全細胞を管内で外方向に強制的に移動させる。磁性流体粒子は遙かに小さく (直径 175 nm 以下)、サンプル中にランダムに分布したまま残留する。数分後、回転管の底から 60% のサンプルを自動的に吸引する。このプロセスを 5 回繰り返し、SKBR-3 細胞は、本発明の PDMS 構造により観察表面に沿って整合した。図 6 は、観察表面に沿って整合した、捕捉された SKBR-3 細胞の明視野、DAPI 及び PE 画像の組み合わせを示す。

【0025】

本発明の方法を用いて 95% ~ 97% の過剰な磁性流体を除去して、患者サンプル中の最終濃度を  $2 \mu\text{g}/\text{ml}$  未満まで低下させることができる。それにより、十分な過剰な磁性流体が除去されて、定量測定が最適化され、画質がかなり改善される。また、CTC の回収は 95% ~ 99% と評価された (ranked)。したがって、本発明の方法による磁性流体除去は、最適な定量測定のために、過剰な磁性流体の十分な除去を提供する。画質が改善され、個々の CTC の更なる形態学的データを得るための明視野イメージングが可能となる。

【0026】

本発明の好ましい実施形態の特定のもの、上記の記述で具体的に例示されているが、本発明がこれらの実施形態に限定されることを意図するものではない。本発明の本質から逸脱することなく、さまざまな修正をこれに行うことが可能であり、この改良の全範囲が、下記の請求項に明確に記述されている。

【0027】

〔実施の態様〕

(1) 流体媒質中に浮遊する希少細胞を光学的に分析する改良された方法であって、  
 a. 癌を有することが疑われる患者から血液サンプルを獲得することと、  
 b. 前記血液サンプルを、上皮細胞の表面上の EpCAM 抗原に特異的な抗体と結合した磁性流体粒子と混合することと、  
 c. 結合した磁性流体から未結合磁性流体を除去することと、  
 d. 観察チャンパ内で時間遅延積分を用いて前記血液サンプル中の磁気応答成分を観察することと、を含み、

前記成分が、前記チャンパの光学的に透明な面の内側表面上の観察表面に沿って、予備成型された整合構造内にて均一に分布されている、方法。

(2) 前記整合構造が壕形状の溝 (foxhole-shaped grooves) である、実施態様 1 に記載の方法。

(3) 前記整合構造が、画像観察表面及び整合表面を有する溝を含む、実施態様 1 に記載の方法。

(4) 前記画像観察表面が  $80 \mu\text{m}$  である、実施態様 1 に記載の方法。

10

20

30

40

50

(5) 前記未結合磁性流体の除去が、

a. 磁性流体粒子を有する前記血液サンプルを、円錐管内にて900rpmで回転させることと、

b. 前記サンプルを前記円錐管の底から吸引することと、

c. 工程(a)及び(b)を5回繰り返すことと、

を含む、実施態様1に記載の方法。

(6) 前記観察が、CTCとしての結合上皮細胞を確認することを更に含む、実施態様1に記載の方法。

(7) 前記確認が、

a. 核にDAPIで陽性の第1標識を行うことと、


b. 細胞骨格にサイトケラチン-PEで陽性の第2標識を行うことと、

c. 白血球にCD45-APCで陽性の第3標識を行うことと、


を含む、実施態様6に記載の方法。

(8) 捕捉したCTCの明視野検査を行うことを更に含む、実施態様7に記載の方法。


【図1】

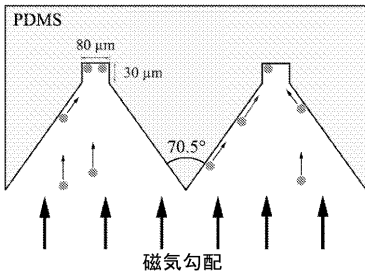


【図2】

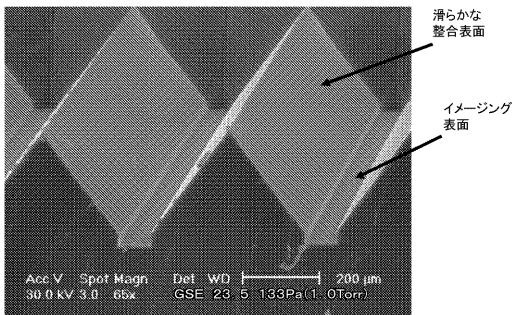


【図3】

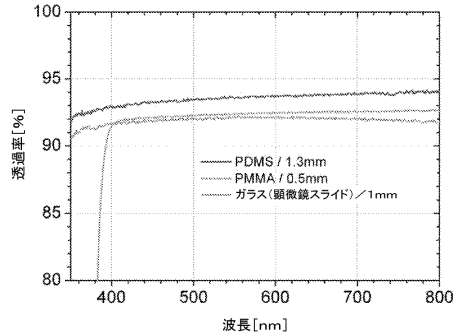

【図4】

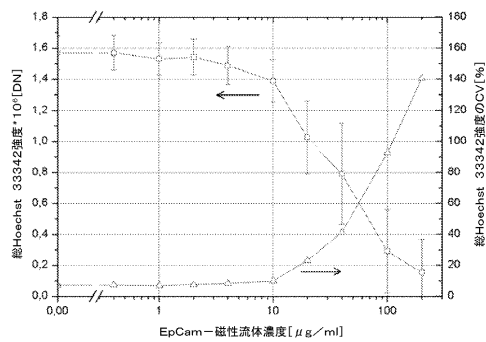


【 図 5 】

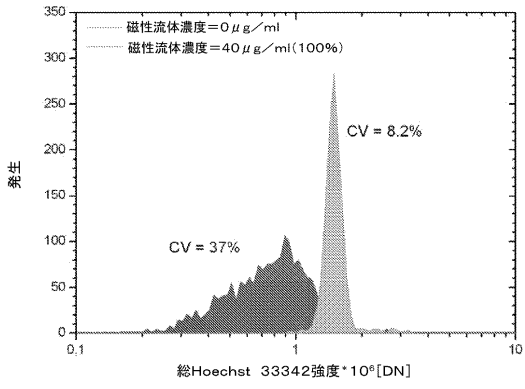

【 図 6 】

FIGURE 6

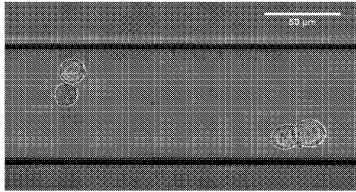

## 【 国際調査報告 】

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.  
PCT/US 09/44510

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> IPC(8) - B03C 1/033 (2009.01) USPC - 435/7.21 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) USPC: 435/7.21 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched USPC: 435/7.21; 210/222, 695; 422/50 (keyword delimited) Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) PubWest (PGPB, USPT, USOC, EPAB, and JPAB); Google Scholar Search Terms used: tumor, cancer, magnet\$, time delay integration, groove, v, foxhole, and shap\$1		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 2006/0257847 A1 (SCHOLTENS et al.) 16 November 2006 (16.11.2006), Fig 1B, 3, 8-11; abstract; para 0006, [0008], [0017], [0019], [0023], [0025], [0026], [0035]-[0037], [0040], [0041]; claim 1 and 2	1-8
Y	US 2006/0147901 A1 (JAN et al.) 06 July 2006 (06.07.2006), para [0006]-[0010], [0017], [0044], [0077], [0080]; claim 8	1-8
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/>		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "G" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 10 August 2009 (10.08.2009)		Date of mailing of the international search report <b>20 AUG 2009</b>
Name and mailing address of the ISA/US Mail Stop PCT, Attn: ISA/US, Commissioner for Patents P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450 Facsimile No. 571-273-3201		Authorized officer: Lee W. Young PCT Helpdesk: 571-272-4300 PCT OSP: 571-272-7774

## フロントページの続き

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(72) 発明者 ショルテンス・ティコ・エム  
オランダ国、エヌエル - 7 5 0 0 エイイー エンスヘーデ、ピー・オー・ボックス・2 1 7、メディカル・セル・バイオフィジックス・ドリエネルロラン 5、ユニバーシティー・オブ・トゥウエンテ

(72) 発明者 シュリュエデル・フレデリク  
オランダ国、エヌエル - 7 5 0 0 エイイー エンスヘーデ、ピー・オー・ボックス・2 1 7、メディカル・セル・バイオフィジックス・ドリエネルロラン 5、ユニバーシティー・オブ・トゥウエンテ

(72) 発明者 グレーベ・ヤン  
オランダ国、エヌエル - 7 5 7 6 イーアール オルデンザール、クリュイスカンプ 3 4

(72) 発明者 ティベ・アルヤン  
オランダ国、エヌエル - 7 4 2 5 ピージー デーフェンテル、アブラハム・ラーデマーケルストラート 4 1


(72) 発明者 タースタッペン・レオン・ダブリュ・エム・エム  
オランダ国、エヌエル - 1 0 9 5 ディーダブリュ アムステルダム、トゥ・ヴァン・ローハイゼン・ラーン 2 8 4

专利名称(译)	免疫磁性富集稀有细胞的改进成像		
公开(公告)号	<a href="#">JP2011521262A</a>	公开(公告)日	2011-07-21
申请号	JP2011510646	申请日	2009-05-19
[标]申请(专利权)人(译)	维里德克斯有限责任公司		
申请(专利权)人(译)	贝里指数有限责任公司		
[标]发明人	シヨルテンス・テイコ・エム シュリユーデル・フレデリク グレーベヤン ティベアルヤン タースタッペン・レオン・ダブリュ・エム・エム		
发明人	シヨルテンス・テイコ・エム シュリユーデル・フレデリク グレーベヤン ティベアルヤン タースタッペン・レオン・ダブリュ・エム・エム		
IPC分类号	G01N33/574 G01N33/543 G01N33/533		
CPC分类号	G01N33/54326		
FI分类号	G01N33/574.D G01N33/543.541.A G01N33/533		
优先权	61/054219 2008-05-19 US		
其他公开文献	JP5701749B2 JP2011521262A5		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

摘要(译)

提供了一种去除过量未结合的铁磁流体和成像富含免疫磁性的循环肿瘤细胞的方法。在观察表面中具有预成形凹槽的容器被最佳地设计用于细胞对准和成像。在通过离心分离未结合的颗粒之后，施加外部施加的力以将磁响应颗粒-CTC复合物输送到透明的收集壁。腔室的观察面的带槽内表面提供颗粒的均匀分布，以便于成像。本发明还可用于结合自动细胞计数技术进行定量分析和样品制备，如在疾病中CTC的定量分析中。

【 図 3 】

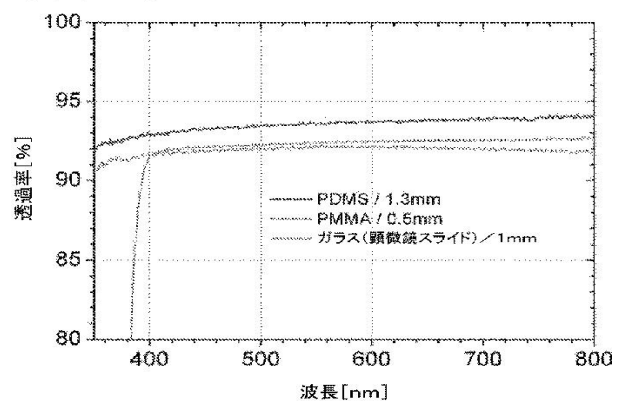

【 図 4 】